

RESOLUCION DE GERENCIA DIVISION DE PRESTACIONES N° 71 GDP-EsSalud-2006

Lima, 29 SET. 2006

VISTA:

La Carta N° 871 GRM-EsSalud-2006 del 27 de setiembre del 2006 de la Gerencia de Recursos Médicos, en la que se propone la aprobación de las Especificaciones Técnicas del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica y de los Equipos en Cesión en Uso y;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso b) del artículo 9° de la Ley N° 27056 - Ley de Creación del Seguro Social de Salud (EsSalud), establece que el Gerente General es competente para dirigir el funcionamiento de la Institución, emitir directivas y los procedimientos internos necesarios en concordancia con las políticas, lineamientos y demás disposiciones del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 596-GG-EsSalud-2006, de fecha 14 de Setiembre del 2006, se aprobó la Directiva N° 009-GG-ESSALUD-2005, "Uso del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica en el Seguro Social de Salud";

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 514-GG-EsSalud-2005, de fecha 19 de Setiembre del 2005, se aprobó la Directiva N° 011-GG-ESSALUD-2005, "Normas del proceso de requerimiento y selección en el suministro de reactivos, insumos y materiales para el servicio integral de los equipos entregados en cesión de uso al seguro Soacil de salud - ESSALUD";

Que, mediante Resolución de Gerencia de División de Prestaciones N° 011-GDP-ESSALUD-2006 del 31 de enero de 2006 constituyo el Comité Nacional de Patología Clínica y Anatomía Patológica del periodo 2006, encargados de presentar la propuesta de especificaciones técnicas del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica;

Estando a lo propuesto y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:




1. **APROBAR**, las Especificaciones Técnicas del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica del Seguros Social del Salud, de acuerdo al anexo 1, que forma parte de la presente Resolución.

EsSalud
GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES


Es copia fiel del Original

Lima: 29/09/06

ROGER PINZAS VILLANUEVA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 119- GDP-EsSalud-2004

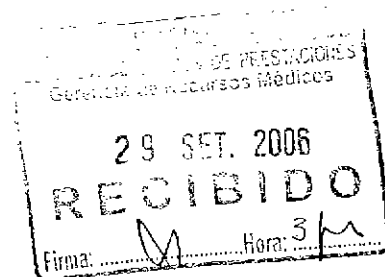

RESOLUCION DE GERENCIA DIVISION DE PRESTACIONES N° 71 GDP-EsSalud-2006



2. **INCLUIR**, dentro del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica del Seguros Social del Salud, las Especificaciones Técnicas de los Equipos en Cesión en Uso que ingresan a EsSalud, que se señalan en el anexo 2, que forma parte de la presente Resolución.



3. **ENCARGAR**, a la Gerencia de Recursos Medicos la difusión de la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



Dr. ALFREDO BARREDO MOYANO
Gerente de División de Prestaciones
EsSalud

EsSalud
GERENCIA DE DIVISION DE PRESTACIONES
Es copia fiel del Original
Lima: _____
ROGER PINZAS VILLANUEVA
FEDATARIO TITULAR
Resol. 119- GDP-EsSalud-2004

ESSALUD



**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PETITORIO DE
PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA**

2006

INDICE


Instructivo de uso de las Especificaciones Técnicas del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica	3
---	---

I. Documento I:	
Especificaciones Técnicas del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica.....	4
1. Anatomía Patológica.....	5
2. Banco de Sangre.....	29
3. Biología Molecular.....	37
4. Bioquímica.....	46
5. Citogenética	69
6. Citometría de Flujo.....	70
7. Hematología	77
8. Histocompatibilidad	83
9. Inmunología.....	89
10. Microbiología.....	128
11. Productos Generales.....	155
II. Documento II:	
Especificaciones Técnicas de Equipos en Cesión en Uso.....	178
1. Listado General de Equipos	179-180
2. Equipos con Especificaciones Técnicas	181




INSTRUCITIVO DE USO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO

1. Las Especificaciones Técnicas de los Materiales y Reactivos de laboratorio son un documento oficial de EsSalud y son aprobadas por la Gerencia de Prestaciones de EsSalud.
2. Las Especificaciones Técnicas de los Materiales y Reactivos de laboratorio comprenden 2 documentos:
 - Especificaciones Técnicas del Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica
 - Especificaciones Técnicas de Equipos en Cesión en Uso.
3. Las Especificaciones Técnicas de los Materiales y Reactivos de Laboratorio son de uso obligatorio en todos los Procesos de Adquisición
4. Las Especificaciones Técnicas de los Materiales y Reactivos de Laboratorio no son modificables en ninguno de sus términos o características, por lo cual no está permitido añadirles términos o características adicionales ni otorgar puntaje alguno en razón de ello.
5. Las Especificaciones Técnicas de los Materiales y Reactivos de Laboratorio son de cumplimiento obligatorio en todos sus términos y características, por lo que su evaluación en cualquier proceso de adquisición es de carácter cancelatorio, y no es aplicable otorgar puntaje a ninguno de sus términos o características.
6. Únicamente en los casos en los que las Especificaciones Técnicas del Petitorio (documento I) señale: "se indicarán en una tabla adicional" se podrá hacer precisiones adicionales, de cumplimiento obligatorio y no puntuable, en una tabla anexa, elaborada por el usuario final.
7. El médico responsable evaluará la conveniencia de agrupar los reactivos en función al uso del equipo con el fin de optimizar el proceso de la realización de la prueba y buscando mejorar la eficiencia de su área.
8. El ingreso de equipos de cesión en uso estará normado de acuerdo a la directiva N° 11-GG-EsSalud-2005 (3/10/05): "Normas del proceso de requerimiento y selección en el suministro de reactivos, insumos y materiales para el Servicio integral de los equipos entregados en cesión de uso al Seguro Social de Salud EsSalud".
9. El Petitorio de Patología Clínica y Anatomía patológica y sus Especificaciones Técnicas únicamente están restringidos por el Nivel de Uso. La presentación del Petitorio por Área Usuaria es sólo referencial.
10. Las Especificaciones Técnicas de los Materiales y Reactivos de Laboratorio sólo se podrán modificar por el Comité Nacional de patología Clínica y Anatomía Patológica, únicamente en razón del pedido debidamente fundamentado de un Comité de Órgano Desconcentrado. En ningún caso la modificación debe impedir o limitar la posibilidad de competir a los postores actuales.
11. Toda observación al presente documento deberá ser resuelta por el Comité Nacional de Patología Clínica y Anatomía Patológica.



DOCUMENTO I


ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PETITORIO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA



ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PETITORIO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DE EsSalud

1. ANATOMIA PATOLOGICA


Nº	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES
1	30105374	Aceite Lubricante para Criostato	CM 3	4	PRESENTACION: Aceite Lubricante para Criostato en Frasco por 120 ml aproximadamente, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Aceite para trabajo a baja temperatura de -40°C a +40°C. USO: Lubricante para Criostato.
2	30105375	Aceite Lubricante para Micrótopo	CM 3	4	PRESENTACION: Aceite Lubricante para Micrótopo en Frasco por 120 ml aproximadamente, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Lubricante de Alto Grado. USO: Lubricante para Micrótopo.
3	30106214	Antisuero CD21	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Antisuero CD21, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
4	30104144	Antisuero para Actina	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Actina, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
5	30105412	Antisuero para Alfa 1 fetoproteína	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Alfa 1 fetoproteína, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
6	30105798	Antisuero para ALK proteína	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para ALK proteína, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)




7	30105810	Antisuero para Antígeno Carcinoembrionario	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para antígeno carcinoembrionario, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
8	30105811	Antisuero para Antígeno Core de Hepatitis B	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Antígeno Core de Hepatitis B, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
9	30105812	Antisuero para Antígeno de Hepatitis C	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Antígeno de Hepatitis C, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
10	30104256	Antisuero para Antígeno de Membrana Epitelial (EMA)	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Antígeno de Membrana Epitelial (EMA), herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
11	30105813	Antisuero para Antígeno de Superficie de Hepatitis B	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Antígeno de Superficie de Hepatitis B, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
12	30104277	Antisuero para Antígeno Prostático Específico	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Antígeno Prostático Específico, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
13	30106212	Antisuero para Bcl 10	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Bcl 10, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)





14	30105434	Antisuero para Bcl-2 Oncoproteína	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Bcl2 Oncoproteína, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
15	30100385	Antisuero para Bcl-6	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Bcl-6, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
16	30104345	Antisuero para Ber-EP4	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Ber-EP4, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
17	30106195	Antisuero para BRCA1	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para BRCA1, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
18	30105436	Antisuero para Cadena Ligera Kappa humana	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Cadena Ligera Kappa humana, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
19	30104340	Antisuero para Cadena Ligera Kappa humana conjugado con Fluoresceína	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Cadena Ligera Kappa humana conjugado con fluoresceína, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Monoclonal antihumano marcado con Isotiocianato de Fluoresceína. USO: Inmunohistoquímica por Inmunofluorescencia Directa.
20	30105782	Antisuero para Cadena Ligera Lambda humana	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Cadena Ligera Lambda Humana, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)




21	30104342	Antisuero para Cadena Ligera Lambda humana conjugado con Fluoresceína	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Cadena Ligera Lambda humana conjugado con fluoresceína , herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Monoclonal antihumano marcado con Isotiocianato de Fluoresceína. USO: Inmunohistoquímica por Inmunofluorescencia Directa.
22	30105815	Antisuero para Calcitonina	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Calcitonina, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
23	30105572	Antisuero para Calretinina (Célula Mesotelial)	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Calretinina , herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
24	30105816	Antisuero para Catepsina	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Catepsina, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
25	30105555	Antisuero para CD 10	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD10, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
26	30106196	Antisuero para CD 117	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD 117, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
27	30105799	Antisuero para CD 13	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD13, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
28	30106051	Antisuero para CD 138	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD 138, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)





29	30105556	Antisuero para CD 15	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD15, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
30	30105800	Antisuero para CD 19	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD19, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
31	30105513	Antisuero para CD 20	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD20, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
32	30105389	Antisuero para CD 23 (Linfocitos B)	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD23, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
33	30105559	Antisuero para CD 3	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD3, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
34	30105563	Antisuero para CD 30	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD30, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
35	30105414	Antisuero para CD 31	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD31, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado) GARANTIA



36	30105801	Antisuero para CD 34	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD34, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
37	30105802	Antisuero para CD 4	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD4, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
38	30105803	Antisuero para CD 41	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD41, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
39	30104496	Antisuero para CD 43	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD43, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
40	30105566	Antisuero para CD 45 (Antígeno Común Leucocitario)	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD45, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
41	30105567	Antisuero para CD 45 RO	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD45 RO, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
42	30105804	Antisuero para CD 5	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD5, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)





43	30105569	Antisuero para CD 56	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD56, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
44	30105571	Antisuero para CD 61	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD 61, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
45	30105415	Antisuero para CD 68	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD 68, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
46	30105805	Antisuero para CD 79	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD 79, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
47	30105806	Antisuero para CD 8	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD 8, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
48	30105807	Antisuero para CD 94	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD 94, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
49	30105702	Antisuero para CD 99	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD 99, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)




50	30106197	Antisuero para CD1	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD1, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
51	30106052	Antisuero para CD38	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para CD38, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
52	30105814	Antisuero para c-erbB-2	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para c-erbB-2, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
53	30105817	Antisuero para Citomegalovirus	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Citomegalovirus, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
54	30105574	Antisuero para Citoqueratina 20	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Citoqueratina 20, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
55	30105818	Antisuero para Citoqueratina 5	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Citoqueratina 5, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
56	30105819	Antisuero para Citoqueratina 6	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Citoqueratina 6, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)




57	30105820	Antisuero para Citoqueratina 7	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Citoqueratina 7, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
58	30105576	Antisuero para Citoqueratina 8	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Citoqueratina 8, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
59	30105577	Antisuero para Citoqueratina de Alto Peso Molecular	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Citoqueratina de alto peso molecular (34betaE12), herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
60	30105821	Antisuero para Colágeno IV	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Colágeno IV, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
61	30104398	Antisuero para Complemento C1q conjugado con Fluoresceína	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Complemento C1q conjugado con fluoresceína, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Monoclonal antihumano marcado con Isotiocianato de Fluoresceína. USO: Inmunohistoquímica por Inmunofluorescencia Directa.
62	30105382	Antisuero para Complemento C3 conjugado con Fluoresceína	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Complemento C3 conjugado con fluoresceína, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Monoclonal antihumano marcado con Isotiocianato de Fluoresceína. USO: Inmunohistoquímica por Inmunofluorescencia Directa.
63	30106053	Antisuero para Complemento C4d conjugado con fluoresceína	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Complemento C4d conjugado con fluoresceína, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Monoclonal antihumano marcado con Isotiocianato de Fluoresceína. USO: Inmunohistoquímica por Inmunofluorescencia Directa.




64	30104472	Antisuero para Cromogranina A	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Cromogranina A, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
65	30105405	Antisuero para Cyclin D1	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Cyclin D1, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
66	30106054	Antisuero para Deoxinucleotidil Transferasa Terminal (TDT)	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Antisuero para Deoxinucleotidil Transferasa Terminal (TDT, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado), inmunofluorescencia.
67	30105385	Antisuero para Desmina	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 12 ml de Antisuero para Desmina, herméticamente sellado, no reenvasado. La presentación Prediluido o Concentrado se indicará en un cuadro adicional. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Monoclonal antihumano para Tejido fijado en Formol y embebido en Parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el Sistema Estreptavidina-Biotina Marcado.
68	30106055	Antisuero para E-Cadherina	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para E-Cadherina, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
69	30104708	Antisuero para Enolasa Neuroespecifica	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Enolasa Neuroespecifica, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
70	30105416	Antisuero para Epstein Barr Virus BZLF-1	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Epstein Barr Virus BZLF-1, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)




71	30105417	Antisuero para Epstein Barr Virus EBNA 2	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Epstein Barr Virus EBNA 2, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
72	30105602	Antisuero para Epstein Barr Virus LMP	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Epstein Barr Virus LMP, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
73	30106056	Antisuero para factor VIII, antígeno relacionado	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para factor VIII, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
74	30106057	Antisuero para fibrinógeno conjugado con fluoresceína	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para fibrinógeno conjugado con fluoresceína, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Monoclonal antihumano marcado con Isotiocianato de Fluoresceína. USO: Inmunohistoquímica por Inmunofluorescencia Directa.
75	30104758	Antisuero para Fosfatasa Ácida Prostática	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para fosfatasa ácida prostática, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
76	30105608	Antisuero para FSH	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para FSH, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
77	30105613	Antisuero para Glycophorin A	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Glycophorin A, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)



78	30105614	Antisuero para Gonadotropina Coriónica	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Gonadotropina coriónica, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
79	30105615	Antisuero para Hepatocito	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Hepatocito, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
80	30106213	Antisuero para HER-2	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para HER-2, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
81	30105808	Antisuero para HME 1	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para HME 1, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
82	30105397	Antisuero para Hormona ACTH	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Hormona ACTH, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
83	30105398	Antisuero para Hormona de Crecimiento	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Hormona de crecimiento, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
84	30105823	Antisuero para Hormona Lactogeno Placentario	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Lactógeno placentario, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)



85	30105822	Antisuero para Hormona LH	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Hormona LH, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
86	30105824	Antisuero para Hormona Prolactina	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Hormona Prolactina, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
87	30106058	Antisuero para HTLV	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para HTLV, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
88	30105157	Antisuero para IgA humano cadena pesada específica	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para IgA humano cadena pesada específica, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
89	30104399	Antisuero para IgA humano conjugado con Fluoresceína	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para IgA humano conjugado con Fluoresceína, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Monoclonal antihumano marcado con Isotiocianato de Fluoresceína. USO: Inmunohistoquímica por Inmunofluorescencia Directa.
90	30104343	Antisuero para IgA, IgG, IgM Humanas conjugado con fluoresceína	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para IgA, IgG, IgM humanas conjugado con fluoresceína, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Monoclonal antihumano marcado con Isotiocianato de Fluoresceína. USO: Inmunohistoquímica por Inmunofluorescencia Directa.
91	30105748	Antisuero para IgD humana cadena pesada específica	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para IgD humano cadena pesada específica, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)



92	30105158	Antisuero para IgG humana cadena pesada específica	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para IgG humano cadena pesada específica, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
93	30105809	Antisuero para IgG humano conjugado con Fluoresceína	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para IgG humano conjugado con fluoresceína, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Monoclonal antihumano marcado con Isotiocianato de Fluoresceína. USO: Inmunohistoquímica por Inmunofluorescencia Directa.
94	30104312	Antisuero para IgM humano cadena pesada específica	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para IgM humano cadena pesada específica, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
95	30104313	Antisuero para IgM humano conjugado con Fluoresceína	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para IgM humano conjugado con fluoresceína, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Monoclonal antihumano marcado con Isotiocianato de Fluoresceína. USO: Inmunohistoquímica por Inmunofluorescencia Directa.
96	30104866	Antisuero para Ki-67	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Ki-67, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
97	30105825	Antisuero para Lisozima	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Lisozima, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
98	30105617	Antisuero para Melanosoma HMB45	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Melanosoma, HMB45, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)





99	30105418	Antisuero para Mieloperoxidasa	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Mieloperoxidasa, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
100	30105826	Antisuero para Mioglobina	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Mioglobina, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
101	30106059	Antisuero para Mucina 2 (MUC 2)	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Mucina 2, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
102	30106060	Antisuero para Mucina 6 (MUC 6)	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Mucina 6, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
103	30105760	Antisuero para p16	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para p16, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
104	30105387	Antisuero para Panqueratina	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Panqueratina, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
105	30106061	Antisuero para Papiloma Virus Humano	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Papiloma virus humano, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)




106	30105652	Antisuero para Proteína Ácida Glíofibrilar	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Proteína Ácida Glíofibrilar, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
107	30105827	Antisuero para Proteína Básica de Mielina	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Proteína Básica de Mielina, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
108	30105828	Antisuero para Proteína de Neurofilamento	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Proteína de Neurofilamento, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
109	30104984	Antisuero para Proteína P53	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Proteína P53, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
110	30105046	Antisuero para Proteína S-100	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Proteína S-100, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
111	30104402	Antisuero para Receptor de Estrógeno	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Receptor de Estrógeno, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
112	30105388	Antisuero para Receptor de Progesterona	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Receptor de Progesterona, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)




113	30105117	Antisuero para Sinaptofisina	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Sinaptofisina, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
114	30105829	Antisuero para Tiroglobulina	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Tiroglobulina, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
115	30106062	Antisuero para TTF 1	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para TTF-1, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
116	30104403	Antisuero para Vimentina	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Vimentina, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
117	30105750	Antisuero para WT 1	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para WT1, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
118	30106215	Antisuero PAX 5	CM 3	4	PRESENTACION:Frasco hasta por 2 CM3 de Antisuero Concentrado y/o hasta por 12 CM3 de antisuero prediluido para Antisuero para Antisuero PAX 5, antígeno relacionado herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo monoclonal antihumano para tejido en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. USO: Inmunohistoquímica por el sistema estreptavidina-biotin marcado (manual o automatizado)
119	30104096	Bálsamo de Canadá	CM 3	3,4	PRESENTACION: Bálsamo de Canadá en Frasco por 25 ó 100 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Índice de Refracción de 1.515 a 1.530, Turbidez 2 NTU ó menor. USO: Medio de Montaje para Microscopía.



120	30105959	Bálsamo de Permout	CM 3	3,4	PRESENTACION: Bálsamo de Permout en Frasco por 100 - 1000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio de montaje de resina sintética basada en tolueno. Índice de Refracción de 1.515 a 1.530, Turbidez 2 NTU ó menor. USO: Medio de Montaje para Microscopía.
121	30105868	Caja para láminas portaobjeto	UN	3,4	PRESENTACION: Caja de plástico para láminas portaobjeto. CARACTERISTICAS: Caja de Polipropileno con tapa de bisagra, con rack interno de ranuras numeradas, con capacidad mínima para 100 láminas de 25 x 75 mm. USO: Archivo temporal de láminas portaobjeto.
122	30106090	Canastilla y cubeta vertical para procesamiento de láminas		3,4	PRESENTACION: Kit de Canastilla con Koplin para 20 a 24 láminas de posición vertical y con tapa. CARACTERISTICAS: Canastilla y Koplin de Polipropileno o material plástico resistente al calor de 100 C°. USO: Recuperación antigénica, Inmunohistoquímica.
123	30104490	Carbonato de Litio p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Carbonato de Litio p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
124	30105471	Cassette de plástico para inclusión en parafina	UN	3,4	PRESENTACION: Cassette de Plástico con Tapa a Presión. CARACTERISTICAS: Cassette estándar con base cribada Cuadriculada ó en Ranuras, con superficie de identificación rugosa. Plástico resistente a todos los solventes usados en Histología. Tapa resistente a varias aperturas. Adaptable a diferentes marcas de Micrótomos. Colores, características y ranuraciones de acuerdo a necesidad del usuario en anexo a presentar. USO: Procesamiento de Biopsias para Histología.
125	30104572	Cloruro de Oro p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Cloruro de Oro p.a. grado ACS en Vial por 1 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración aproximada 49% de Oro. USO: Para Análisis.
126	30101126	Cloruro de Potasio p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Cloruro de Potasio p.a. grado ACS en Frasco por 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%. USO: Para Análisis.
127	30104575	Cloruro Férrico p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Cloruro Férrico p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
128	30104416	Colorante Azo Carmin B	G	4	PRESENTACION: Colorante Azo Carmin B en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Rojo Acido 103. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Colorante en polvo libre de impurezas. USO: Microscopía.
129	30104419	Colorante Azul Alcian BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Azul Alcian BSC en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC. USO: Microscopía.
130	30104422	Colorante Azul de Algodón	G	4	PRESENTACION: Colorante Azul de Algodón en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 70%. USO: Microscopía.




131	30100721	Colorante Azul de Anilina (Azul de Agua)	G	4	PRESENTACION: Colorante Azul de Anilina (Azul de Agua) en Frasco por 25 ó 100 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC. USO: Histoquímica
132	30104467	Colorante Biebrich Scarlet	G	4	PRESENTACION: Colorante Biebrich Scarlet en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Rojo Acido 66. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración aproximada 60%. USO: Microscopía.
133	30100823	Colorante Bismark Brown BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Bismark Brown BSC en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Bismark Brown Y. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración aproximada 50%. USO: Microscopía.
134	30104495	Colorante Carmin BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Carmin BSC en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC. USO: Microscopía.
135	30101482	Colorante Eosina B BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Eosina B BSC en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 85%. USO: Microscopía.
136	30104713	Colorante Eosina Y (amarillenta) BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Eosina Y (amarillenta) BSC en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 88%. USO: Microscopía.
137	30101600	Colorante Floxina B (Acid Red 92)	G	4	PRESENTACION: Colorante Floxina B (Acid Red 92) en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 80%. USO: Microscopía.
138	30101873	Colorante Hematoxilina (cristal) BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Hematoxilina (cristal) BSC en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 95%. USO: Microscopía.
139	30104900	Colorante Light Green (Verde Brillante)BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Light Green (Verde Brillante) BSC en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 95%. USO: Microscopía.
140	30102261	Colorante Nuclear Fast Red	G	4	PRESENTACION: Colorante Nuclear Fast Red en Frasco por 25 ó 50 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Rojo Nuclear Sólido. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 90%. USO: Microscopía.
141	30102271	Colorante Orange G BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Orange G BSC en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 80%. USO: Microscopía.



142	30102287	Colorante Oxido amarillo de mercurio (para Hematoxilina de Harris)	G	4	PRESENTACION: Colorante Oxido amarillo de mercurio (para Hematoxilina de Harris) en Frasco por 50 ó 100 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Microscopía.
143	30102292	Colorante Oxido rojo de mercurio (para Hematoxilina de Harris)	G	4	PRESENTACION: Colorante Oxido rojo de mercurio (para Hematoxilina de Harris) en Frasco por 50 ó 100 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Microscopía.
144	30105107	Colorante Rojo Congo BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Rojo Congo BSC en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 75%. USO: Microscopía.
145	30102768	Colorante Rojo Neutro BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Rojo Neutro BSC en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración 90%. USO: Microscopía.
146	30105154	Colorante Sudan III BSC	G	3,4	PRESENTACION: Colorante Sudan III BSC en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 75%. USO: Microscopía (Coloración de Grasas).
147	30105156	Colorante Sudan Negro B BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Sudan Negro B BSC en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 60%. USO: Microscopía.
148	30102920	Colorante Sudan Rojo	G	4	PRESENTACION: Colorante Sudan Rojo en Frasco por 10 gr ó 50 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Sudan Rojo 7B, Fat Red 7B. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC. USO: Microscopía
149	30103422	Colorante Verde Claro Amarillento BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Verde Claro Amarillento BSC en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 65%. USO: Microscopía.
150	30101264	Cromo Potasio Sulfato	G	4	PRESENTACION: Cromo Potasio Sulfato en Frasco ámbar por 10 ó 50 gr, herméticamente sellado no reenvasado. Sinónimo: Cromalum. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Polvo granular libre de impurezas. USO: Inmunohistoquímica (para preparación de láminas portaobjeto).
151	30105889	Cubeta y canastilla de acero con asa para coloración de 10 láminas	U	1 - 4	PRESENTACION: Kit de Cubeta y Canastilla con asa. CARACTERISTICAS: Cubeta y Canastilla con asa, de Acero Inoxidable, con capacidad para 10 láminas de 25 x 75 mm en posición horizontal, resistente a esterilización por calor seco. USO: Coloración de tejido fijado en láminas portaobjeto.
152	30100939	Cubeta y canastilla de acero con asa para coloración de 30 láminas	U	1 - 4	PRESENTACION: Kit de Cubeta y Canastilla con asa. CARACTERISTICAS: Cubeta y Canastilla con asa, de Acero Inoxidable, con capacidad para 30 láminas de 25 x 75 mm en posición horizontal, resistente a esterilización por calor seco. USO: Coloración de tejido fijado en láminas portaobjeto.



153	30100941	Cubeta y canastilla de acero con asa para coloración de 60 láminas	U	1 - 4	PRESENTACION: Kit de Cubeta y Canastilla con asa. CARACTERISTICAS: Cubeta y Canastilla con asa, de Acero Inoxidable, con capacidad para 60 láminas de 25 x 75 mm en posición horizontal, resistente a esterilización por calor seco. USO: Coloración de tejido fijado en láminas portaobjeto.
154	30104928	Cubreobjeto Líquido para Microscopia - Viscosidad	CM 3	2,3,4	PRESENTACION: Cubreobjeto Líquido para Microscopia en Frasco ambar por 500 ml ó más, herméticamente sellado no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Viscosidad aproximada 25 mPas. USO: Microscopía.
155	30105590	Diaminobenzidina	CM 3	4	PRESENTACION: Diaminobenzidina en Frasco hasta por 250 ml. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Listo para usar. USO: Substrato para identificación de Reacción de Peroxidasa para Inmunohistoquímica.
156	30105913	Envase para transporte de láminas	U	1 - 4	PRESENTACION: Cubeta de plástico con Tapa para láminas portaobjeto. CARACTERISTICAS: Cubeta y tapa de Polipropileno, reusable, con capacidad para 5 a 10 láminas de 75 x 25 mm. Tapa a rosca hermética. USO: Transporte de Láminas.
157	30101609	Formaldehído (Formol) p.a. grado ACS	CM 3	1-4	PRESENTACION: Formaldehído (Formol) p.a. grado ACS en Frasco por 1 ó 2.5 ó 4 lt, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Formalina. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 37%. USO: Para Análisis.
158	30101635	Fosfato Disódico (Dibásico) anhidro p.a. grado ACS	G	1-4	PRESENTACION: Fosfato Disódico (Dibásico) anhidro p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Anhidro. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
159	30104771	Fosfato Disódico hidratado 12 H ₂ O p.a. grado ACS	G	1-4	PRESENTACION: Fosfato Disódico hidratado 12 H ₂ O p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
160	30101646	Fosfato Trisódico p.a. grado ACS	G	1-4	PRESENTACION: Fosfato Trisódico p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Dodecahidratado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 98%. USO: Para Análisis.
161	30101776	Gelatina	G	4	PRESENTACION: Gelatina en Láminas en empaque por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: De origen animal. USO: Fijación de Tejidos para Anatomía Patológica.
162	30101890	Hexametileno tetramina (metenamina) p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Hexametileno tetramina (metenamina) p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
163	30105593	Inmunohistoquímica : Diluyente concentrado para anticuerpos con componentes reductivos de fondo	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 150 CM3, herméticamente sellado no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Diluyente para anticuerpos con componentes reductivos de fondo. USO: Inmunohistoquímica.



164	30103568	Inmunohistoquímica : Diluyente para anticuerpos	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 150 CM3, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Diluyente para anticuerpos sin aditivos. USO: Inmunohistoquímica.
165	30106220	Kit de Citología de base líquida para muestras ginecológicas.	CM 3	4	PRESENTACION: Kit de citología de base líquida para muestras ginecológicas y no ginecológicas para 100 o más pruebas, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: El kit incluye viales, preservantes, citocepillo, líquido base celular, tubos y equipos u otros elementos que permitan la realización de la prueba. USO: para muestras cervicales.
166	30106221	Kit de Citología de base líquida para muestras no ginecológicas.	CM 3	4	PRESENTACION: Kit de citología de base líquida para muestras ginecológicas y no ginecológicas para 100 o más pruebas, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: El kit incluye viales, preservantes, citocepillo, líquido base celular, tubos y equipos u otros elementos que permitan la realización de la prueba. USO: para secreciones y líquidos corporales.
167	30106217	Kit de coloración Histoquímica: Alcian Blue-PAS	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco de Solución Alcian Blue 1 L. Más kit de coloración PAS (Reactivo Schiff 1L, ácido periódico 0.5% 1 L). Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Soluciones químicas para coloración en tejido. USO: Histoquímica.
168	30106218	Kit de coloración Histoquímica: Rojo de Congo	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco de solución Rojo de Congo 110 CM3. Más soluciones adicionales de hematoxilina y KOH. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Soluciones químicas para coloración en tejido. USO: Histoquímica
169	30106216	Kit de coloración Histoquímica: Tricrómica (Masson-Goldner)	CM 3	4	PRESENTACION: Kit que contiene frascos de 500 CM3 de cada solución de Azophloxine, solución G Orange ácido tungstosfórico, solución SF light green, ácido acético 10% para un mínimo de 300 pruebas y con fecha de expiración no menor de 3 años de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Kit de soluciones químicas selladas y envasadas herméticamente. USO: para uso en Tejido fijado en Formol y embebido en parafina.
170	30103602	Kit de detección inmunohistoquímica : Fosfatasa Alcalina	UN	4	PRESENTACION: Kit Universal para la Detección de Anticuerpos por el Sistema Estreptavidina-Biotina en empaque de 100 pruebas ó empaques equivalentes. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Secundario marcado con Biotina más Estreptavidina conjugada con Enzima Fosfatasa Alcalina. USO: Inmunohistoquímica por el Sistema Estreptavidina-Biotina Marcado.
171	30102020	Kit de detección inmunohistoquímica : Peroxidasa	UN	4	PRESENTACION: Kit Universal para la Detección de Anticuerpos por el Sistema Estreptavidina-Biotina en empaque de 100 pruebas ó empaques equivalentes. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Secundario marcado con Biotina más Estreptavidina conjugada con Enzima Peroxidasa de Rábano. USO: Inmunohistoquímica por el Sistema Estreptavidina-Biotina Marcado.
172	30106143	Kit de detección inmunohistoquímica : Peroxidasa unida a polímero	UN	4	PRESENTACION: Kit Universal para la Detección de Anticuerpos por el Sistema Estreptavidina-Biotina en empaque de 40 a 60 pruebas ó empaques equivalentes. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Anticuerpo Secundario marcado con Biotina más Estreptavidina conjugada con Enzima Peroxidasa de Rábano, unido a esqueleto de polímero. USO: Inmunohistoquímica por el Sistema Estreptavidina-Biotina Marcado.
173	30105737	Lámina portaobjeto con carga positiva	UN	4	PRESENTACION: Caja por 50 ó más unidades (láminas). CARACTERISTICAS: Láminas de Vidrio Óptico Positivamente cargadas que permitan la adhesión electrostática de tejidos y preparaciones citológicas, con Cantos Pulidos, área despulida para identificación de muestra y con reborde. USO: Inmunohistoquímica.
174	30103610	Lápiz para delimitar tejidos para inmunohistoquímica	UN	4	PRESENTACION: Lápiz para delimitar tejidos en inmunohistoquímica, unidad, herméticamente sellado. Tiempo de expiración no menor de un año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Es hidrofóbico USO: para marcaje de laminas de inmunohistoquímica.



175	30104906	Líquido Adherente para Corte por Congelación	CM 3	3,4	PRESENTACION: Líquido Adherente para Corte por Congelación en Frasco por 100 ml o más, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Para cortes por congelación a -10°C ó menor. USO: Histología.
176	30104711	Medio de Inclusión Rápida para Microscopía	CM 3	2,3,4	PRESENTACION: Medio de Inclusión Rápida para Microscopía en Frasco por 500 ml ó más, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Viscosidad aproximada 70 mPas, Índice de refracción 1.495 aproximadamente USO: Microscopía.
177	30105957	Navaja descartable para micrótopo	UN	2,3,4	PRESENTACION: Navaja Descartable Universal para Micrótopo, en empaque de 50 ó más unidades. CARACTERISTICAS: De acero inoxidable, de perfil alto ó bajo. Adaptable a diferentes marcas de Micrótopos, y de cristátos. Los tipos de navajas según el tipo de perfil se indicarán en un anexo adicional. USO: Cortes muy delgados y de alta calidad.
178	30102230	Ninhidrina p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Ninhidrina p.a. grado ACS en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
179	30102235	Nitrato de Plata p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Nitrato de Plata p.a. grado ACS en Frasco por 10 ó 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
180	30104997	Parafina sólida en lentejas	G	3,4	PRESENTACION: Parafina sólida en lentejas, en Bolsa herméticamente sellada, no reenvasada. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio de Parafina altamente purificada y Paraisobutileno, con punto de fusión de 56 a 62 °C. USO: Inclusión de Tejidos. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA-USA ó CE ó Aprobación de Norma Específica ISO, DIN ó ASTM. Certificación ISO-9001.
181	30105026	Poly-L-Lysina	CM 3	4	PRESENTACION: Poly-L-Lysina en Frasco por 100 ó 250 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Solución al 0.1%. USO: Inmunohistoquímica
182	30106223	Solución de limpieza para citología de base líquida	CM 3	4	PRESENTACION: Solución preservante para citología de base líquida para muestras ginecológicas y no ginecológicas en frascos de 500 CM3 o más, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Solución preservante. USO: Para muestras cervicales, secreciones y líquidos corporales.
183	30105739	Solución de pretratamiento integral para inmunohistoquímica	UN	4	PRESENTACION: Frasco concentrado 10x - 20x de 500 CM3 a 1000 CM3 de solución recuperadora de antígenos a estudiar. CARACTERISTICAS: Contiene sustancias buffer y detergentes en solución líquida. De grado de pH a determinar por el usuario en anexo a presentar. USO: Inmunohistoquímica por el Sistema Estreptavidina-Biotina Marcado.
184	30105125	Solución Orange para Papanicolaou	CM 3	3,4	PRESENTACION: Solución Orange para Papanicolaou en Frasco por. 500 ó 1000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Orange 2AI. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Solución al 0.01%. USO: Citología.
185	30106219	Solución para coloración rápida (citología-hematología)	CM 3	4	PRESENTACION: Kit de una solución fijadora y dos soluciones colorantes. En frascos de 100ml a más. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Solución química para coloración rápida USO: Para coloración rápida en citología, biopsias aspiración.
186	30106222	Solución preservante para citología de base líquida	CM 3	4	PRESENTACION: Solución preservante para citología de base líquida para muestras ginecológicas y no ginecológicas en frascos de 500 CM3 o más, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Solución preservante. USO: Para muestras cervicales, secreciones y líquidos corporales.




187	30105139	Solución verde E.A.36 para Papanicolaou	CM 3	3,4	PRESENTACION: Solución verde E.A.36 para Papanicolaou en Frasco por 500 ó 1000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Solución Gill modificado EA. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Solución al 0.01%. USO: Citología.
188	30106005	Soporte de cassette de plástico para inclusión en parafina	UN	3,4	PRESENTACION: Base molde para inclusión de Tejidos en Parafina utilizando Cassette de Plástico. CARACTERISTICAS: De acero inoxidable, dimensiones de acuerdo a la medida del tejido a ser incluido y de acuerdo a necesidad del usuario en anexo a presentar USO: Inclusión de Tejidos en Parafina.



2. BANCO DE SANGRE



N°	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES
189	030104161	Albúmina Bovina 22%	CM 3	2,3,4	PRESENTACION: Frasco hasta por 10 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Albúmina Bovina al 22%, polimerizada. USO: Inmunohematología.
190	030100380	Anticuerpo Antifenotipo Plaquetario	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Anticuerpos Antifenotipo Plaquetario en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo ó similar. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 12 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
191	030100379	Anticuerpo Anti-HLA Plaquetario	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Anticuerpos Anti-HLA Plaquetario en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo ó similar. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 12 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
192	030100832	Bolsa cuádruple de extracción de sangre (plaquetas 5 días) x 500 mL	UN	3,4	PRESENTACION: Bolsa Cuádruple de Extracción por 450 a 500 ml. CARACTERISTICAS: Con Anticoagulante CPD-Adenina I y opcional con Manitol, para conservar hematíes no menos de 35 días, con bolsa de transferencia para conservar Plaquetas por 5 días, resistente al autoclavado. Opcional: Con tubuladura accesoria con aguja y adaptador para tubo al vacío. USO: Recolección y Fraccionamiento de Componentes Sanguíneos.
193	030105842	Bolsa cuádruple de extracción de sangre para sistema Buffy Coat	UN	4	PRESENTACION: Bolsa de Extracción por 450 a 500 ml, para Sistema de Fraccionamiento Sanguíneo con Buffy Coat depletado. CARACTERISTICAS: Con Anticoagulante CPD-Adenina I y Manitol, para conservar hematíes por más de 35 días, con bolsa de transferencia para conservar Plaquetas por 5 días, resistente al autoclavado. Opcional: Con tubuladura accesoria con aguja y adaptador para tubo al vacío. ACCESORIOS: Complementos y Equipos TIPO 39 según tabla adjunta, que permitan la realización completa del procedimiento. USO: Recolección y Fraccionamiento de Componentes Sanguíneos.
194	030100833	Bolsa de extracción de sangre pediátrica x 250 mL	UN	2,3,4	PRESENTACION: Bolsa de Extracción por 250 ml. CARACTERISTICAS: Con Anticoagulante CPD-Adenina I y opcional con MANITOL, para conservar hematíes por más de 35 días, resistente al autoclavado. Opcional con tubuladura accesoria con aguja y adaptador para tubo al vacío. USO: Recolección y Fraccionamiento de Componentes Sanguíneos.
195	030100836	Bolsa de transferencia de plasma x 300 mL	UN	2,3,4	PRESENTACION: Bolsa con capacidad mínima de 300 ml. CARACTERISTICAS: Bolsa con accesorios para transferencia de Plasma. USO: Para transferencia de Componentes Sanguíneos.
196	030100841	Bolsa doble de extracción de sangre CPD-Adenina x 500 mL	UN	2,3,4	PRESENTACION: Bolsa Doble de Extracción por 450 a 500ml. CARACTERISTICAS: Con Anticoagulante CPD-Adenina I y opcional con Manitol, para conservar hematíes no menos de 35 días, resistente al autoclavado. Opcional con tubuladura accesoria con aguja y adaptador para tubo al vacío. USO: Recolección y Fraccionamiento de Componentes Sanguíneos.




197	030100844	Bolsa simple de extracción de sangre CPD-Adenina x 500 mL	UN	2,3,4	PRESENTACION: Bolsa Simple de Extracción por 450 a 500 ml. CARACTERISTICAS: Con Anticoagulante CPD-Adenina I y opcional con Manitol, para conservar hematíes por más de 35 días, resistente al autoclavado. Opcional con tubuladura accesoria con aguja y adaptador para tubo al vacío. USO: Recolección de sangre.
198	030100845	Bolsa triple de extracción de sangre (plaquetas 5 días) x 500 mL	UN	3,4	PRESENTACION: Bolsa Triple de Extracción por 450 a 500 ml. CARACTERISTICAS: Con Anticoagulante CPD-Adenina I y opcional MANITOL, para conservar hematíes no menos de 35 días, con bolsa de transferencia para conservar Plaquetas por 5 días, resistente al autoclavado. Opcional: Con tubuladura accesoria con aguja y adaptador para tubo al vacío. ACCESORIOS: Complementos y Equipos TIPO 39 según tabla adjunta, que permitan la realización completa del procedimiento. USO: Recolección y Fraccionamiento de Componentes Sanguíneos.
199	030105911	Elución rápida prueba inmunohematológica	CM 3	4	PRESENTACION: Kit de Elución para estudio Inmunohematológico. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Listo para usar. Si lo requiere debe incluir adicionalmente soluciones y aditivos. USO: Inmunohematología.
200	030101491	Equipo completo para aféresis	UN	4	PRESENTACION: Equipo Completo para Aféresis en empaque individual sellado. Las cantidades de Equipos de Aféresis según el uso (Plaquetaféresis, Recambio Plasmático Terapéutico y Recolección de Stem Cell) se indicarán en una tabla adicional. CARACTERISTICAS: Descartable, con Soluciones para Anticoagulación y Cebado, con monitorización de anticoagulante. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 37 ó 38. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. USO: Plaquetaféresis, Plasmaféresis, Colecta de Células Progenitoras.
201	030105914	Equipo para recolección automatizada de componentes sanguíneos	UN	4	PRESENTACION: Equipo Completo para Recolección Automatizada de Componentes Sanguíneos en empaque individual sellado. CARACTERISTICAS: Descartable, con Soluciones para Anticoagulación y Cebado, con monitorización de anticoagulante. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 38 según tabla adjunta, que permitan la realización completa del procedimiento. USO: Colecta y Fraccionamiento Automatizado de Concentrado de Hematíes, Plasma y Plaquetas leucorreducidas. Opcional: Plasmaféresis y Colecta de Células Progenitoras.
202	030103811	Grapa selladora para bolsa de sangre	UN	2,3,4	PRESENTACION: Caja por 1000 ó mas unidades (grapas). CARACTERISTICAS: Grapa de aluminio. ACCESORIOS: Un Sellador de grapas por cada Banco de Sangre solicitante. USO: Sellado de Tuberías de Bolsas de Sangre.
203	030105935	Kit completo de células para identificación de anticuerpos eritrocitarios	UN	4	PRESENTACION: Kit Completo de 20 ó más Frascos hasta por 5 ml cada uno, con gotero, herméticamente sellados, no reenvasados. Sinónimo: Células Panel. Tiempo de Expiración no menor de 21 días a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Glóbulos Rojos Humanos preservados en medio adecuado. Debe incluir Antígeno Diego A. USO: Identificación de Anticuerpos Antieritrocitarios.
204	030105936	Kit completo de células para identificación enzimática de anticuerpos eritrocitarios	UN	4	PRESENTACION: Kit Completo de 20 ó más Frascos hasta por 5 ml cada uno, con gotero, herméticamente sellados, no reenvasados. Sinónimo: Células Panel. Tiempo de Expiración no menor de 21 días a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Glóbulos Rojos Humanos tratados con Enzimas, preservados en medio adecuado. Debe incluir Antígeno Diego A. USO: Identificación de Anticuerpos Antieritrocitarios con Células tratadas con Enzimas.



205	030105937	Kit completo de células para rastreo de anticuerpos eritrocitarios	UN	3.4	PRESENTACION: Kit Completo de 2 ó más Frascos hasta por 10 ml cada uno, con gotero, herméticamente sellados, no reenvasados. Sinónimo: Células Pantalla. Tiempo de Expiración no menor de 21 días a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Glóbulos Rojos Humanos preservados en medio adecuado. Debe incluir Antígeno Diego A. USO: Rastreo de Anticuerpos Antieritrocitarios.
206	030104338	Lectina anti-A1	CM 3	2,3,4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Lectina Anti A1, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Extracto de Dolichos biflorus. USO: Determinación del Sub-Grupo Sanguíneo A1 en lámina o en tubo.
207	030104895	Lectina anti-H	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Lectina Anti H, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Extracto de Ulex Europaeus. USO: Determinación de la Sustancia H en lámina o en tubo.
208	030105373	Lectinas para poliglutinación de glóbulos rojos kit	CM 3	4	PRESENTACION: Kit completo de 5 frascos por 5 ml cada uno, con gotero, herméticamente sellados, no reenvasados. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Lectina para Antígenos Cad, Tn, T y Tk, como mínimo. USO: Inmunohematología (Poliaglutinación de Glóbulos Rojos).
209	030102030	Placa de porcelana excavada	UN	1 - 4	PRESENTACION: Placa de Cerámica color Blanco en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Porcelana vitrificada, con 20 ó más excavaciones. USO: Determinación en Placa de Grupos Sanguíneos.
210	030103820	Polietilenglicol (PEG) solución aditiva	CM 3	4	PRESENTACION: Polietilenglicol (PEG) solución aditiva en Frasco por 10 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Listo para usar. USO: Inmunohematología.
211	030105981	Prueba de confirmación Anti D en tarjeta	PB A	4	PRESENTACION: Tarjeta sellada para Confirmación de Grupo Rh en empaque adecuado. Cada Tarjeta con 6 ó más pruebas individuales. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODO: Aglutinación en capilar. ACCESORIOS: Solución de Liss en cantidad suficiente, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 35 ó 36. El(los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Glóbulos Rojos.
212	030105983	Prueba de Coombs enzimática investigación de anticuerpos en tarjeta	PB A	4	PRESENTACION: Tarjeta sellada para identificación de Anticuerpos Irregulares con Enzima en empaque adecuado. Cada Tarjeta con 6 ó más pruebas individuales. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODO: Aglutinación en capilar. ACCESORIOS: Solución de Liss en cantidad suficiente, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 35 ó 36 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero y Glóbulos Rojos.
213	030105984	Prueba de Coombs monoespecifico IgG, IgA, IgM, C3c, C3d en tarjeta	PB A	4	PRESENTACION: Tarjeta sellada para Prueba Cruzada Mayor con Antisueros Monoespecificos IgG, IgA, IgM, C3b, C3d en empaque adecuado. Cada Tarjeta con 1 prueba completa. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODO: Aglutinación en capilar. ACCESORIOS: Solución de Liss en cantidad suficiente, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 35 ó 36 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero y Glóbulos Rojos.



214	030105985	Prueba de Coombs poliespecifico en tarjeta	PB A	4	PRESENTACION: Tarjeta sellada para Prueba Cruzada Mayor con Liss en empaque adecuado. Cada Tarjeta con 6 ó más pruebas individuales. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODO: Aglutinación en capilar. ACCESORIOS: Solución de Liss en cantidad suficiente, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 35 ó 36. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero y Glóbulos Rojos.
215	030105986	Prueba de Grupo Sanguíneo A, B, D y Coombs neonatal en tarjeta	PB A	4	PRESENTACION: Tarjeta sellada para identificación de Grupos Sanguíneos A,B,D y Coombs Directo en empaque adecuado. Cada Tarjeta con 1 prueba completa. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODO: Aglutinación en capilar. ACCESORIOS: Solución de Liss en cantidad suficiente, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 35 ó 36. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Glóbulos Rojos.
216	030105988	Prueba Grupo Sanguíneo celular A,B,D/A,B,D en tarjeta	PB A	4	PRESENTACION: Tarjeta sellada para identificación de Grupos Sanguíneos A, B y D en empaque adecuado. Cada Tarjeta con 2 pruebas completas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODO: Aglutinación en capilar. ACCESORIOS: Solución de Liss en cantidad suficiente, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 35 ó 36. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Glóbulos Rojos.
217	030105992	Prueba Grupo Sanguíneo Fenotipo k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb en tarjeta	PB A	4	PRESENTACION: Tarjeta sellada para identificación de Fenotipo k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb en empaque adecuado. Cada Tarjeta con 1 prueba completa. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODO: Aglutinación en capilar. ACCESORIOS: Solución de Liss en cantidad suficiente, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 35 ó 36. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Glóbulos Rojos.
218	030105989	Prueba Grupo Sanguíneo Fenotipo M, n, S, s, Fy ^a , Fy ^b en tarjeta	PB A	4	PRESENTACION: Tarjeta sellada para identificación de Fenotipo M, N, S, s, Fya, Fyb en empaque adecuado. Cada Tarjeta con 1 prueba completa. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODO: Aglutinación en capilar. ACCESORIOS: Solución de Liss en cantidad suficiente, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 35 ó 36. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Glóbulos Rojos.
219	030105990	Prueba Grupo Sanguíneo Fenotipo P1, Le ^a , Le ^b , Lu ^a , Lu ^b en tarjeta	PB A	4	PRESENTACION: Tarjeta sellada para identificación de Fenotipo P1, Lea, Leb, Lua, Lub en empaque adecuado. Cada Tarjeta con 1 prueba completa. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODO: Aglutinación en capilar. ACCESORIOS: Solución de Liss en cantidad suficiente, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 35 ó 36. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Glóbulos Rojos.
220	030105991	Prueba Grupo Sanguíneo Fenotipo Rh: C, c, E, e, K en tarjeta	PB A	4	PRESENTACION: Tarjeta sellada para identificación de Fenotipo Rh: C, c, E, e, K (opcional Anti D y Cw), en empaque adecuado. Cada Tarjeta con 1 prueba completa. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODO: Aglutinación en capilar. ACCESORIOS: Solución de Liss en cantidad suficiente, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 35 ó 36. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Glóbulos Rojos.
221	030106001	Solución difosfato de cloroquina para inmunohematología	CM 3	4	PRESENTACION: Solución Difosfato de Cloroquina en Frasco hasta por 10 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Listo para usar. USO: Inmunohematología.



222	030105372	Solución LISS (Baja Fuerza Iónica) para Inmunoematología	CM 3	4	PRESENTACION: Solución LISS (Baja Fuerza Iónica) en Frasco hasta por 100 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Listo para usar. USO: Procedimientos manuales de Inmunoematología. No debe ser adquirido como complemento para las Tarjetas de Gel.
223	030102873	Soporte de acrílico para bolsa de sangre	UN	2,3,4	PRESENTACION: Soporte individual en empaque por 100 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Soporte individual de acrílico incoloro, de base cuadrada con ranura para colocar la bolsa de sangre en posición vertical. USO: Almacenamiento de bolsas de sangre.
224	030105159	Suero anti A	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Frasco hasta por 10 ml de Suero anti A, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales. Titulo de 1/256 dils. y avidéz de 8 a 12 segundos. USO: Determinación del Grupo Sanguíneo A en lámina o en tubo.
225	030105160	Suero anti AB	CM 3	2,3,4	PRESENTACION: Frasco hasta por 10 ml de Suero anti AB, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales. USO: Determinación del Grupo Sanguíneo AB en lámina o en tubo.
226	030105162	Suero anti B	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Frasco hasta por 10 ml de Suero anti B, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales. Titulo de 1/256 dils. y avidéz de 8 a 12 segundos. USO: Determinación del Grupo Sanguíneo B en lámina o en tubo.
227	030105460	Suero anti C	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti C (Mayúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo C (Mayúscula) en lámina o en tubo.
228	030105462	Suero anti c	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti c (Minúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo c (Minúscula) en lámina o en tubo.
229	030104297	Suero anti C ^w	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti C ^w , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo C ^w en lámina o en tubo.
230	030106006	Suero anti C3D-C3B	CM 3	3,4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti C3d-C3b, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales. USO: Prueba de Coombs anticomplemento en tubo.
231	030104298	Suero anti Co ^a	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Co ^a , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Co ^a en lámina o en tubo.



232	030106007	Suero anti Co ^a b	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Co ^a b, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Co ^a b en lámina o en tubo.
233	030105163	Suero anti D monoclonal	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Frasco hasta por 10 ml de Suero anti D, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales IgG e IgM. Título de 1/128 dils. y avidez menor de 30 segundos. USO: Determinación del Grupo Sanguíneo Rh en lámina o en tubo.
234	030106008	Suero anti D policlonal	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Frasco hasta por 10 ml de Suero anti D, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Policlonales de origen humano. Título de 1/128 dils. y avidez menor de 60 segundos. USO: Determinación del Grupo Sanguíneo Rh en lámina o en tubo.
235	030103794	Suero anti DCE	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 10 ml de Suero anti DCE, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo DCE en lámina o en tubo.
236	030104299	Suero anti Di ^a a	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Di ^a a, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Di ^a a en lámina o en tubo.
237	030104300	Suero anti Di ^b b	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Di ^b b, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Di ^b b en lámina o en tubo.
238	030105461	Suero anti E (Mayúscula)	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti E (Mayúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo E (Mayúscula) en lámina o en tubo.
239	030105463	Suero anti e (Minúscula)	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti e (Minúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo e (Minúscula) en lámina o en tubo.
240	030104301	Suero anti Fy ^a a	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Fy ^a a, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Fy ^a a en lámina o en tubo.
241	030104303	Suero anti Fy ^b b	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Fy ^b b, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Fy ^b b en lámina o en tubo.



242	030106009	Suero anti I (Mayúscula)	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti I (Mayúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo I (Mayúscula) en lámina o en tubo.
243	030105176	Suero anti IgG anti C3d Poliespecifico (Coombs)	CM 3	3,4	PRESENTACION: Frasco hasta por 10 ml de Suero anti IgG anti C3d Poliespecifico, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales. USO: Prueba de Coombs Poliespecifico en tubo.
244	030104307	Suero anti IgG monoespecifico	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 10 ml de Suero anti IgG monoespecifico, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales. USO: Prueba de Coombs Monoespecifico anti IgG en tubo.
245	030104314	Suero anti Jk ^a	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Jk ^a , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Jk ^a en lámina o en tubo.
246	030104316	Suero anti Jk ^b	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Jk ^b , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Jk ^b en lámina o en tubo.
247	030106010	Suero anti k (Cellano)	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti k (Cellano), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo k (Cellano) en lámina o en tubo.
248	030104318	Suero anti K (kell)	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti K (kell), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo K (kell) en lámina o en tubo.
249	030104320	Suero anti Kp ^a	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Kp ^a , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Kp ^a en lámina o en tubo.
250	030104321	Suero anti Kp ^b	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Kp ^b , con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Kp ^b en lámina o en tubo.
251	030104322	Suero anti Le ^a (Lewis a)	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Le ^a (Lewis a), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Le ^a (Lewis a) en lámina o en tubo.




252	030104323	Suero anti Le ^a b (Lewis b)	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Le ^a b (Lewis b), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Le ^a b (Lewis b) en lámina o en tubo.
253	030103785	Suero anti Lu ^a a (Lutheran a)	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Lu ^a a (Lutheran a), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Lu ^a a (Lutheran a) en lámina o en tubo.
254	030103786	Suero anti Lu ^a b (Lutheran b)	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Lu ^a b (Lutheran b), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Lu ^a b (Lutheran b) en lámina o en tubo.
255	030103787	Suero anti M monoclonal	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti M, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo M en lámina o en tubo.
256	030103788	Suero anti N monoclonal	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti N, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo N en lámina o en tubo.
257	030103789	Suero anti P1 monoclonal	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti P1, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo P1 en lámina o en tubo.
258	030103790	Suero anti S (Mayúscula)	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti S (Mayúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo S (Mayúscula) en lámina o en tubo.
259	030104329	Suero anti s (Minúscula)	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti s (Minúscula), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo s (Minúscula) en lámina o en tubo.
260	030103792	Suero anti Xg ^a a	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 5 ml de Suero anti Xg ^a a, con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo con Anticuerpos Monoclonales ó Policlonales ó Humanos. USO: Determinación del Fenotipo Xg ^a a en lámina o en tubo.



3. BIOLOGIA MOLECULAR

Nº	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES
261	030104117	Acido Bórico p.a.	G	4	PRESENTACION: Acido Bórico p.a. en Frasco por 100 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado Molecular, Concentración mínima 99%. USO: Biología Molecular.
262	030104124	Acido EDTA Disódico p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Acido EDTA Disódico p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 250 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado Molecular. Concentración mínima 99%. USO: Biología Molecular.
263	030100132	Acrilamida	G	4	PRESENTACION: Acrilamida en Frasco por 100 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado molecular, Concentración mínima 99%. USO: Biología Molecular (Electroforesis).
264	030103491	Agar Noble para Electroforesis	G	4	PRESENTACION: Agar Noble para Electroforesis en Frasco por 50 gr o más herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado molecular. USO: Biología Molecular (Electroforesis).
265	030105426	Agarosa	G	4	PRESENTACION: Agarosa en Frasco por 50gr. ó más herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Agarosa Ultrapura de Bajo punto de Fusión. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado molecular. USO: Biología Molecular (Electroforesis).
266	030100217	Agarosa Metaphor	G	4	PRESENTACION: Agarosa Metaphor en Frasco por 125 ó 250 ó 500-gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado Molecular, Estéril. USO: Detectar bandas de bajo peso molecular en técnicas de Biología Molecular.
267	030100218	Agarosa Nusieve	G	4	PRESENTACION: Agarosa Nusieve en Frasco por 125 ó 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado Molecular, Estéril. USO: Detectar las Bandas de Digestión con Enzimas de Restricción.
268	030100219	Agarosa Seakeem	G	4	PRESENTACION: Agarosa Seakeem en Frasco por 125 ó 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado Molecular, Estéril. USO: Detectar las Bandas de Genotipificación biomolecular en técnicas de Biología Molecular.
269	030105770	Amonio Acetato p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Amonio Acetato p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS. USO: Biología Molecular.





270	030105841	Azul de Bromofenol Buferado	CM 3	4	PRESENTACION: Vial de 5 ml ó equivalente, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Solución reconstituida con Azul de Bromofenol 0.5% y Xylene cianol 0.5%, en bufer Tris Borato EDTA (pH 8.3). USO: Pruebas de Biología Molecular.
271	030104465	Bromuro de Etidio Ultrapuro 10 mg/ml	CM 3	4	PRESENTACION: Bromuro de Etidio Ultrapuro en Frasco por 10 ml (10 mg/ml), herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado Molecular, Estéril. USO: Biología Molecular.
272	030101279	Cubeta horizontal para electroforesis en gel	UN	4	PRESENTACION: Kit de Cubeta con Tapa, 5 soportes de Gel y 5 Peines para perforar pozos en Gel, en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Cubeta, Tapa y Soportes de Acrílico transparente para Gel de 7.5 x 10 cm. Peines de Plástico para 12 pozos de 1 mm de ancho. USO: Electroforesis Submarino Gel.
273	030101287	Cubeta vertical para electroforesis en gel	UN	4	PRESENTACION: Kit de Cubeta Ajustable con Tapa, 5 soportes de Gel y 5 Peines para perforar pozos en Gel, en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Cubeta, Tapa y Soportes de Acrílico transparente. Cubeta de 29 x 22 x 41 cm. Soportes para Geles de 16.5 x 14.5/28 cm ó 17 x 32 cm, espesor del Gel de 0.4 mm. Peines de Plástico para 12 pozos de 1 mm de ancho. USO: Electroforesis de Acidos Nucleicos.
274	030101557	Fenol Saturado Tamponado Equilibrado para Biología Molecular	CM 3	4	PRESENTACION: Fenol Saturado Tamponado Equilibrado para Biología Molecular en Frasco por 100 ml ó equivalente, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado Molecular, Buferado, Estéril. pH 4.0 ó pH 8.0 de acuerdo a cuadro adjunto. USO: Biología Molecular.
275	030104754	Formamida ultra puro p.a.	CM 3	4	PRESENTACION: Formamida Ultrapuro p.a. en Frasco por 100 ó 1000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado Molecular, Concentración mínima 90%. USO: Biología Molecular.
276	030106137	Hepatitis B DNA Polimerasa	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Hepatitis B DNA polimerasa, herméticamente sellados, no reenvasados. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. Preservación garantizada permanente a -20 °C. CARACTERISTICAS: Hepatitis B DNA polimerasa en concentración y con preservantes acordes a pedido de usuario. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos
277	030105363	Kit Chlamydia trachomatis-Biomolecular	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la cuantificación del DNA de Chlamydia trachomatis (Opcional prueba combinada con detección de Neisseria gonorrhoeae) en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA: Secreción Cervical, Secreción Uretral, Orina.
278	030105362	Kit citomegalovirus Carga Viral	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la cuantificación del DNA de Citomegalovirus en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.



279	030105366	Kit de detección ADN Mycobacterium tuberculosis	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la detección del DNA de Mycobacterium tuberculosis en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52 y Cabina de Seguridad Biológica tipo III que permitan la realización completa y segura de la prueba. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones respiratorias, Líquidos Biológicos, Tejidos.
280	030103669	Kit de DNTPs para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Vial herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Mezcla de 4 Nucleótidos: dTTP, dATP, dGTP y dCTP, con una concentración de 10 mM en 1 mM de Tris-HCl (pH 7.5), listo para usar. USO: Amplificación de Acidos Nucleicos.
281	030105963	Kit de Hepatitis C Carga viral	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la Cuantificación del RNA viral (Carga Viral) de Hepatitis C en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
282	030104050	Kit de Hepatitis C Genotipificación biomolecular	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la identificación de genotipos 1A, 1B, 2 y 3 (como mínimo) del virus de Hepatitis C en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos ó Hibridación en Tira o por secuenciamiento genotípico ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51, 52 ó 53. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
283	030104049	Kit de Mycobacterium tuberculosis resistencia genotípica a drogas	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la identificación de cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a drogas antituberculosas, en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos ó Hibridación en Tira ó secuenciamiento biomolecular ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52 y Cabina de Seguridad Biológica tipo III que permitan la realización completa y segura de la prueba. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones respiratorias, Líquidos Biológicos, Tejido.
284	030102801	Kit de Papiloma Virus Humano Detección biomolecular	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la detección del ADN de Papilomavirus Humano en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos ó Hibridación en Tira. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones Cervicovaginales.
285	030103638	Kit de Papiloma Virus Humano Tipificación biomolecular	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la Tipificación del ADN de Papilomavirus Humano (tipo 6, 11, 16, 18 y 33 como mínimo), en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos ó Hibridación en Tira. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones Cervicovaginales.



286	030105365	Kit hepatitis B-Carga Viral	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la Cuantificación del DNA viral (Carga Viral) de Hepatitis B en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
287	030105960	Kit HIV Carga viral	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la Cuantificación del RNA viral (Carga Viral) del VIH en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
288	030104001	Kit HIV genotipo resistencia a tratamiento	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la determinación de Genotipos de HIV resistentes a inhibidores de Transcriptasa Reversa y Proteasas como estudio mínimo, en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos ó Hibridación en Tira, ó secuenciamiento genotípico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51, 52 ó 53. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
289	030105966	Kit para la detección biomolecular de Leucemia Linfática Aguda	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la detección biomolecular de la Leucemia Linfática Aguda en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, Tejido.
290	030105964	Kit para detección biomolecular del Cromosoma X Frágil	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la detección del Cromosoma X Frágil en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, Tejido.
291	030105965	Kit para detección biomolecular del gen de la Distrofina	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la detección de mutaciones de los Exones 8, 17, 19, 44, 45, 48, 12, 51, 4, 3, 6, 13, 43, 47, 50, 52, 60 y el Promotor Específico del Músculo del Gen de la Distrofina, en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, Tejido.
292	030105967	Kit para la detección biomolecular de Leucemia Mieloide Crónica	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la detección biomolecular de la Leucemia Mieloide Crónica en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, Tejido.




293	030104867	Kit para la extracción de DNA	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos y Complementos que permitan la extracción rápida del DNA, en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Kit con Soluciones para Lisis Celular, Lisis Nuclear, Precipitación de Proteínas y de Rehidratación del DNA; RNAasa; Isopropanol. USO: Extracción de DNA en muestras de Sangre Periférica (3 ml), Tejidos y Secreciones. ACCESORIOS: Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba.
294	030103772	Kit para la extracción de RNA	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos y complementos que permitan la extracción rápida del RNA en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Kit para la extracción de RNA según la Técnica de Peter Chomczynski. USO: Extracción de RNA en muestras de Sangre Periférica y Médula Osea. ACCESORIOS: Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba.
295	030105968	Kit para Secuencia Específica del Cromosoma Y	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la detección de la Secuencia Específica del Cromosoma Y, en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre, anticoagulada, Tejido.
296	030102105	Marcador DNA de peso molecular 100 Bp Ladder	UN	4	PRESENTACION: Vial de 50 ug, bufferado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Marcador de peso molecular para determinar los tamaños de bandas de las muestras de ADN amplificadas en un rango de 100 a 1500 bp, con intervalo de 100 bp. USO: Pruebas de Biología Molecular.
297	030105946	Marcador DNA de Peso Molecular ø X174 /Hae III DIGEST	UN	4	PRESENTACION: Vial de 0.5 ug/uL, buferado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Marcador de peso molecular para determinar los tamaños de bandas de las muestras de ADN amplificadas en un rango de 72 a 1353 bp. USO: Pruebas de Biología Molecular.
298	030105945	Marcador DNA de Peso Molecular pUC18 /Hae III DIGEST	UN	4	PRESENTACION: Vial de 0.522 ug/ul, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Marcador de peso molecular para determinar los tamaños de bandas de las muestras de ADN amplificadas en un rango de 11 a 587 bp. USO: Pruebas de Biología Molecular.
299	030103324	Microtubo para detección biomolecular de 0.2 mL con tapa	UN	4	PRESENTACION: Microtubo de Plástico en empaque de 96 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Microtubo de 0.2 ml, estéril, descartable, con tapa plana para microcierre para 8 microtubos o en forma individual. Libre de RNAsa, DNAsa, ADN. USO: Para Reacción en Cadena de la Polimerasa (sin aceite) ú otro método de Amplificación de Acidos Nucleicos.
300	030102212	MOPS EDTA Acetato de Sodio	CM 3	4	PRESENTACION: MOPS EDTA Acetato de Sodio en Frasco por 1000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Buffer MESA, pH 7.0 aproximado, Concentración mínima 99%. USO: Biología Molecular.
301	030102225	N-N-Metilenbisacrilamida	G	4	PRESENTACION: N-N-Metilenbisacrilamida en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado molecular, Concentración mínima 99.5%. USO: Biología Molecular.





302	030102267	Oligo Biotinilado de 200 umol para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Reactivo en Vial, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Vial de Oligo Biotinilado de 200 umol. USO: Pruebas de Biología Molecular.
303	030105368	Oligo Dr3B de 200 umol para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Reactivo en Vial, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Vial de Oligo Dr3B de 200 umol. USO: Pruebas de Biología Molecular.
304	030103621	Oligo Fluoresceinado de 200 umol para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Reactivo en Vial, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Vial de Oligo Fluoresceinado de 200 umol. USO: Pruebas de Biología Molecular.
305	030103622	Oligo gh 46 de 200 umol para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Reactivo en Vial, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Vial de Oligo gh 46 de 200 umol. USO: Pruebas de Biología Molecular.
306	030103623	Oligo neb 11 de 200 umol para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Reactivo en Vial, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Vial de Oligo neb 11 de 200 umol. USO: Pruebas de Biología Molecular.
307	030103624	Oligo neb 4 de 200 umol para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Reactivo en Vial, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Vial de Oligo neb 4 de 200 umol. USO: Pruebas de Biología Molecular.
308	030103625	Oligo neb 9 de 200 umol para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Reactivo en Vial, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Vial de Oligo neb 9 de 200 umol. USO: Pruebas de Biología Molecular.
309	030103626	Oligo p01 de 200 umol para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Reactivo en Vial, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Vial de Oligo p01 de 200 umol. USO: Pruebas de Biología Molecular.
310	030103627	Oligo p02 de 200 umol para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Reactivo en Vial, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Vial de Oligo p02 de 200 umol. USO: Pruebas de Biología Molecular.
311	030105974	Pipeta electrónica digital graduable para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Pipeta Electrónica Multicanal. CARACTERISTICAS: Pipeta programable, de 12 canales, con rango mínimo de 25 a 250 ul, con accesorios completos, compatible con punteras universales, con batería recargable. USO: Para procedimientos de Biología Molecular.
312	030105975	Pipeta pasteur de plástico punta ultrafina 1 mL a 2 mL	UN	4	PRESENTACION: Pipeta Pasteur en empaque individual. CARACTERISTICAS: Pipeta de Polietileno transparente de baja densidad, de 1 a 2 ml de capacidad, estéril, no graduada, sin bordes ni marcas en la superficie, con punta ultrafina no mayor de 1 cm. Libre de RNAsa, DNAsa, ADN. USO: Para extracción de Pellet en procedimientos de Biología Molecular ó Inmunología.
313	030105976	Pipeta pasteur de plástico punta ultrafina 3 mL a 5 mL	UN	4	PRESENTACION: Pipeta Pasteur en empaque individual. CARACTERISTICAS: Pipeta de Polietileno transparente de baja densidad, de 3 a 5 ml de capacidad, estéril, no graduada, sin bordes ni marcas en la superficie, con punta ultrafina no mayor de 1 cm. Libre de RNAsa, DNAsa, ADN. USO: Para extracción de Pellet en procedimientos de Biología Molecular ó Inmunología.




314	030105969	Primers "J" de la Inmunoglobulina para detección biomolecular	PB A	4	PRESENTACION: Reactivo en Viales con Primers "J" de la Inmunoglobulina, liofilizado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Contiene la secuencia 5' ACC TGA GGA GAC GGT GAC C. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, Tejido.
315	030105970	Primers "V" de la Inmunoglobulina para detección biomolecular	PB A	4	PRESENTACION: Vial con Primers "V" de la Inmunoglobulina, liofilizado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Contiene la secuencia 5' ACA CGG C(C/T)(G/C) TGT ATT ACT GT. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, Tejido.
316	030102575	Primers ETO/AML para detección biomolecular	PB A	4	PRESENTACION: Vial con Primers ETO/AML, liofilizado, de 200 nM por Primer, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Contiene la secuencia AML1: 5' GAA GTG GAA GAG GGA AA GCT 3'. MT68: 5' GGG GGA GGT GGC ATT GTT 3'. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, Tejido.
317	030102581	Primers para detección biomolecular de Leucemia Promielocítica Aguda (Gen Híbrido PML/RAR alfa)	PB A	4	PRESENTACION: Vial con Primers para Leucemia Promielocítica Aguda (Gen Híbrido PML/RAR alfa), liofilizado, de 200 nM por Primer, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Contiene la secuencia: Gen PML: 5' AGC TGC TGG AGG CTG TGG ACG CGC GGT ACC 3' Gen RAR alfa: 5' CCA CTA GTG GTA GCC TGA GGA CT 3'. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, Tejido.
318	030105517	Primers para detección biomolecular de Linfoma B	PB A	4	PRESENTACION: Kit completo de Reactivos para la detección de la Linfoma B en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 51 ó 52. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, Tejido.
319	030105050	Proteinasa K	G	4	PRESENTACION: Proteinasa K en Frasco por 100 mg, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado Molecular, Estéril. USO: Biología Molecular.
320	030103643	Puntera para pipeta automática con filtro para detección biomolecular rango 0.5-10 uL	UN	4	PRESENTACION: Punteras en Rack de soporte de 96 posiciones. CARACTERISTICAS: Punteras con Filtro, de baja retención, estériles, capacidad mínima de 0.5 a 10 ul, transparentes, universales. USO: Para pruebas de Biología Molecular.
321	030102668	Puntera para pipeta automática con filtro para detección biomolecular rango 200 - 1000 uL	UN	4	PRESENTACION: Punteras en Rack de soporte de 96 posiciones. CARACTERISTICAS: Punteras con Filtro, de baja retención, estériles, capacidad mínima de 200 de a 1000 ul, transparentes, universales. USO: Para pruebas de Biología Molecular.



322	030102667	Puntera para pipeta automática con filtro para detección biomolecular rango 5 - 200 uL	UN	4	PRESENTACION: Punteras en Rack de soporte de 96 posiciones. CARACTERISTICAS: Punteras con Filtro, de baja retención, estériles, capacidad mínima de 5 a 200 ul, transparentes, universales. USO: Para pruebas de Biología Molecular.
323	030105098	Reactivo TEMED	CM 3	4	PRESENTACION: Reactivo TEMED en Frasco por 100 ml ó equivalente, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado molecular, Concentración mínima 99%. USO: Biología Molecular (Electroforesis).
324	030102785	SDS (Dodecyl-sulfato de Sodio, Lauril sulfato de Sodio)	G	4	PRESENTACION: SDS (Dodecyl-sulfato de Sodio, Lauril sulfato de Sodio) en Frasco por 25 ó 50 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado Molecular, Estéril, Pureza mínima 99%, en polvo cristalino. USO: Biología Molecular.
325	030102984	Sulfato de Amonio p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Sulfato de Amonio p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado molecular, Concentración mínima 99.5%. Uso: Biología Molecular.
326	030105971	taq Polimerasa para detección biomolecular	UN	4	PRESENTACION: Kit de Taq polimerasa con Cloruro de Magnesio 25 mM y Buffer 10X sin Cloruro de Magnesio, herméticamente sellados, no reenvasados. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. Preservación garantizada permanente a -20 °C. CARACTERISTICAS: Taq Polimerasa: Concentración de 5 Unidades/uL. Buffer: 20 mM Tris-HCL (pH 8.0), 100 mM KCL, 0.1 mM EDTA, 1mM DTT, 50% Glicerol, 0.5% NONIDET-p40, 0.5% TWEEN 20. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos.
327	030103692	Tiocianato de Guanidina	G	4	PRESENTACION: Tiocianato de Guanidina en Frasco por 25 ó 100 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado molecular, Concentración mínima 99%. Uso: Biología Molecular.
328	030101914	Tris (Hidroximetil) Aminometano p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Tris (Hidroximetil) Aminometano p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado molecular, Concentración mínima 99%. USO: Biología Molecular.
329	030105700	Tris-HCl (pH 7.6) ultrapura	CM 3	4	PRESENTACION: Tris-HCl (pH 7.6) ultrapuro en Frasco por 100 ó 1000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado molecular, Concentración mínima 1 M, pH 7.60 +/- 0.05 a 25°C. USO: Biología Molecular.
330	030105317	Tris-HCl 1M (pH 8)	CM 3	4	PRESENTACION: Tris-HCl 1M (pH 8) en Frasco por 1000 ml ó equivalente, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado molecular, Concentración mínima 1 M, pH 8.00 +/- 0.1 a 25°C. USO: Biología Molecular.



331	030106033	Triton X-100	CM 3	4	PRESENTACION: Triton X-100 en Frasco por 50 ó 100 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado molecular. USO: Biología Molecular.
-----	-----------	--------------	---------	---	---




4. BIOQUIMICA



N°	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES
332	030103760	Acido Nítrico p.a.	CM 3	4	PRESENTACION: Acido Nítrico p.a. en Frasco Ambar por 1000 ó 2500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Acido Nítrico Fumante. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
333	030100104	Acido Sulfosalicílico p.a. grado ACS	G	3,4	PRESENTACION: Acido Sulfosalicílico p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
334	030100116	Acido Tricloracético p.a. grado ACS	G	3,4	PRESENTACION: Acido Tricloracético p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%. USO: Para Análisis.
335	030100140	Adenosina	G	3,4	PRESENTACION: Adenosina en Frasco por 10 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Reactivo químicamente puro, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
336	030100849	Borohidruro de Sodio	G	4	PRESENTACION: Borohidruro de Sodio en Frasco por 500 gr ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%; sinonimo: bórax o sodio borato Uso: Para Análisis.
337	030106128	Dosaje de Salicilatos	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el dosaje de Salicilatos en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmuoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Orina.
338	030104087	Dosaje de Tacrolimus	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el dosaje de Tacrolimus en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmuturbidimetría, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmuoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total anticoagulada con EDTA.
339	030104735	Dosaje de Fenitoina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el dosaje de Fenitoina en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmuturbidimetría, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmuoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
340	030104142	Dosaje de Acido Valproico	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el dosaje de Acido Valproico en empaque de 50 ó más pruebas Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Turbidimetría, Inmunoensayo Fluorescente, Inmuoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



341	030106121	Dosaje de Fenilciclidina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Fenilciclidina en empaque de 50 ó más pruebas Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
342	030104736	Dosaje de Fenobarbital	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Fenobarbital en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
343	030104790	Dosaje de Gentamicina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Gentamicina en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
344	030101314	Dosaje de Marihuana	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Marihuana (metabolitos) en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunocromatografía, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.
345	030106122	Dosaje de Metadona	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Metadona en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.
346	030104939	Dosaje de Metotrexato	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Metotrexato en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
347	030106124	Dosaje de Opiáceos	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Opiáceos en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.




348	030106125	Dosaje de Procaínamida	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Procaínamida en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Orina
349	030106126	Dosaje de Propoxifeno	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Propoxifeno en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Orina.
350	030106127	Dosaje de Quinidina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Quinidina en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Orina.
351	030105381	Dosaje de Teofilina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Teofilina en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
352	030106130	Dosaje de Tobramicina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Tobramicina en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
353	030105339	Dosaje de Vancomicina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Vancomicina en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
354	030104185	Dosaje de Amikacina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Acido Amikacina en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.





355	030106112	Dosaje de Anfetamina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Anfetamina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
356	030106113	Dosaje de Antidepresivos Tricíclicos	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Antidepresivos tricíclicos en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
357	030104434	Dosaje de Barbitúricos	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Fenobarbital en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
358	030104443	Dosaje de Benzodiazepina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Benzodiazepina en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma u Orina.
359	030104484	Dosaje de Carbamazepina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Carbamazepina en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria; Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
360	030104526	Dosaje de Ciclosporina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Ciclosporina en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre Total Anticoagulada con EDTA.
361	030104578	Dosaje de Cocaína	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Cocaína (metabolitos) en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunocromatografia, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.





362	030104646	Dosaje de Digoxina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Digoxina en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
363	030104530	Dosaje de Etanol	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Etanol en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
364	030106123	Dosaje de N-acetilprocainamida	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de N-acetilprocainamida en empaque de 50 ó más pruebas tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Orina
365	030106129	Dosaje de Sirolimus	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Sirolimus en empaque de 50 ó más pruebas Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 1,2,3,4,5,7 u 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total anticoagulada con EDTA.
366	030103809	Electroforesis de Inmunofijación	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la Electroforesis de Inmunofijación en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunofijación en Gel de Agarosa o Electroforesis Capilar. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 15, 16 ó 17. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma, Orina, Líquidos Biológicos.
367	030105910	Electroforesis de Orina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la Electroforesis de Orina en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunofijación en Gel de Agarosa o Electroforesis Capilar. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 15, 16 ó 17. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.
368	030106132	Electroforesis de banda Oligoclonales LCR	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para Electroforesis de banda Oligoclonales LCR en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Electroforesis en acetato de Celulosa, Gel de Agarosa o Electroforesis Capilar. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 15, 16 ó 17. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Líquido ceforraquídeo.





369	030105909	Electroforesis de Hemoglobina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la Electroforesis de Hemoglobina en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Electroforesis en acetato de Celulosa, Gel de Agarosa o Electroforesis Capilar. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos tipo 15, 16 ó 17. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total anticoagulada con EDTA.
370	030105692	Electroforesis de Proteínas	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la Electroforesis de Proteínas en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunofijación en Gel de Agarosa o Electroforesis Capilar. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 15, 16 ó 17. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma, Orina, Líquidos Biológicos.
371	030106131	Electroforesis de Proteínas de Bence - Jones	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la Electroforesis de Proteínas de Bence Jones en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunofijación en Gel de Agarosa o Electroforesis Capilar. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 15, 16 ó 17. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina, Líquidos Biológicos.
372	030105934	Kit completo para electrolitos sanguíneos arteriales Equipo Propio	PB A		PRESENTACIÓN: Kit de reactivos para el dosaje de Electrolitos (Na,K,Cl y/o Ca++) en equipo propio indicado en una tabla adicional en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: ISE Directo y/o Métodos Complementarios. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Electrodo(s), Soluciones de Limpieza y Acondicionamiento, Diluyentes, Cintas y Papel de impresión, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total con Heparina, Suero, Orina.
373	030105520	Kit completo para Gases Electrolitos Sanguíneos Arteriales	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Kit de reactivos para el dosaje de Gases y Electrolitos (Na, K, Cl y/o Ca++) Sanguíneos Arteriales en empaque de 50 o más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Potenciometría, ISE directo y/o Medición Electroquímica y/o Métodos Complementarios. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Electrodo(s), Membranas, Soluciones de Limpieza y Acondicionamiento, Cintas y Papel de impresión, Complementos y Accesorios y equipos TIPO 19. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total con Heparina.
374	030105940	Kit completo para Gases Electrolitos Sanguíneos Arteriales Equipo Propio	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Kit de reactivos para el dosaje de Gases y Electrolitos Sanguíneos Arteriales en Equipo Propio indicado en una tabla adicional, en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Potenciometría, ISE directo y/o Medición Electroquímica y/o Métodos Complementarios. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Electrodo(s), Membranas, Soluciones de Limpieza y Acondicionamiento, Cintas y Papel de impresión, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total con Heparina.




375	030103774	Kit completo para Gases Electrolitos y Metabolitos Sanguíneos Arteriales	PB A	2,3,4	PRESENTACIÓN: Kit de Reactivos para el dosaje de Gases, Electrolitos (Na, K, Cl y/o Ca⁺⁺. Opcional Mg⁺⁺), Hemoglobina y/o Hematocrito y Metabolitos (Glucosa y Lactato. Opcional Urea y/o Creatinina) Sanguíneos Arteriales en empaque de 50 o más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Potenciometría, Fotometría, ISE directo y/o Medición Electroquímica y/o Métodos Complementarios. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Electrodo, Membranas, Soluciones de Limpieza y Acondicionamiento, Cintas y Papel de impresión, Complementos y Accesorios y equipos TIPO 18. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total con Heparina.
376	030105939	Kit completo para Gases Sanguíneos Arteriales Equipo Propio	PB A	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Kit de reactivos para el dosaje de Gases Sanguíneos Arteriales en Equipo Propio indicado en una tabla adicional en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Potenciometría, ISE directo y/o Medición Electroquímica y/o Métodos Complementarios. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Electrodo, Membranas, Soluciones de Limpieza y Acondicionamiento, Cintas y Papel de impresión, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total con Heparina.
377	030105010	Piramidón	G	1 - 4	PRESENTACION: Piramidón en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: 4-Amino Antipirine, Ampirone. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Polvo libre de impurezas. USO: Para Análisis.
378	030102487	Pirrolidinedithiocarbamato	G	4	PRESENTACION: Pirrolidinedithiocarbamato en Frasco por 25 gr 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Sal de amonio, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
379	030100815	Reactivo de Bilirubina Total	PB A	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Bilirubina Total en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final. METODOLOGIA: Método Núcleo Diazo ó Método equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Líquidos Biológicos.
380	030104453	Reactivo de Bilirubina Total Y Fraccionada	PB A	1,2	PRESENTACIÓN: Kit de Reactivos para la determinación de Bilirubina Total y Fraccionada en empaque de 20 ó más pruebas. Cada prueba comprende un Test de Bilirubina Total y un test de Bilirubina Fraccionada. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Jendrassik-Grof (Diazo con Acido Sulfanílico). Espectrofotométrico, Cinético, Punto final. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Protocolos de Adaptación para equipos TIPO 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Líquidos Biológicos.
381	030104476	Reactivo de Calcio	PB A	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Calcio Total en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Azul de Metil Timol, Complexométrico ó equivalente. Colorimétrico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Orina.



382	030104548	Reactivo de CK-MB Cinético	PB A	2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Creatinina Isoenzima MB en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método de Inmunoinhibición Enzimático. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
383	030102065	Reactivo de Colesterol LDL Directo	PB A	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Colesterol LDL en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático Directo Homógeno. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
384	030104589	Reactivo de Colinesterasa	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Colinesterasa sérica o eritrocitaria de acuerdo a necesidad del servicio, en empaque de 100 o más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método con Sustrato Butirilcolina ó equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
385	030101249	Reactivo de Creatinina Cinética	PB A	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Creatinina en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método de Picrato Alcalino sin desproteinización. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
386	030101302	Reactivo de Deshidrogenasa Láctica	PB A	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Deshidrogenasa Láctica en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
387	030104756	Reactivo de Fosfatasa Ácida	PB A	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Fosfatasa Ácida Total y Fracción Prostática en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método 1 - Nafil Fosfato, con Tátrato para NPP. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
388	030104759	Reactivo de Fosfatasa Alcalina	PB A	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Fosfatasa Alcalina en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
389	030104779	Reactivo de Fósforo	PB A	2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Fósforo en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Fosfomolibdato UV. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.




390	030104842	Reactivo de Hierro Sérico	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hierro Sérico en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Colorimétrico Ferrozina sin precipitación. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
391	030100011	Reactivo de 5 Nucleotidasa	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de 5 Nucleotidasa en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático UV ((Adenosina Deaminasa – GLDH ó similar). ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Protocolos de adaptación, para equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
392	030105423	Reactivo de Ácido Úrico	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Ácido Úrico en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático Uricasa – Peroxidasa, Espectrofotométrico, Cinético, Punto final. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
393	030105995	Reactivo de Ácidos Biliares	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Ácidos Biliares en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Colorimétrico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Protocolos de Adaptación para equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
394	030105213	Reactivo de Adenosina Deaminasa Enzimático	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación Espectrofotométrico, Cinético, Punto final de Adenosina Deaminasa en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático (GLDH). ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Protocolos de Adaptación para equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Líquidos Biológicos, Suero.
395	030103776	Reactivo de Albúmina	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Albúmina en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Verde de Bromocresol. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero, Plasma con Heparina o EDTA.
396	030103778	Reactivo de Aldolasa	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación Espectrofotométrico, Cinético, Punto final de Aldolasa en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Fructuosa 1 - 6 - Difosfato Aldolasa. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Protocolos de Adaptación para equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero, Plasma con Heparina o EDTA.



397	030105710	Reactivo de Amilasa	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Amilasa en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Orina, Líquidos Biológicos.
398	030106176	Reactivo de Aminoácidos Urinarios Kit	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Aminoácidos urinarios en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Colorimétrico, Enzimático, Inmunoensayo homogéneo, Inmunoensayo fluorescente ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Orina, Líquidos Biológicos.
399	030103780	Reactivo de Amoniacó	PB A	2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Amoniacó en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático UV (GLDH). ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma con Heparina ó EDTA.
400	030100532	Reactivo de Antioxidantes Totales	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Antioxidantes totales en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método electroquímico, Inmunoensayo homogéneo, Inmunoensayo fluorescente ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Orina, Líquidos Biológicos.
401	030100811	Reactivo de Bilirubina Directa	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Bilirubina Directa en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Núcleo Diazo ó Método equivalente. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Líquidos Biológicos.
402	030105994	Reactivo de Cálculos Urinarios Kit	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Kit de Reactivos para el estudio de Cálculos Urinarios en empaque de 10 ó más pruebas. Cada prueba comprende 8 Test diferentes como mínimo (Carbonatos, Cistina, Magnesio, Calcio, Amonio, Acido Úrico, Oxalato y Fosfato). Tiempo de expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Colorimétricos cualitativos de Lectura Visual. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Cálculos Urinarios.
403	030104547	Reactivo de CK Total	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Creatinínasa Total en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método CK-NAC ó equivalente. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.





404	030101157	Reactivo de Colesterol HDL Directo	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Colesterol HDL en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático Directo Homogéneo. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ó método precipitante. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
405	030101158	Reactivo de Colesterol Total Enzimático	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Colesterol Total en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método CHOD - PAD. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
406	030101739	Reactivo de Fructosamina	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Fructosamina en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Colorimétrico, Enzimático, Cromatografía ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Líquidos Biológicos.
407	030101756	Reactivo de Gamma Glutamil Transpeptidasa	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Gamma Glutamil Transpeptidasa en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
408	030101805	Reactivo de Glucosa Enzimática	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Glucosa en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático GOD-PAP. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Líquidos Biológicos.
409	030101815	Reactivo de Glutation Peroxidasa	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Glutation peroxidasa en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático, Inmunoensayo homogéneo, Quimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Líquidos Biológicos.
410	030105089	Reactivo de Lipasa	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Lipasa en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático - Colorimétrico ó UV Cinético - Turbidimétrico con Colipasa. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Orina.
411	030103817	Reactivo de Magnesio	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Magnesio en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Azul de Xilidyl, Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Orina.




412	030102738	Reactivo de Proteína en LCR y Otros Líquidos Biológicos	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Proteínas en LCR y otros líquidos Biológicos en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Rojo de Pirogalol ó Cloruro de Benzetonio ó Método Equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Líquidos Biológicos, LCR, Orina.
413	030105047	Reactivo de Proteínas Totales	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Proteínas Totales en empaques de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método de Biuret. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Líquidos Biológicos.
414	030103017	Reactivo de Superóxido Dismutasa	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Superóxido dismutasa en empaques de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático, Inmunoensayo homogéneo, Quimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Líquidos Biológicos.
415	030103213	Reactivo de Transaminasa TGO - AST	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Transaminasa TGO - AST en empaques de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático Estandarizado. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Líquidos Biológicos.
416	030103218	Reactivo de Transaminasa TGP - ALT	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Transaminasa TGP - ALT en empaques de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático Estandarizado. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
417	030103705	Reactivo de Triglicéridos Enzimático	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Triglicéridos en empaques de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método GÓD - PAD con determinación Glicerol. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
418	030103707	Reactivo de Urea Enzimática	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Urea en empaques de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Enzimático Cinético Ureasa UV. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.




419	030103707	Reactivo de Zinc	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Zinc en empaques de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Colorimétrico. Espectrofotométrico, Cinético, Punto final ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Protocolos de Adaptación para Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA, Líquidos Biológicos.
420	030104985	Reactivo Panel De Drogas de Abuso	UN	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la detección cualitativa de Drogas de Abuso en Panel (Canabinoides, Opiáceos, Barbitúricos, Anfetaminas y Cocaína como mínimo) en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Visual. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba MUESTRA BIOLÓGICA: Orina.
421	030105891	Reactivo para Electrolitos Séricos Kit Completo	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Electrolitos Séricos en empaques de 20 ó más pruebas. Cada prueba contiene un test de Sodio, un test de Cloro y un Test de Potasio como mínimo. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: ISE Indirecto ó Directo y/o medición Electroquímica, incorporado a autoanalizador Bioquímico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero, Plasma con Heparina, Líquidos Biológicos.
422	030103797	Reactivos de Capacidad de Fijación de Hierro	PB A	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Capacidad de Fijación de Hierro en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método UIBC ó Método TIBC (Saturación de Hierro, Precipitación con Carbonato de Magnesio). ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 6. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero, Plasma con Heparina ó EDTA.
423	030106002	Solución Estándar de Cadmio	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ó 500 ml de estándar de Cadmio, Herméticamente sellado, no reenvasado. CARACTERÍSTICAS: Cadmio nitrato en Acido Nítrico 0.5 mol/L. Concentración de Cadmio 1000 mg/L Uso: Para Absorción Atómica.
424	030106178	Solución Estándar de Cobre	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ó 500 ml de estándar de Cobre, Herméticamente sellado, no reenvasado. CARACTERÍSTICAS: Concentración de Cobre 1000 mg/dl Uso: Para Absorción Atómica.
425	030105136	Solución Estándar de Litio	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ó 500 ml de estándar de Litio, Herméticamente sellado, no reenvasado. CARACTERÍSTICAS: Litio nitrato de Agua, concentración de Litio 1000 mg/dl Uso: Para Absorción Atómica.
426	030106003	Solución Estándar de Mercurio	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ó 500 ml de estándar de Mercurio, Herméticamente sellado, no reenvasado. CARACTERÍSTICAS: Mercurio (II) nitrato de Acido Nítrico 0.5 mol/L, concentración de Mercurio 1000 mg/l. Uso: Para Absorción Atómica.
427	030106004	Solución Estándar de Plomo	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ó 500 ml de estándar de Plomo, Herméticamente sellado, no reenvasado. CARACTERÍSTICAS: Plomo (II) nitrato de Acido Nítrico 0.5 mol/L, concentración de Plomo 1000 mg/l. Uso: Para Absorción Atómica.
428	030106179	Solución Estándar de Zinc	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ó 500 ml de estándar de Zinc, Herméticamente sellado, no reenvasado. CARACTERÍSTICAS: Concentración de Zinc 1000 mg/l. Uso: Para Absorción Atómica.





429	030102631	Test cualitativo de Embarazo	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona Gonadotrofina Coriónica fracción Beta y/o Hormona Gonadotropina Coriónica Total. en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Aglutinación en Látex, Inmunocromatografía, Enzimoimmunoensayo ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLÓGICA: Orina o Suero
430	030105987	Test de Lipoproteína A	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Lipoproteína A en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimático, Inmunoturbidimetría, Enzimoimmunoensayo, Inmunoluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o Plasma.
431	030106025	Test de Madurez Fetal	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de la Madurez Pulmonar Fetal en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensoyos Fluorescente, Inmunoluminiscencia, Electroquimioluminiscencia o Cromatografía en Capa Fina. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Líquidos Amnióticos.
432	030103777	Test de Microalbuminuria	PB A	2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Microalbuminuria en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 5. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Orina.
433	030102207	Test de Mioglobina	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Mioglobina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensoyos Fluorescente, Inmunoluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o Plasma.
434	030103111	Test de Osteocalcina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Osteocalcina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensoyos Fluorescente, Inmunoluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o Plasma.
435	030105980	Test de Cistatina C	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Cistatina C en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría, Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o Plasma.
436	030105510	Test de Fenilcetonuria	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Fenilalanina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimoimmunoensayo, Inmunoensoyos Fluorescente, Inmunoluminiscencia o Electroquimioluminiscencia, Cromatografía de columna. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10 u 11. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Orina





437	030103804	Test de Ferritina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Ferritina en empaque de 100. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10 u 11. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total en Papel de Filtro, Suero o Plasma.
438	030105220	Test de Hormona ACTH	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Adrenocorticotrópica en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
439	030103819	Test de Metanefrina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Metanefrinas en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimoinmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Cromatografía de Columna más Espectrofotometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11 ó 12. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.
440	030106026	Test de Receptor de TSH	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Receptor de TSH en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. (Excepto de Inmunoensayo de Radioreceptor: no menor de 2 meses). METODOLOGIA: Enzimoinmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunoensayo de Radioreceptor (RRA). ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,12 ó 13. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
441	030106028	Test de Receptor de Vitamina D	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Receptor de Vitamina D en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimoinmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11 ó 12. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
442	030106027	Test de Receptor Soluble de Transferrina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Receptor Soluble de Transferrina en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 5 de acuerdo a Metodología o Protocolo de adaptación para equipos TIPO 1,2,3 ó 4. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
443	030102012	Test de Resorción Ósea	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Productos de Degradación de Matriz Ósea en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo homogéneo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma u Orina.
444	030105257	Test de Tiroglobulina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Tiroglobulina en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.




445	030103830	Test de Transferrina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Transferrina en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Espectrofotometría, Inmunoturbidimetria, Inmunoensayo quimioluminiscente ó fluorescente ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 5. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
446	030105257	Test de Transferrina Deficiente en Ácido Sialico	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Transferrina Deficiente en Ácido Sialico en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria ó Nefelometria. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 5 de acuerdo a Metodología o Protocolo de adaptación para equipos TIPO 1,2,3 ó 4. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
447	030106030	Test de Tripsina Neonatal	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Tripsina Neonatal en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimoimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10 u 11. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre Total en Papel de Filtro, Suero o Plasma.
448	030103251	Test de Troponina	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Troponina en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
449	030104425	Test de Vitamina B12	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Vitamina B12 en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
450	030106031	Test de Vitamina D	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Vitamina D en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
451	030105290	Test para Detectar Sangre en Heces	PB A	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivo en tarjeta o tira, para la detección de Hemoglobina o Albúmina en Heces en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Colorimétrico de Lectura Visual o Inmunoensayo Rápido de Lectura Visual. MUESTRA BIOLOGICA: Heces.
452	030103814	Test de Homocisteina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Homocisteina en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.




453	030104106	Test de 5 Hidroxiindol Acético	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de 5 Hidroxi Indol Acético en empaques de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimoimmunoensayo, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Cromatografía de Columna más Espectrofotometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11 ó 12. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.
454	030104123	Test de Ácido Deltaminolevulinico	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Ácido Aminolevulinico en empaques de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimoimmunoensayo, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Cromatografía de Columna más Espectrofotometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11 ó 12. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.
455	030100128	Test de Ácido Fólico	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Ácido Fólico empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
456	030100128	Test de Ácido Vanilmandelico	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Ácido Vanilmandelico en empaques de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimoimmunoensayo, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Cromatografía de Columna más Espectrofotometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11 ó 12. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.
457	030103779	Test de Alfa 1 Antitripsina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Alfa 1 Antitripsina en empaques de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Nefelometria. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 5 de acuerdo a Metodología o Protocolos de Adaptación para equipos TIPO 1,2,3 ó 4. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
458	030103836	Test de Alfa 1 Glicoproteina acida	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Alfa 1 Glicoproteina Acida en empaques de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Nefelometria. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 5 de acuerdo a Metodología o Protocolos de Adaptación para equipos TIPO 1,2,3 ó 4. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
459	030103837	Test de Alfa 2 Macroglobulina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Alfa 2 Macroglobulina en empaques de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Nefelometria. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 5 de acuerdo a Metodología o Protocolos de Adaptación para equipos TIPO 1,2,3 ó 4. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.




460	030106013	Test de AMP Cíclico	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de AMP Cíclico en empaques de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimoimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia ó electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11 ó 12. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma u Orina.
461	030104407	Test de Apolipoproteína A	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Apolipoproteína A en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Nefelometria. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 5. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
462	030104408	Test de Apolipoproteína B	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Apolipoproteína B en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Nefelometria. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1,2,3,4 ó 5. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
463	030106183	Test de BNP/Pro BNP	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de BNP ó Pro BNP en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia y Fluorescencia. Inmunoensayo de lectura visual ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma ó Sangre Total
464	030103798	Test de Ceruloplasmina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Ceruloplasmina en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetria, Nefelometria. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos TIPO 1, 2, 3 ó 4. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
465	030105338	Test de Coproporfirinas	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Coproporfirinas en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimoimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Cromatografía de Columna más Espectrofotometria. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11 ó 12. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.
466	030104788	Test de Galactosemia	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Galactosemia en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimoimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia, Cromatografía de columna. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10 u 11. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total en Papel de Filtro, Suero o Plasma.





467	030105237	Test de Globulina de Unión Sexual	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Globulina de Unión Sexual en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
468	030103812	Test de Haptoglobina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Haptoglobina en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Espectrofotométrico, Inmunoquimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
469	030103810	Test de Hemoglobina Glicosilada	PB A	2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hemoglobina A 1c en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia, ó Cromatografía ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 1,2,3,4,5,7,8 ó 55. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre Total Anticoagulada EDTA.
470	030105222	Test de Hormona Aldosterona	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Aldosterona en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
471	030105223	Test de Hormona Androstenediona	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Androstenediona en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
472	030106019	Test de Hormona Arginina - Vasopresina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Arginina-Vasopresina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. (Excepto Radioinmunoanálisis: no mayor de 15 días a partir de la fecha de entrega.). METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7,8 ó 13. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
473	030105239	Test de Hormona Beta Gonadotropina Coriónica	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Gonadotropina Coriónica fracción Beta y/o Hormona Gonadotropina Coriónica Total, en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.



474	030106020	Test de Hormona Beta HCG Fracción Libre	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Beta Gonadotropina Coriónica Fracción Libre en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
475	030105226	Test de Hormona Calcitonina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Calcitonina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
476	030105227	Test de Hormona Cortisol	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Cortisol en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
477	030104609	Test de Hormona Cortisol en Orina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Cortisol en Orina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.
478	030105229	Test de Hormona de Crecimiento	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona de Crecimiento en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
479	030104623	Test de Hormona Dehidroepiandrosterona Sulfato	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Dehidroepiandrosterona Sulfato en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
480	030105231	Test de Hormona Estradiol	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Estradiol en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
481	030105232	Test de Hormona Estríol Libre	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Estríol Libre (no conjugado) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma o Líquido Amniótico.




482	030105233	Test de Hormona FSH	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Foliculostimulante en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
483	030105235	Test de Hormona Gastrina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Gastrina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
484	030105238	Test de Hormona Glucagon	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Glucagon en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. (Excepto Radioinmunoanálisis: no menor de 2 meses). METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia o Radioinmunoanálisis. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7, 8 ó 13. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
485	030105240	Test de Hormona Insulina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Insulina en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
486	030105241	Test de Hormona Lactogeno Placentario	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Lactogeno Placentario en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. (Excepto Radioinmunoanálisis: no mayor de 15 días). METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia o Radioinmunoanálisis. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7, 8 ó 13. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
487	030105242	Test de Hormona LH	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Luteinizante en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
488	030103829	Test de Hormona Paratiroidea	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Paratiroidea en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
489	030105260	Test de Hormona Peptido C	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Peptido C en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.



490	030106022	Test de Hormona Polipeptido Intestinal Pancreático	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Polipeptido Intestinal Vasoactivo en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. (Excepto Radioinmunoanálisis: no menor de 2 días). METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia o Radioinmunoanálisis. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7,8 ó 13. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
491	030106021	Test de Hormona Polipeptido Intestinal Vasoactivo	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Polipeptido Intestinal Vasoactivo en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. (Excepto Radioinmunoanálisis: no menor de 15 días). METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia o Radioinmunoanálisis. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7,8 ó 13. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
492	030105219	Test de Hormona Progesterona	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Progesterona en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
493	030105218	Test de Hormona Progesterona Neonatal	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Progesterona Neonatal en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10 u 11. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total en Papel de Filtro, Suero o Plasma.
494	030105246	Test de Hormona Prolactina	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Prolactina en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
495	030103086	Test de Hormona Renina	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para el determinación de Hormona Renina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 u 8. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
496	030105248	Test de Hormona T3 Libre	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona T3 Libre en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
497	030105251	Test de Hormona T4 Libre	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona T4 Libre en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
498	030105255	Test de Hormona Testosterona Libre	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona Testosterona Libre en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. (Excepto Radioinmunoanálisis: no menor de 15 días). METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente Inmunoquimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia o Radioinmunoanálisis. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7,8 ó 13. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.





499	030105256	Test de Hormona Testosterona Total	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona Testosterona Total en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
500	030104100	Test de Hormona TSH	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona TSH en empaque de 100 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y equipos TIPO 7 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
501	030106018	Test de Hormona TSH Neonatal	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona TSH Neonatal en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzima inmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Inmunoquimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10 u 11. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre total en Papel de Filtro, Suero o Plasma.
502	030105294	Tira Reactiva para Orina	UN	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Reactivos en Tira para la detección de Densidad, pH, Leucocitos, Nitritos, Proteínas, Glucosa, Cuerpos Cetónicos, Bilirrubina, Sangre y Urobilinógeno, como mínimo; con inhibición o detección de ácido ascórbico; en empaque de 100 ó más tiras. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Método Colorimétrico de Lectura Visual o Reflectometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 20,21,22 ó 23. El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina.
503	030103393	Urodensímetro	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Urodensímetro sin Termómetro en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Urodensímetro de vidrio, de 130 mm de longitud aproximada, con rango de medición de 1.000 a 1.060 gr/cm ³ , graduado en escala de 0.001 gr/cm ³ , ajustado a temperatura de referencia de 20°C. USO: Medición de Densidad Urinaria.





5. CITOGENETICA


N°	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES
504	30106198	Amethopterin (MTX)	G	4	PRESENTACIÓN: Reactivo en frasco herméticamente sellado, por 10-50 mg. No reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado analítico ACS-Hidratado 98% USO: Sincronización celular.
505	30101151	Colchicina	G	4	PRESENTACIÓN: Colchicina en Frasco por 1 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 95%. USO: Cultivo Celular.
506	30105586	Cultivo de cromosomas con Fitohemaglutinina	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio de Cultivo de cromosomas con fitohemaglutinina en frasco de 100 CM3 o equivalente, herméticamente sellado. No reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio completo con Suero fetal de Ternera, Penicilina, mas Estreptomicina, Glutamina y Fitohemaglutinina. USO: Cultivo de células sanguíneas.
507	30106109	DAPI (4-6 Dianidino-2 fenil INDOL)	G	4	PRESENTACIÓN: Reactivo en frasco herméticamente sellado por 1mgr-100mgrs. No reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado analítico, cristalino. USO: Cultivo celular.
508	30106134	Factor de crecimiento celular IGF-1	G	4	PRESENTACIÓN: Reactivo liofilizado, herméticamente sellado por 10 mg, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Liofilizado, de Escherichia Coli Recombinante, con actividad mitótica para varios tipos celulares, peso molecular: 7.7 Kd. USO: Cultivo celular GARANTIA DE CALIDAD: Calidad de pureza mayor al 95% para SDS-PAGE y HPLC.
509	30104827	HEPES bufferado (1 M)	CM 3	4	PRESENTACIÓN: HEPES bufferado (1 M) en Frasco por 20 ó 100 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración 1 Molar (238.3 gr/l). USO: Para Cultivo Celular.
510	30106174	Lámina para Cultivo Celular In Situ	UN	4	PRESENTACIÓN: Lámina más portalámina para cultivo celular en empaque por 12 o más unidades. CARACTERISTICAS: Lámina de vidrio con bordes hidrofóbicos que define las áreas de cultivo. Superficie de crecimiento: 2 pozos. Área de pozo: 4 cm2 Portalámina (camarita) de polystirene estéril USO: Cultivos celulares In Situ
511	30105943	L-Glutamina	G	4	PRESENTACIÓN: L-Glutamina en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: L-Glutamina liofilizada; Concentración de 29.2 mg/ml en Cloruro de Sodio al 0.85% (200 mmol/L), pH 4:7 a 5.6. USO: Cultivo Celular.
512	30106175	Línea Celular para cultivo in vitro	UN	4	PRESENTACIÓN: Ampollas con células congeladas de 75 CM3 CARACTERISTICAS: Ampollas con células de Línea Celular Hela (origen de carcinoma de cervix humano) con tipo celular monocapa epitelial USO: Para Cultivos celulares In vitro
513	30104916	Medio 199	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio 199 en Frasco 100 ó 500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio estéril que contenga Sales de Earle y L-Glutamina y Bicarbonato de Sodio. USO: Cultivo Celular.
514	30105951	Medio Cultivo Celular Chang B + C	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio Cultivo Celular Chang B en Frasco por 90 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio Líquido Chang (B). Debe adicionarse Suplemento liofilizado (C) de Factores de Crecimiento Celular en cantidad suficiente para la preparación del Medio, en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado, Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. USO: Cultivo en monocapa.



515	30103618	Medio Cultivo Celular Completo	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio Cultivo Celular Completo en Frasco 100 ml ó equivalente, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio completo enriquecido con todos los Factores de Crecimiento Celular. USO: Crecimiento de Amniocitos.
516	30105948	Medio Cultivo Celular GCT (Medio Tumor de Células Gigantes)	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio Cultivo Celular GCT (Medio Tumor de Células Gigantes) en Frasco 10 ml ó equivalente, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio de enriquecimiento Celular. USO: Cultivo de Células Hematopoyéticas.
517	30105949	Medio Cultivo Celular HAM f-10	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio Cultivo Celular HAM f-10 en Frasco por 100 ó 500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio estéril con L-glutamina. USO: Cultivo Celular.
518	30105950	Medio Cultivo Celular HAM f-12	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio Cultivo Celular HAM f-12 en Frasco por 100 ó 500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio estéril con L-glutamina. USO: Cultivo celular.
519	30104915	Medio Cultivo Celular Mc Coy's	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio Cultivo Celular Mc Coy's en Frasco por 100 ó 500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio estéril con L-glutamina. USO: Cultivo celular
520	30105109	Medio Cultivo Celular RPMI 1640	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio Cultivo Celular RPMI 1640 en Frasco 100 ó 500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio estéril con L-glutamina. USO: Cultivo celular
521	30103616	MOPS p.a.	G	4	PRESENTACIÓN: MOPS p.a. en Frasco por 25 ó 100 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Acido 3-Morfolinopropanosulfónico. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado Molecular, Concentración mínima 99%. USO: Para Cultivo Celular.
522	30105402	Phytohemaglutinina M	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Phytohemaglutinina M en Frasco por 10 ó 25 ó 100 mg, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Liofilizado, concentración 10 ug/ml. USO: Cultivo Celular.
523	30102716	Reactivo Demecolcemid Liofilizado x 1 mg	FR	4	PRESENTACIÓN: Reactivo Demecolcemid Liofilizado en Frasco por 1 mg, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Liofilizado, para rehidratación con 10 ml de Agua Destilada. USO: Cultivo Celular.
524	30105164	Suero Bovino Fetal 30M(cs)	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Suero Bovino Fetal 30M (cs) en Frasco 100 ó 500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio Suplementario para los Medios de Cultivo. USO: Cultivo Celular para Estudio Cromosómico.
525	30106180	TPA (12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate)	G	4	PRESENTACIÓN: Reactivo en frasco herméticamente sellado, por 1mgr-25mgrs. No reenvasado. Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado analítico. Soluble en DMSO o Etanol USO: Cultivo celular.




526	30103240	Tripsina 1/250	G	4	PRESENTACIÓN: Tripsina en Frasco por 100 gr ó equivalente, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Tripsina de Páncreas porcino con actividad de 1000 a 1500 BAE por mg de sólido, debe contener Quimotripsina. USO: Identificación de Bandas Cromosómicas.
-----	----------	----------------	---	---	--



6. CITOMETRIA DE FLUJO

Nº	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES
527	030106076	CF Anticuerpo Antiplaquetario kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de anticuerpos plaquetarios en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
528	030106077	CF anticuerpo monoclonal marcado con APC	PB A	4	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal a elegir por el usuario, combinado con fluorocromo APC (Alofocianina) para el estudio mediante citometría de flujo en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
529	030106078	CF anticuerpo monoclonal marcado con Cy5	PB A	4	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal a elegir por el usuario, combinado con fluorocromo Cy5 para el estudio mediante citometría de flujo en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
530	030106079	CF anticuerpo monoclonal marcado con Cy7	PB A	4	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal a elegir por el usuario, combinado con fluorocromo Cy7 para el estudio mediante citometría de flujo en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
531	030106080	CF anticuerpo monoclonal marcado con FITC	PB A	4	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal a elegir por el usuario, combinado con fluorocromo FITC (Isotiocianato de fluoresceína) para el estudio mediante citometría de flujo en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
532	030106081	CF anticuerpo monoclonal marcado con PE	PB A	4	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal a elegir por el usuario, combinado con fluorocromo PE (Ficoeritrina) para el estudio mediante citometría de flujo en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
533	030106082	CF anticuerpo monoclonal marcado con PerCP	PB A	4	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal a elegir por el usuario, combinado con fluorocromo PerCP (Peridrin chlorophyl complex protein) para el estudio mediante citometría de flujo en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.




534	030106083	CF Apoptosis Celular kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de apoptosis celular en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
535	030106084	CF cariotipo de Flujo kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de cariotipo de flujo en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
536	030105762	CF Citoquinas kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Citoquinas en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
537	030105844	CF Estudio Ciclo Celular Leucemia Linfoblástica Aguda B Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio del Ciclo Celular de Leucemia Linfoblástica Aguda B en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
538	030105845	CF Estudio Ciclo Celular Leucemia Linfoblástica Aguda T Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio del Ciclo Celular de Leucemia Linfoblástica Aguda T en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
539	030105846	CF Estudio Ciclo Celular Leucemia Mielóide Aguda Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio del Ciclo Celular de Leucemia Mielóide Aguda en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
540	030105847	CF Estudio Ciclo Celular Mieloma Múltiple Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio del Ciclo Celular de Mieloma Múltiple en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
541	030105848	CF Estudio Ciclo Celular Síndrome Linfoproliferativo Crónico B Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio del Ciclo Celular del Síndrome Linfoproliferativo Crónico B en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada otros



542	030105849	CF Estudio Ciclo Celular Tumores Sólidos Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio del Ciclo Celular de Tumores Sólidos en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Células Tumorales.
543	030105489	CF Estudio Cuantitativo de Linfocitos CD4 - CD8 Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio Cuantitativo de Linfocitos CD4 - CD8 en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
544	030105850	CF Estudio de Poblaciones Linfocitarias Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Poblaciones Linfocitarias en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
545	03016085	CF Fagocitosis Celular kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Fagocitosis celular en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
546	03016086	CF Inmunodeficiencias Primarias kit			PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de inmunodeficiencias primarias en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
547	030105851	CF Inmunofenotipo Enfermedad Mínima Residual Leucemia Linfoblástica Aguda B Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo de Enfermedad Mínima Residual de Leucemia Linfoblástica Aguda B en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
548	030105852	CF Inmunofenotipo Enfermedad Mínima Residual Leucemia Linfoblástica Aguda T Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo de Enfermedad Mínima Residual de Leucemia Linfoblástica Aguda T en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
549	030105853	CF Inmunofenotipo Enfermedad Mínima Residual Leucemia Mieloide Aguda Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo de Enfermedad Mínima Residual de Leucemia Mieloide Aguda en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.



550	030105854	CF Inmunofenotipo Enfermedad Mínima Residual Síndrome de Linfoproliferativ o Crónico B Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo de Enfermedad Mínima Residual del Síndrome Linfoproliferativo Crónico B en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
551	030105855	CF Inmunofenotipo Enfermedad Mínima Residual Síndrome de Linfoproliferativ o Crónico T Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo de Enfermedad Mínima Residual del Síndrome Linfoproliferativo Crónico T en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
552	030105856	CF Inmunofenotipo Enfermedades Autoinmunes Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo de Enfermedades Autoinmunes en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
553	030105857	CF Inmunofenotipo Estudio de Alergias Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo de Alergias en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
554	030105859	CF Inmunofenotipo Leucemia Linfoblástica Aguda T Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo de Leucemia Linfoblástica Aguda T en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
555	030105860	CF Inmunofenotipo Leucemia Mieloide Aguda Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo de Leucemia Mieloide Aguda en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
556	030105861	CF Inmunofenotipo Mieloma Múltiple Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo de Mieloma Múltiple en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
557	030105862	CF Inmunofenotipo Screening Leucemias Agudas Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo del Screening de Leucemias Agudas en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.



558	030105863	CF Inmunofenotipo Screening Síndrome Linfoproliferativ o Crónico Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo del Síndrome Linfoproliferativo Crónico en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
559	030105865	CF Inmunofenotipo Síndrome Linfoproliferativ o Crónico T Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo del Síndrome Linfoproliferativo Crónico T en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
560	030105866	CF Inmunofenotipo Síndrome Mielodisplásico Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Inmunofenotipo del Síndrome Mielodisplásico en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
561	030106087	CF Moléculas de Adhesión Celular Kit			PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Moléculas de Adhesión celular en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada, otros.
562	030105867	CF Recuento Celular Progenitores de Médula Osea Kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Recuento Celular de Progenitores de Médula Osea en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada y/o Aféresis.
563	030106088	CF Reticulocitos kit			PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Reticulocitos en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
564	030106089	CF Trombocitopeni as congénitas kit			PRESENTACION: Kit de Reactivos para el Estudio de Trombocitopenias congénitas en empaque de 10 ó más pruebas. Los Marcadores que conforman cada prueba se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 49 ó 50. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.




7. HEMATOLOGIA

	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES
565	030106201	Agregación Plaquetaria modificada por Aspirina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la medición de la agregación plaquetaria modificada por aspirina. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Acorde a los reactivos propuestos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre o derivados
566	030106202	Agregación Plaquetaria modificada por inhibición de la vía P2Y12	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la medición de la agregación plaquetaria modificada por inhibición de la vía P2Y12. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Acorde a los reactivos propuestos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre o derivados.
567	030106203	Agregación Plaquetaria modificada por inhibidores de GP IIb/IIIa	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la medición de la agregación plaquetaria modificada por inhibidores de GP IIb/IIIa. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Acorde a los reactivos propuestos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre o derivados.
568	030100232	Aguja para cargar velocidad de sedimentación	UN	1 - 4	PRESENTACION: Aguja (Cánula de Wintrobe) por unidades. CARACTERISTICAS: Aguja de acero inoxidable de 132 mm de longitud aproximada, para introducir sangre anticoagulada en los tubos de Wintrobe. USO: Para cargar Velocidad de Sedimentación.
569	030104593	Coloración de Fosfatasa Acida Leucocitaria	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Coloración de Fosfatasa Acida Leucocitaria en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coloración Citoquímica. ACCESORIOS: Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre Periférica, Médula Osea.
570	030106106	Coloración de Fosfatasa Acida Linfocitaria	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Coloración de Fosfatasa Acida Linfocitaria en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coloración Citoquímica. ACCESORIOS: Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre Periférica, Médula Osea.
571	030104594	Coloración de Fosfatasa Alcalina Leucocitaria	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Coloración de Fosfatasa Alcalina Leucocitaria en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coloración Citoquímica. ACCESORIOS: Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre Periférica, Médula Osea.
572	030103831	Coloración para Esterasa Leucocitaria (Alpha Naphtyl Esterasa)	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Coloración de Esterasa Leucocitaria (Alpha Naphtyl Esterasa) en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coloración Citoquímica. ACCESORIOS: Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre Periférica, Médula Osea.
573	030103831	Coloración para esterasa leucocitaria (Naphtol AS-D Cloroacetato Esterasa)	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Coloración de Esterasa Leucocitaria (Naphtol AS-D Cloroacetato Esterasa) en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coloración Citoquímica. ACCESORIOS: Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre Periférica, Médula Osea.





574	030102198	Coloración para Mieloperoxidas a Leucocitaria	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Coloración de Mieloperoxidas Leucocitaria en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coloración Citoquímica. ACCESORIOS: Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre Periférica, Médula Osea.
575	030106104	Coloración PAS kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Coloración de PAS en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coloración Citoquímica. ACCESORIOS: Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre Periférica, Médula Osea.
576	030106105	Coloración Sudan Black B kit	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la Coloración de Sudan Black B kit en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coloración Citoquímica. ACCESORIOS: Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre Periférica, Médula Osea.
577	030104420	Colorante Azul Brillante de Cresil	G	1 - 4	PRESENTACION: Colorante Azul Brillante de Cresil en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 50%. USO: Hematología (Reticulócitos).
578	030105903	Dosaje de Activador de Plasminógeno Tisular	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Activador de Plasminógeno Tisular en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Cromogénico ó Inmunoensayo ó equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
579	030105904	Dosaje de Activador/Inhibidor de Plasminógeno 1	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de actividad del Inhibidor del Activador de Plasminógeno en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Cromogénico ó Inmunoensayo ó equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
580	030103982	Dosaje de Antiplasmina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de actividad de la Alfa 2: Antiplasmina en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico ó Cromogénico ó equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
581	030104405	Dosaje de Antitrombina III Antigénica	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Antitrombina III Antigénica en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo ó equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
582	030104406	Dosaje de Antitrombina III Funcional	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de la actividad de Antitrombina III en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico ó Cromogénico ó equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.




583	030104649	Dosaje de Dímero D	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Dímero D en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimétrico ó Inmunoensayo ó equivalente. Cuantitativo. Opcionalmente se podrá solicitar aglutinación en látex según el usuario solicitante ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28,29 ó 30. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
584	030106114	Dosaje de Factor IX	CM 3	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Factor IX en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimétrico ó Inmunoensayo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
585	030106115	Dosaje de Factor V	CM 3	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Factor V en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimétrico ó Inmunoensayo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
586	030106116	Dosaje de Factor VII	CM 3	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Factor VII en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimétrico ó Inmunoensayo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
587	030106117	Dosaje de Factor VIII	CM 3	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Factor VIII en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimétrico ó Inmunoensayo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
588	030104692	Dosaje de Factor Von Willebrand	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Factor Von Willebrand Antigenico en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimétrico ó Inmunoensayo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
589	030106118	Dosaje de Factor X	CM 3	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Factor X en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimétrico ó Inmunoensayo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
590	030106119	Dosaje de Factor XI	CM 3	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Factor XI en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimétrico ó Inmunoensayo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
591	030106120	Dosaje de Factor XII	CM 3	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Factor XII en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimétrico ó Inmunoensayo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.




592	030104743	Dosaje de Fibrinógeno	PB A	2,3,4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Fibrinógeno en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico ó Método de Clauss. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28,29,30 ó 31. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
593	030104693	Dosaje de Heparina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Heparina en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Cromogénico ó equivalente. Cuantitativo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
594	030104064	Dosaje de Plasminógeno Antigénico	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Plasminógeno Antigénico en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo ó equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
595	030104065	Dosaje de Plasminógeno Funcional	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de la actividad del Plasminógeno en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico ó Cromogénico ó equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
596	030105646	Dosaje de Proteína C antigénica	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Proteína C antigénica en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo ó equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
597	030105647	Dosaje de Proteína C funcional ó activada	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de la actividad de la Proteína C en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico ó Cromogénico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
598	030105648	Dosaje de Proteína S antigénica	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Proteína S antigénica en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo ó equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 12,28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
599	030105649	Dosaje de Proteína S funcional ó activada	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de la actividad de la Proteína S en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico ó Cromogénico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
600	030104084	Dosaje de Resistencia a la Proteína C	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Resistencia a la Proteína C en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico ó Cromogénico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta.




					MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
601	030105906	Dosaje de Tiempo de Protrombina	PB A	1 - 4	PRESENTACION: Reactivos Purificados ó Recombinantes (ISI: de 1.0 a 1.2) para el Dosaje de Tiempo de Protrombina en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28,29,30 ó 31. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
602	030105907	Dosaje de Tiempo de Trombina	PB A	2,3,4	PRESENTACION: Reactivos para el Dosaje de Tiempo de Trombina en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28,29,30 ó 31. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
603	030105908	Dosaje de Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado	PB A	1 - 4	PRESENTACION: Reactivos con Activador adecuado para el Dosaje de Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28,29,30 ó 31. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
604	030104009	Hemograma Automatizado Diferencial 3 Estirpes Kit	PB A	1-4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para Hemograma Automatizado Diferencial de 3 Estirpes. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Impedancia Volumétrica y/o equivalente. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 24 según tabla adjunta, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
605	030104010	Hemograma Automatizado Diferencial 5 Estirpes Kit	PB A	1 - 4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para Hemograma Automatizado Diferencial de 5 Estirpes. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Impedancia Volumétrica y/o Láser y/o Radiofrecuencia y/o Citoquímica y/o Citometría de Flujo. Mínimo dos metodologías por equipo ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 25,26 ó 27. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
606	030104888	Lanceta descartable para tiempo de sangría IVY modificado	UN	3,4	PRESENTACION: Lanceta en Cassette de Plástico. CARACTERISTICAS: Lanceta tipo cuchilla, con disparador automático. Debe permitir el Corte de 5 mm de largo por 1 mm de profundidad. USO: Para Tiempo de Sangría de IVY modificado.
607	030104888	Lanceta descartable para tiempo de sangría IVY modificado	UN	3,4	PRESENTACION: Lanceta en Cassette de Plástico. CARACTERISTICAS: Lanceta tipo cuchilla, con disparador automático. Debe permitir el Corte de 5 mm de largo por 1 mm de profundidad. USO: Para Tiempo de Sangría de IVY modificado.
608	030102559	Placa porta plastilina para microhematocrito	UN	1 - 4	PRESENTACION: Placa para sellado de Capilares para Microhematocrito. CARACTERISTICAS: Placa de Plástico conteniendo Cera de Plástico Vinilo (Plastilina), con numerador de posición de los Capilares. USO: Sellado de Capilares para Microhematocrito.
609	030105457	Reactivo Acido Araquidónico para agregación plaquetaria	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco por 1 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Sal sódica de Acido Araquidónico, liofilizado para reconstituir a 1 ml. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 32 de acuerdo a metodología, que permitan la realización completa de la prueba. USO: Prueba de Función de Agregación Plaquetaria.



610	030105455	Reactivo ADP para agregación plaquetaria	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco por 1 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Adenosina 5 difosfato, liofilizado para reconstituir a 1 ml. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 32 de acuerdo a metodología, que permitan la realización completa de la prueba. USO: Prueba de Función de Agregación Plaquetaria.
611	030105456	Reactivo Adrenalina para agregación plaquetaria	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco por 1 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Bitartrato de L-Epinefrina, liofilizado para reconstituir a 1 ml. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 32 de acuerdo a metodología, que permitan la realización completa de la prueba. USO: Prueba de Función de Agregación Plaquetaria.
612	030104584	Reactivo de Colágeno para agregación plaquetaria	G	4	PRESENTACION: Frasco por 1 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Colágeno de origen animal, liofilizado. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 32 de acuerdo a metodología, que permitan la realización completa de la prueba. USO: Prueba de Función de Agregación Plaquetaria.
613	030105996	Reactivo para Hemoglobina Método Manual	PB A	1 - 4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para el dosaje de Hemoglobina por Método Manual. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Cianometahemoglobina. ACCESORIOS: Estándar (de 14 a 16 gr/l), Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
614	030102762	Ristocetina X 100 mg	FR	4	PRESENTACION: Frasco por 100 mg, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Sal Sulfato de Ristocetina. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 32 de acuerdo a metodología, que permitan la realización completa de la prueba. USO: Prueba de Función de Agregación Plaquetaria.
615	030102886	Soporte para tubo de Westergreen	UN	2,3,4	PRESENTACION: Soporte para Tubo Capilar de Westergreen. CARACTERISTICAS: Soporte Metálico de 10 posiciones con seguros de Presión e indicador de nivel. USO: Soporte para Tubo de Velocidad de Sedimentación por el Método de Westergreen.
616	030102885	Soporte para tubo de Wintrobe	UN	1 - 4	PRESENTACION: Soporte para Tubo Capilar de Wintrobe. CARACTERISTICAS: Soporte Metálico de 10 posiciones con indicador de nivel. USO: Soporte para tubos de Velocidad de Sedimentación por el Método de Wintrobe.
617	030103022	Tabla para lectura de microhematocrito plastificada	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tabla para Lectura de Microhematocrito. CARACTERISTICAS: Tabla de Plástico con Escala Graduada. USO: Lectura de Microhematocrito.
618	030106034	Tubo capilar con citrato de sodio para velocidad de sedimentación	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo Capilar para Extracción al Vacío en empaque por 50 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo Capilar descartable, con anticoagulante Citrato de Sodio al 3.8%. USO: Para Velocidad de Sedimentación Automatizada. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 33 ó 34. El(los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta.
619	030103325	Tubo de Westergreen	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo Capilar de Westergreen. CARACTERISTICAS: Tubo capilar de Vidrio Borosilicato, graduado, longitud de graduación mínima de 150 mm, con divisiones de 1 mm. USO: Para medición de Velocidad de Sedimentación por el Método de Westergreen.
620	030103326	Tubo de Wintrobe	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo Capilar de Wintrobe. CARACTERISTICAS: Tubo capilar de Vidrio Borosilicato, graduado, longitud de graduación mínima de 100 mm, con divisiones de 1mm. USO: Para medición de Velocidad de Sedimentación por el Método de Wintrobe.




621	030104091	Veneno de Bothrops atrox para reptilasa	CM 3	4	PRESENTACION: Extracto Purificado de Veneno de Bothrops atrox liofilizado para el Dosaje del Test de Reptilasa, en frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.
622	030106038	Veneno de Víbora de Russel liofilizado x 100 mg	FR	4	PRESENTACION: Extracto Purificado de Veneno de Russell liofilizado para el Dosaje del Test de Anticoagulante Lúpico, en frasco por 100 mg ó equivalente, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Coagulométrico. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 28 ó 29. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Plasma.




8. HISTOCOMPATIBILIDAD


N°	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES
623	030106210	Bolsa para congelación de Huesos largos	UN	4	PRESENTACION: Bolsa en empaque individual o empaque de 10 bolsas o más, herméticamente sellado. Vigencia mínima: 1 año Dimensiones: 40 x 50 cm. (como mínimo) CARACTERISTICAS: Bolsa fabricada con acetato de vinil etileno (EVA), o propilenfluorado de etileno (FEP). Resistente a inmersión en la fase líquida de un tanque de almacenamiento de nitrógeno. Biológica, Química, Eléctrica e inmunológicamente inerte. Altamente permeable al Anhídrido carbónico y Oxígeno e impermeable al agua. Químicamente no reactivas, no catalíticas e insolubles, que eléctricamente se comportan como aisladores eléctricos, ópticamente transparentes y uniformes a la luz ultravioleta. Inmunológicamente no antigénicas a las células, esterilizadas por rayos Gamma. Opcional Indicadores de esterilidad por radiación. ACCESORIOS: Provistas con portaetiquetas y un conjunto de tubos integrados que permiten usar varios equipos de transferencia descartables (set integral de tuberías PVC). USO: Congelación de huesos largos en banco de huesos a temperaturas ultrafrías -196 °C
624	030106206	Bolsa para congelación de Precursores Hematopoyéticos de 1000 mL	UN	4	PRESENTACION: Bolsa en empaque de 2 ó más, bolsas con capacidad de 1000 mL. Herméticamente sellado. CARACTERISTICAS: Bolsa fabricada con acetato de vinil etileno (EVA), o propilenfluorado de etileno (FEP) ó material con similares características. Resistente a inmersión en la fase líquida de un tanque de almacenamiento de nitrógeno. Biológica, Química, Eléctrica e inmunológicamente inerte. Altamente permeable al Anhídrido carbónico y Oxígeno e impermeable al agua. Químicamente no reactivas, no catalíticas e insolubles, que eléctricamente se comportan como aisladores eléctricos, ópticamente transparentes y uniformes a la luz ultravioleta. Inmunológicamente no antigénicas a las células, adecuadamente esterilizadas. ACCESORIOS: Provistas con portaetiquetas y un conjunto de tubos integrados que permiten usar varios equipos de transferencia descartables (set integral de tuberías PVC) USO: Congelación de elementos sanguíneos, precursores hematopoyéticos y médula ósea.
625	030106207	Bolsa para congelación de Precursores Hematopoyéticos de 250 mL	UN	4	PRESENTACION: Bolsa en empaque de 2 ó mas bolsas con capacidad de 250 mL. Herméticamente sellado. CARACTERISTICAS: Bolsa fabricada con acetato de vinil etileno (EVA), o propilenfluorado de etileno (FEP) ó material con similares características. Resistente a inmersión en la fase líquida de un tanque de almacenamiento de nitrógeno. Biológica, Química, Eléctrica e inmunológicamente inerte. Altamente permeable al Anhídrido carbónico y Oxígeno e impermeable al agua. Químicamente no reactivas, no catalíticas e insolubles, que eléctricamente se comportan como aisladores eléctricos, ópticamente transparentes y uniformes a la luz ultravioleta. Inmunológicamente no antigénicas a las células, adecuadamente esterilizadas. ACCESORIOS: Provistas con portaetiquetas y un conjunto de tubos integrados que permiten usar varios equipos de transferencia descartables (set integral de tuberías PVC) USO: Congelación de elementos sanguíneos, precursores hematopoyéticos y médula ósea.
626	030106208	Bolsa para congelación de Precursores Hematopoyéticos de 50 mL	UN	4	PRESENTACION: Bolsa en empaque de 2 ó más bolsas con capacidad de 50 mL. Herméticamente sellado. CARACTERISTICAS: Bolsa fabricada con acetato de vinil etileno (EVA), o propilenfluorado de etileno (FEP) ó material con similares características. Resistente a inmersión en la fase líquida de un tanque de almacenamiento de nitrógeno. Biológica, Química, Eléctrica e inmunológicamente inerte. Altamente permeable al Anhídrido carbónico y Oxígeno e impermeable al agua. Químicamente no reactivas, no catalíticas e insolubles, que eléctricamente se comportan como aisladores eléctricos, ópticamente transparentes y uniformes a la luz ultravioleta. Inmunológicamente no antigénicas a las células, adecuadamente esterilizadas. ACCESORIOS: Provistas con portaetiquetas y un conjunto de tubos integrados que permiten usar varios equipos de transferencia descartables (set integral de tuberías PVC) USO: Congelación de elementos sanguíneos, precursores hematopoyéticos y médula ósea.




627	030106205	Bolsa para congelación de Precursores Hematopoyéticos de 750 mL	UN	4	PRESENTACION: Bolsa en empaque de 2 ó mas bolsas con capacidad de 750 mL. Herméticamente sellado. CARACTERISTICAS: Bolsa fabricada con acetato de vinil etileno (EVA), o propilenfluorado de etileno (FEP) ó material con similares características. Resistente a inmersión en la fase líquida de un tanque de almacenamiento de nitrógeno. Biológica, Química, Eléctrica e inmunológicamente inerte. Altamente permeable al Anhídrido carbónico y Oxígeno e impermeable al agua. Químicamente no reactivas, no catalíticas e insolubles, que eléctricamente se comportan como aisladores eléctricos, ópticamente transparentes y uniformes a la luz ultravioleta. Inmunológicamente no antigénicas a las células, adecuadamente esterilizadas. ACCESORIOS: Provistas con portaetiquetas y un conjunto de tubos integrados que permiten usar varios equipos de transferencia descartables (set integral de tuberías PVC) USO: Congelación de elementos sanguíneos, precursores hematopoyéticos y médula ósea.
628	030106209	Bolsa para congelación de Tejidos: Tibia y tendones	UN	4	PRESENTACION: Bolsa en empaque de 2 ó mas bolsas con capacidad de 500 mL ó más. Herméticamente sellado. CARACTERISTICAS: Bolsa fabricada con acetato de vinil etileno (EVA), o propilenfluorado de etileno (FEP) ó material con similares características. Resistente a inmersión en la fase líquida de un tanque de almacenamiento de nitrógeno. Biológica, Química, Eléctrica e inmunológicamente inerte. Altamente permeable al Anhídrido carbónico y Oxígeno e impermeable al agua. Químicamente no reactivas, no catalíticas e insolubles, que eléctricamente se comportan como aisladores eléctricos, ópticamente transparentes y uniformes a la luz ultravioleta. Inmunológicamente no antigénicas a las células, adecuadamente esterilizadas. ACCESORIOS: Provistas con portaetiquetas y un conjunto de tubos integrados que permiten usar varios equipos de transferencia descartables (set integral de tuberías PVC) USO: Congelación de elementos sanguíneos, precursores hematopoyéticos y médula ósea.
629	030104650	Dimetilsulfoxido (DMSO, Metilsulfóxido)	CM 3	4	PRESENTACION: Dimetilsulfoxido (DMSO, Metilsulfóxido) en presentación de 100 ml ó menor, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%. USO: Criopreservación Celular.
630	030104745	Ficoll Hypaque Estéril	CM 3	4	PRESENTACION: Ficoll Hypaque en Frasco por 100 ó 500 ml, estéril, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Densidad 1.077 gr/ml. USO: Aislamiento de Linfocitos de Sangre Total.
631	030105038	HLA B27 . detección genómica	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la determinación Genómica de HLA B27 en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos o secuenciamiento biomolecular ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 51,52 ó 56. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
632	030101932	HLA B-27 Placa para microlinfocitotoxicidad con cubierta	UN	4	PRESENTACION: Reactivos en Placa para microlinfocitotoxicidad mediada por complemento con tapa para la determinación de HLA B-27 en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Tipificación Serológica por Microlinfocitotoxicidad. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 57 (opcional a requerimiento del usuario) según la Metodología que permita la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
633	030104055	HLA Clase I (AB) Placa para microlinfocitotoxicidad con cubierta	UN	4	PRESENTACION: Reactivos Monoclonales en Placa para microlinfocitotoxicidad mediada por complemento con Tapa para la determinación de HLA Clase I (AB) en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Tipificación Serológica por Microlinfocitotoxicidad. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 57 (opcional a requerimiento del usuario) según la Metodología que permita la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.





634	030104056	HLA Clase II (DR) Placa para microinfocitotoxicidad con cubierta	UN	4	PRESENTACION: Reactivos Monoclonales en Placa para microinfocitotoxicidad mediada por complemento con Tapa para la determinación de antígenos HLA Clase II (DR/DQ) en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Tipificación Serológica por Microinfocitotoxicidad. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 57 (opcional a requerimiento del usuario) según la Metodología que permita la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
635	030104596	HLA Colorante Vital	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco de Plástico con tapa a rosca, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Colorante Base Eosina con fijador citológico apropiado. USO: Coloraciones en Histocompatibilidad.
636	030104597	HLA Colorante Vital Fluorescente	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco de Plástico oscuro con tapa a rosca, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Colorante compuesto de Naranja de Acridina y Yoduro de Propidio. USO: Coloraciones en Histocompatibilidad.
637	030105927	HLA Control Positivo	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 1 ml liofilizado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Suero Antiinfocitario. USO: Control de Calidad de Prueba Cruzada Tisular en Histocompatibilidad.
638	030101282	HLA Cubeta para Complemento	UN	4	PRESENTACION: Cubeta de Plástico para cargado de Complemento. CARACTERISTICAS: Cubeta de Polietileno ó Polipropileno flexible, semitransparente, fondo en "V", capacidad máxima de 10 ml. USO: Cargado de Complemento con Jeringa Múltiple.
639	030101395	HLA Dispensador múltiple de repetición para microjeringa	UN	4	PRESENTACION: Dispensador múltiple de repetición con microjeringas y accesorios de mantenimiento. CARACTERISTICAS: Dispensador Metálico con microjeringas de Vidrio, de 6 canales, de 50 golpes. Volumen de dispensado de las jeringas de 1ul ó 5 ul, según lo indicado en una tabla adicional. USO: Cargado de Placas para microinfocitotoxicidad mediada por complemento.
640	030101398	HLA Dispensador simple de repetición para microjeringa	UN	4	PRESENTACION: Dispensador simple de repetición sin microjeringa, con accesorios de mantenimiento. CARACTERISTICAS: Dispensador Metálico de 50 golpes. USO: Cargado de Placas para microinfocitotoxicidad mediada por complemento.
641	030102185	HLA Microjeringa 100 uL	UN	4	PRESENTACION: Microjeringa para Dispensador de Repetición. CARACTERISTICAS: Microjeringa de Vidrio, de desplazamiento positivo, con capacidad de 100 uL y descarga de 2 uL, graduada, con émbolo de metal y tope de teflón o similar. USO: Cargado de Placas para microinfocitotoxicidad mediada por complemento.
642	030102186	HLA Microjeringa 250 uL	UN	4	PRESENTACION: Microjeringa para Dispensador de Repetición. CARACTERISTICAS: Microjeringa de Vidrio, de desplazamiento positivo, con capacidad de 250 uL y descarga de 5 uL, graduada, con émbolo de metal y tope de teflón o similar. USO: Cargado de Placas para microinfocitotoxicidad mediada por complemento..
643	030102184	HLA Microjeringa 50 uL	UN	4	PRESENTACION: Microjeringa para Dispensador de Repetición. CARACTERISTICAS: Microjeringa de Vidrio, de desplazamiento positivo, con capacidad de 50 uL y descarga de 1 uL, graduada, con émbolo de metal y tope de teflón o similar. USO: Cargado de Placas para microinfocitotoxicidad mediada por complemento..



644	030103979	HLA Paneles de Detección de Anticuerpos Clase I y II	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos de Panel Celular de antígenos HLA de Clase I y II. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Tipificación Serológica por Microlinfocitotoxicidad o detección de reacción por luminometría. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 57 (opcional a requerimiento del usuario) según la Metodología que permita la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
645	030104054	HLA Perlas Inmunomagnéticas para Linfocitos T ó B	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivo en Frasco hasta por 5 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Perlas inmunomagnéticas con Anticuerpos anti CD19 (Pan B) ó anti CD3 (Pan T), concentración mínima 4×10^5 perlas/ml de Buffer Fosfato Salino pH 7.4 según necesidad del usuario USO: Separación de Linfocitos T ó B de sangre anticoagulada.
646	030102501	HLA Placa para cultivo mixto de linfocitos	UN	4	PRESENTACIÓN: Placa de plástico en empaque individual. CARACTERISTICA: Placa de Poliestireno en presentación adecuada, estéril, descartable. USO: Cultivo Mixto de Linfocitos.
647	030102520	HLA Placa para microlinfocitotoxicidad 72 pozos x 10 uL con cubreplaca	UN	4	PRESENTACION: Placa para microlinfocitotoxicidad mediada por complemento con Tapa, con 72 micropocillos estériles, cada uno con capacidad para 10 ul en un área de 0.013 cm ² , para la determinación de Prueba Cruzada por Microlinfocitotoxicidad en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Prueba Cruzada por Microlinfocitotoxicidad. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 57 (opcional a requerimiento del usuario) según la Metodología que permita la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
648	030105038	HLA Primers HLA B27-ssp por tipificación	PB A	4	PRESENTACIÓN: Kit de Reactivos para la determinación Genómica de HLA B27 en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 51, 52 ó 56. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
649	030104845	HLA-ABC Complemento de Conejo	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Frasco hasta por 5 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Complemento liofilizado de Conejo para uso en la prueba de microlinfocitotoxicidad mediada por complemento USO: Tipificación Serológica por Microlinfocitotoxicidad.
650	030104003	HLA-ABC Genómico de Alta Resolución	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la determinación Genómica de Alta Resolución de HLA Clase I (AB opcional C) en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos ó Hibridación en Tira ó secuenciamiento biomolecular ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 51 ó 52 ó 53 y 56. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
651	030104004	HLA-ABC Genómico de Baja Resolución	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la determinación Genómica de Baja Resolución de HLA Clase I (ABC) en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos ó Hibridación en Tira. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 51 ó 52 ó 53 y 56. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.




652	030104005	HLA-DR DQ Genómico de Alta Resolución	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la determinación Genómica de Alta Resolución de HLA Clase II (DR, DQ) en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos ó Hibridación en Tira ó Secuenciamiento biomolecular ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 51 ó 52 ó 53 y 56. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
653	030104006	HLA-DR DQ Genómico de Baja Resolución	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la determinación Genómica de Baja Resolución de HLA Clase II (DR, DQ) en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Amplificación de Acidos Nucleicos ó Amplificación de la Señal de Acidos Nucleicos ó Hibridación en Tira. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 51 ó 52 ó 53 y 56. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre anticoagulada.
654	030102833	Solución de Hanks	CM 3	4	PRESENTACION: Solución de Hanks en Frasco por 100 ó 500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: HBSS (Solución Salina Balanceada de Hanks). Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración 1X, estéril, sin Cloruro de Calcio, sin Cloruro de Magnesio, sin Sulfato de Magnesio. USO: Conservación de Células.



9. INMUNOLOGIA


N°	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES
655	030103834	Alergenos en Paneles de Referencia	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Alergenos en Paneles de Referencia en empaque de 10 ó más pruebas. Los tipos de Paneles de Referencia se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Immunoblot. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11,12 ó 54. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
656	030103835	Alergenos Específicos	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Alergenos Específicos Individuales en empaque de 10 ó más pruebas. Los tipos de Alergenos Específicos se indicarán en una tabla adicional. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Immunoblot. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11,12 ó 54. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
657	030105358	Anticuerpo anti Adenovirus IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Adenovirus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia, Immunoblot. Sin precipitación y con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
658	030105358	Anticuerpo anti Adenovirus IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Adenovirus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia, Immunoblot. Sin precipitación y con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
659	030103841	Anticuerpo anti Aspergillus IgA	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgA contra Aspergillus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
660	030103850	Anticuerpo anti Aspergillus IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Aspergillus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.




661	030103887	Anticuerpo anti Aspergillus IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Aspergillus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
662	030103851	Anticuerpo anti Bartonella baciliforme IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Bartonella baciliforme en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
663	030103888	Anticuerpo anti Bartonella baciliforme IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Bartonella baciliforme en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
664	030103852	Anticuerpo anti Bordetella pertussis IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Bordetella pertussis en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
665	030103889	Anticuerpo anti Bordetella pertussis IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Bordetella pertussis en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
666	030103853	Anticuerpo anti Brucellas IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Brucella en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
667	030103890	Anticuerpo anti Brucellas IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Brucellas en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.



668	030103842	Anticuerpo anti Candida albicans IgA	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgA contra Candida albicans en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
669	030103854	Anticuerpo anti Candida albicans IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Candida albicans en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
670	030103891	Anticuerpo anti Candida albicans IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Candida albicans en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
671	030103855	Anticuerpo anti Chlamydia pneumoniae IgG	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Chlamydia pneumoniae en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Con Antígenos Recombinantes ó Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
672	030103892	Anticuerpo anti Chlamydia pneumoniae IgM	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Chlamydia pneumoniae en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. Con Antígenos Recombinantes ó Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
673	030103843	Anticuerpo anti Chlamydia trachomatis IgA	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgA contra Chlamydia trachomatis en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Con Antígenos Recombinantes ó Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
674	030100397	Anticuerpo anti Chlamydia trachomatis IgG	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Chlamydia trachomatis en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Con Antígenos Recombinantes ó Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.





675	030104243	Anticuerpo anti Chlamydia trachomatis IgM	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Chlamydia trachomatis en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
676	030103856	Anticuerpo anti Cisticercos cellulosa IgG	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Cisticercos cellulosa en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
677	030104016	Anticuerpo anti Cisticercos cellulosa Prueba Confirmatoria Immunoblot	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección confirmatoria de Anticuerpos contra Cisticercos cellulosa en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Immunoblot Confirmatorio con Antígenos Específicos de Cisticercos cellulosa. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 54 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma, LCR.
678	030103857	Anticuerpo anti Citomegalovirus IgG	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Citomegalovirus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. De Última Generación en cada marca. Semicuantitativo ó Cuantitativo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
679	030103894	Anticuerpo anti Citomegalovirus IgM	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Citomegalovirus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación y con neutralización de Factor Reumatoideo: De Última Generación en cada marca. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
680	030103858	Anticuerpo anti Coxsakie A virus IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Coxsakie A en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
681	030103895	Anticuerpo anti Coxsakie A virus IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Coxsakie A en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.





682	030105771	Anticuerpo anti Dengue IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Dengue en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
683	030105772	Anticuerpo anti Dengue IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Dengue en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
684	030103859	Anticuerpo anti ECHO virus IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra ECHO virus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
685	030103896	Anticuerpo anti ECHO virus IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra ECHO virus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma
686	030103844	Anticuerpo anti Entamoeba histolytica IgA	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgA contra Entamoeba histolytica en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
687	030103860	Anticuerpo anti Entamoeba histolytica IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Entamoeba histolytica en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
688	030103897	Anticuerpo anti Entamoeba histolytica IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Entamoeba histolytica en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.





689	030103884	Anticuerpo anti Epstein Barr Virus - Antígeno de Capside Viral (VCA) IgM	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Antígeno de Capside Viral (VCA) de Epstein Barr Virus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. De Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
690	030103848	Anticuerpo anti Epstein Barr Virus - Antígeno Nuclear (EBNA) IgG	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Antígeno Nuclear (EBNA) de Epstein Barr Virus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. De Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
691	030103861	Anticuerpo anti Equinococcus granulosus IgG	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Equinococcus granulosus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
692	030104017	Anticuerpo anti Equinococcus granulosus Prueba Confirmatoria Immunoblot	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección confirmatoria de Anticuerpos contra Equinococcus granulosus en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Immunoblot Confirmatorio con Antígenos Específicos de Equinococcus granulosus. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 54 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma
693	030101869	Anticuerpo anti Helicobacter pylori IgA	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgA contra Helicobacter pylori en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
694	030104234	Anticuerpo anti Helicobacter pylori IgG	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Helicobacter pylori en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
695	030104244	Anticuerpo anti Helicobacter pylori IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Helicobacter pylori en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.



696	030103863	Anticuerpo anti Herpes virus 1 IgG	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Herpes virus 1 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. De Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
697	030103900	Anticuerpo anti Herpes virus 1 IgM	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Herpes virus 1 ó para la detección simultánea de Anticuerpos IgM contra Herpes virus 1 y 2, en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. De Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
698	030103864	Anticuerpo anti Herpes virus 2 IgG	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Herpes virus 2 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. De Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes ó Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
699	030103901	Anticuerpo anti Herpes virus 2 IgM	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Herpes virus 2 ó para la detección simultánea de Anticuerpos IgM contra Herpes virus 1 y 2, en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. De Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes ó Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
700	030103865	Anticuerpo anti Herpes Virus Humano 6 IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Herpes Virus Humano 6 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
701	030103902	Anticuerpo anti Herpes Virus Humano 6 IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Herpes Virus Humano 6 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.



702	030104225	Anticuerpo anti HTLV I-II	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos Totales contra HTLV I y II en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo marcado segun tabla adjunta, De Ultima Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes y/o Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
703	030105430	Anticuerpo anti HTLV I-II Prueba Confirmatoria Inmunoblot	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección confirmatoria de Anticuerpos contra HTLV I y II en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoblot Confirmatorio de Ultima Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes ó Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 54 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
704	030103903	Anticuerpo anti Influenza virus 1 IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Influenza virus 1 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
705	030103903	Anticuerpo anti Influenza virus 1 IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Influenza virus 1 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
706	030103904	Anticuerpo anti Influenza virus 2 IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Influenza virus 2 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
707	030103904	Anticuerpo anti Influenza virus 2 IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Influenza virus 2 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
708	030105773	Anticuerpo anti Influenza virus 3 IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Influenza virus 3 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.




709	030105773	Anticuerpo anti Influenza virus 3 IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Influenza virus 3 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
710	030103870	Anticuerpo anti Leishmania braziliensis IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Leishmania braziliensis en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
711	030103908	Anticuerpo anti Mycoplasma pneumoniae IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Mycoplasma pneumoniae en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
712	030103908	Anticuerpo anti Mycoplasma pneumoniae IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Mycoplasma pneumoniae en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
713	030103872	Anticuerpo anti Paracoccidioides braziliensis IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Paracoccidioides braziliensis en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
714	030103905	Anticuerpo anti Parainfluenza virus A IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Parainfluenza virus A en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
715	030103905	Anticuerpo anti Parainfluenza virus A IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Parainfluenza virus A en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.



716	030103906	Anticuerpo anti Parainfluenza virus B IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Parainfluenza virus B en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
717	030103906	Anticuerpo anti Parainfluenza virus B IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Parainfluenza virus B en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
718	030103873	Anticuerpo anti Parvovirus B19 IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Parvovirus B19 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
719	030103910	Anticuerpo anti Parvovirus B19 IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Parvovirus B19 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
720	030103874	Anticuerpo anti Plasmodium IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Plasmodium en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
721	030103911	Anticuerpo anti Plasmodium IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Plasmodium en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o Plasma.
722	030103912	Anticuerpo anti Rotavirus IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Rotavirus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.




723	030103912	Anticuerpo anti Rotavirus IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Rotavirus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
724	030103876	Anticuerpo anti Rubeola IgG	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Rubeola en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. De Ultima Generación en cada marca. Cuantitativo en IU/ml. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
725	030103913	Anticuerpo anti Rubeola IgM	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Rubeola en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. De Ultima Generación en cada marca. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
726	030105774	Anticuerpo anti Sarampión IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Sarampión en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
727	030105774	Anticuerpo anti Sarampión IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Sarampión en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
728	030103846	Anticuerpo anti Toxoplasma gondii IgA	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgA contra Toxoplasma gondii en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
729	030103877	Anticuerpo anti Toxoplasma gondii IgG	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Toxoplasma gondii en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. De Ultima Generación en cada marca. Cuantitativo en IU/ml. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.





730	030103915	Anticuerpo anti Toxoplasma gondii IgM	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Toxoplasma gondii en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. De Última Generación en cada marca. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
731	030103916	Anticuerpo anti Treponema pallidum IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Treponema pallidum en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. Con Antígenos Recombinantes. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
732	030103504	Anticuerpo anti Treponema pallidum Total	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos Totales contra Treponema pallidum en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo marcado segun tabla adjunta. De Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes y/o Anticuerpos Monoclonales. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
733	030103917	Anticuerpo anti Trypanosoma cruzi (Chagas) IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Trypanosoma cruzi (Chagas) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. Con Antígenos Recombinantes. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.
734	030105775	Anticuerpo anti Trypanosoma cruzi (Chagas) Total	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos Totales contra Trypanosoma cruzi (Chagas) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo marcado segun tabla adjunta ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
735	030103880	Anticuerpo anti Varicela Zoster Virus IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Varicela Zoster Virus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
736	030103918	Anticuerpo anti Varicela Zoster Virus IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Varicela Zoster Virus en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o Plasma.




737	030104247	Anticuerpo anti VIH 1-2	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos Totales contra VIH 1, 2 y Grupo 0 ó para la detección simultánea de Anticuerpos Totales anti VIH 1, 2, 0 y de Antígeno de VIH, en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo marcado según tabla adjunta. De Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes y/o Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
738	030100452	Anticuerpo anti VIH 1-2 Prueba Confirmatoria Immunoblot	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección confirmatoria de Anticuerpos contra VIH 1, 2 y Grupo 0, en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Immunoblot Confirmatorio de Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes ó Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 54 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
739	030103919	Anticuerpo anti Virus de la Parotiditis IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Virus de la Parotiditis en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
740	030103919	Anticuerpo anti Virus de la Parotiditis IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Virus de la Parotiditis en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
741	030103920	Anticuerpo anti Virus Sincial Respiratorio IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Virus Sincial Respiratorio en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
742	030103920	Anticuerpo anti Virus Sincial Respiratorio IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Virus Sincial Respiratorio en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
743	030104251	Antígeno Paratífico A	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Suspensión de Bacterias para investigación de Anticuerpos contra Antígeno Paratífico A, en Frasco hasta por 5 ml, con gotero opcional, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. Concentración de Antígeno de 4.5% ó Escala 3 de McFarland. METODOLOGIA: Aglutinación en lámina. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.





744	030104252	Antígeno Paratífico B	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Suspensión de Bacterias para investigación de Anticuerpos contra Antígeno Paratífico B, en Frasco hasta por 5 ml, con gotero opcional, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. Concentración de Antígeno de 4.5% ó Escala 3 de McFarland. METODOLOGIA: Aglutinación en lámina. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
745	030104253	Antígeno Brucella en Placa	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Suspensión de Bacterias para investigación de Anticuerpos contra Antígeno de Brucella, en Frasco hasta por 5 ml, con gotero opcional, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. Concentración Celular del 10 al 12%. Debe ser producido en el Instituto Nacional de Salud. METODOLOGIA: Aglutinación en lámina. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
746	030104260	Antígeno Brucella en Tubo	CM 3	2,3,4	PRESENTACION: Suspensión de Bacterias para investigación de Anticuerpos contra Antígeno de Brucella, en Frasco hasta por 5 ml, con gotero opcional, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. Concentración Celular del 4.5%. Debe ser producido en el Instituto Nacional de Salud. METODOLOGIA: Aglutinación en lámina. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
747	030105778	Antígeno de Citomegalovirus	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno pp65 de Citomegalovirus en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Detección directa por Enzaimunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Lo)s equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre y Líquidos Biológicos.
748	030104278	Antígeno de Echinococcus granulosus	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno Echinococcus granulosus en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Detección directa por Enzaimunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Lo)s equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre y Líquidos Biológicos.
749	030104279	Antígeno Rosa de Bengala	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Suspensión de Bacterias para investigación de Anticuerpos contra Antígeno Rosa de Bengala, en Frasco hasta por 5 ml, con gotero opcional, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. Concentración Celular del 10 al 12%. Debe ser producido en el Instituto Nacional de Salud. METODOLOGIA: Aglutinación en lámina. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
750	030104280	Antígeno RPR	PB A	1 - 4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos no Treponémicos en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Floculación en Tarjeta. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
751	030104284	Antígeno Tífico H	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Suspensión de Bacterias para investigación de Anticuerpos contra Antígeno Tífico H, en Frasco hasta por 5 ml, con gotero opcional, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. Concentración de Antígeno de 4.5% ó Escala 3 de McFarland. METODOLOGIA: Aglutinación en lámina. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



752	030104285	Antígeno Tífico O	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Suspensión de Bacterias para investigación de Anticuerpos contra Antígeno Tífico O, en Frasco hasta por 5 ml, con gotero opcional, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. Concentración de Antígeno de 4.5% ó Escala 3 de McFarland. METODOLOGIA: Aglutinación en lámina. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
753	030104286	Antígeno VDRL	PB A	1 - 4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos no Treponémicos en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Floculación en lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero, Plasma ó LCR.
754	030100336	Autoanticuerpo Anti ANCA	PB A	4	PRESENTACION: Kit de Reactivos para la detección de anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo por separado c-ANCA y p-ANCA en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: inmunofluorescencia indirecta en sustrato de polimorfonucleares. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
755	030106063	Autoanticuerpo Anti antígeno soluble hepático (SLA)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos Anti antígeno soluble hepático (SLA) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
756	030103943	Autoanticuerpo Anti Beta 2 Glicoproteína 1 (IgA, IgM, IgG)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos IgA, IgM e IgG contra Beta 2 Glicoproteína 1 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
757	030106064	Autoanticuerpo Anti Beta 2 Glicoproteína 1 IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos IgG contra Beta 2 Glicoproteína 1 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
758	030106065	Autoanticuerpo Anti Beta 2 Glicoproteína 1 IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos IgM contra Beta 2 Glicoproteína 1 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.




759	030105837	Autoanticuerpo Anti Decarboxilasa del ácido Glutámico (GAD)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Decarboxilasa del ácido Glutámico (GAD) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Lo)s equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
760	030106066	Autoanticuerpo anti DNA de cadena simple (ssDNA)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra DNA nativo en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunofluorescencia Indirecta en Sustrato de Chritidia lucillae ó antígeno de generación superior. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
761	030100362	Autoanticuerpo anti DNA nativo IFA	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra DNA nativo en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunofluorescencia Indirecta en Sustrato de Chritidia lucillae. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
762	030105835	Autoanticuerpo Anti ENA Inmunoblot	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Antígenos Nucleares Extractables (Sm-B, Sm-D, RNP-70k, RNP-A, RNP-C, SSA (Ro52), SSA (Ro60), SSB, Jo1, SCL70, Ribosoma P, Centrómero e Histona como mínimo), en tiras por 13 ó más pruebas, en empaque de 10 ó más tiras. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoblot de Ultima Generación en cada marca. Con Antígenos Nucleares Extractables específicos. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 54 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
763	030106067	Autoanticuerpo Anti Fosfatidil serina IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos anti Fosfatidil serina IgG en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos; Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Lo)s equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
764	030106068	Autoanticuerpo Anti Fosfatidil serina IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos anti Fosfatidil serina IgM en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Lo)s equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
765	030106075	Autoanticuerpo Anti gp 210	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos Anti gp 210 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Lo)s equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.




766	030106069	Autoanticuerpo Anti HSP-70	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos Anti HSP-70 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
767	030105838	Autoanticuerpo Anti Insulina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Insulina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
768	030105836	Autoanticuerpo Anti LKM-1	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra LKM-1 (Citocromo P-450) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
769	030101311	Autoanticuerpo Anti Músculo Liso - Células Parietales Gástricas - Mitocondriales	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Mitocondrias, Músculo Liso y Células Parietales Gástricas (cada prueba comprende la detección simultánea de los 3 Anticuerpos) en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunofluorescencia Indirecta en Sustrato de Sustrato Tejido de Ratón ó Rata. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
770	030106073	Autoanticuerpo Anti Peptido Citrulinado Cíclico (CCP)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos Anti Peptido Citrulinado Cíclico (CCP) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
771	030106070	Autoanticuerpo Anti Proteína Oligomérica de Matriz de Cartilago (COMP)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos Anti Proteína Oligomérica de Matriz de Cartilago (COMP) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
772	030103923	Autoanticuerpo Antiadrenal	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Tejido Adrenal en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Indirecta. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



773	030103925	Autoanticuerpo Anticardiolipina (IgA, IgM, IgG)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos IgA, IgG e IgM contra Cardiolipina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
774	030100419	Autoanticuerpo Anticardiolipina IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos IgG contra Cardiolipina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
775	030104217	Autoanticuerpo Anticardiolipina IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos IgM contra Cardiolipina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
776	030103929	Autoanticuerpo Anticélulas de Islotes de Páncreas	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Células de Islotes de Páncreas en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
777	030103945	Autoanticuerpo Anticélulas Miocárdicas	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Células Miocárdicas en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Indirecta. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
778	030105839	Autoanticuerpo Anticentrómero	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Centrómero en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
779	030103926	Autoanticuerpo Anticerebelo	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Cerebelo en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Indirecta. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.




780	030103927	Autoanticuerpo Anticerebro	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Cerebro en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Indirecta. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
781	030104221	Autoanticuerpo Anti-DNA EIA (dsDNA)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra DNA de doble cadena en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Cuantitativo en UI/ml. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
782	030104273	Autoanticuerpo Anti-ENA Screen	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra un pool de Antígenos Nucleares Extractables (Smith, RNP, SS-A, SS-B, Jo-1 y SCL-70, como mínimo) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
783	030103930	Autoanticuerpo Antiepidémico	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Antígenos Epidémicos (Desmogleina 1 y 3) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
784	030104239	Autoanticuerpo Antiesperma	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Esperma en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Cuantitativo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
785	030103931	Autoanticuerpo Antigliadina (Endomiso)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Gliadina (Endomiso) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
786	030104209	Autoanticuerpo Anti-Jo1	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Antígeno Jo-1 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.




787	030103933	Autoanticuerpo Antimembrana Basal Glomerular	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Membrana Basal Glomerular en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
788	030104228	Autoanticuerpo Antimicrosomal Tiroideo	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Microsomas Tiroideos en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
789	030103935	Autoanticuerpo Antimielina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Mielina en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Indirecta. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
790	030103924	Autoanticuerpo antimieloperoxidasa de Neutrófilo (p-ANCA)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Mieloperoxidasa de neutrófilo (p-ANCA) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
791	030103932	Autoanticuerpo Antimieloperoxidasa de Neutrófilo (p-ANCA)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Mieloperoxidasa de Neutrófilo (p-ANCA) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
792	030100376	Autoanticuerpo Antimitocondrial es M2	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Antígeno M2 Mitocondrial en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



793	030103948	Autoanticuerpo Antimúsculo Esquelético	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Músculo Esquelético en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Indirecta. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
794	030103934	Autoanticuerpo Antimúsculo Liso (Antiactina)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Actina (Antimúsculo Liso) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
795	030103936	Autoanticuerpo Antineurona	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Neurona en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Indirecta. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
796	030103503	Autoanticuerpo Antinuclear (ANA) EIA	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Antígenos de Células HEp2 más Antígenos Nucleares Extractables (Sm, RNP, SSA, SSB, JO-1, SCL-70 y Centrómero, como mínimo) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
797	030104204	Autoanticuerpo Antinuclear (ANA) IFA	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos Antinucleares en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunofluorescencia Indirecta en Sustrato de Células HEp2. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
798	030105840	Autoanticuerpo Antinucleosoma	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Nucleosoma en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
799	030103937	Autoanticuerpo Antiovario	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Ovario en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.




800	030103950	Autoanticuerpo Antiproteínasa 3 de Neutrófilo (c-ANCA)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Proteínasa 3 de Neutrófilo (c-ANCA) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ú 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
801	030106071	Autoanticuerpo Antiprotrombina IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos Antiprotrombina IgG en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ú 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
802	030106072	Autoanticuerpo Antiprotrombina IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos Antiprotrombina IgM en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ú 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
803	030103940	Autoanticuerpo Antiribosoma P	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Ribosoma P en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ú 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
804	030104210	Autoanticuerpo Anti-RNP	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Antígeno RNP en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ú 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
805	030104211	Autoanticuerpo Anti-SCL70	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Antígeno SCL-70 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ú 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
806	030104212	Autoanticuerpo Anti-Smith (Sm)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Antígeno Smith (Sm) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ú 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



807	030106074	Autoanticuerpo Anti-Sp 100	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos Anti-Sp 100 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ú 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
808	030104213	Autoanticuerpo Anti-SSA (Ro)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Antígeno SSA (Ro) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ú 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
809	030104214	Autoanticuerpo Anti-SSB (La)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Antígeno SSB (La) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ú 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
810	030103941	Autoanticuerpo Antitestículo	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Testículo en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Indirecta. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
811	030104229	Autoanticuerpo Antitiroglobulina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Tiroglobulina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 7,8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
812	030103942	Autoanticuerpo Antitransglutaminasa Tisular	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Autoanticuerpos contra Transglutaminasa Tisular recombinante humano en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
813	030103988	FTA Absorbido	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección confirmatoria de Anticuerpos contra Treponema pallidum en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunofluorescencia Indirecta con absorción de anticuerpos. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



814	030103470	Hemaglutinación para Treponema pallidum	PB A	2,3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección confirmatoria de Anticuerpos contra Treponema pallidum en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Hemaglutinación indirecta ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
815	030105431	Hepatitis A Anticuerpo IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG ó totales contra Hepatitis A en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzima inmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 7, 8, 9, 10, 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
816	030103921	Hepatitis A Anticuerpo IgM	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Hepatitis A en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzima inmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación. De Última Generación en cada marca. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
817	030104233	Hepatitis B Anticuerpo Anticore IgM	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Antígeno Core de Hepatitis B en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzima inmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación. De Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
818	030103928	Hepatitis B Anticuerpo Anticore Total	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos Totales contra Antígeno Core de Hepatitis B en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo según tabla adjunta. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
819	030103944	Hepatitis B Anticuerpo contra Antígeno de Superficie	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Antígeno de Superficie de Hepatitis B en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación. De Última Generación en cada marca. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
820	030103840	Hepatitis B Anticuerpo contra Antígeno e	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Antígeno "e" de Hepatitis B en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzima inmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. De Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes y/o Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.




821	030105929	Hepatitis B Antígeno "e"	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección del Antígeno "e" de Hepatitis B en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. De Última Generación en cada marca. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
822	030104257	Hepatitis B Antígeno de Superficie	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección del Antígeno de Superficie de Hepatitis B en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy marcado segun tabla adjunta ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
823	030100481	Hepatitis B Antígeno de Superficie Prueba Confirmatoria	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la Confirmación de la detección del Antígeno de Superficie de Hepatitis B en empaque de 10 ó más pruebas (Suero específico antiHBs. (De requerir debe incluir la Prueba de HBsAg). Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensoy, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. De Última Generación. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
824	030103946	Hepatitis C Anticuerpo	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Hepatitis C ó para la detección simultánea de Anticuerpos Totales y de Antígeno de HCV en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoensoy marcado segun tabla adjunta. Con Antígenos Recombinantes y/o Péptidos Sintéticos. Debe incluir detección de anticuerpos contra la región NS5 en cada marca. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
825	030103947	Hepatitis C Anticuerpo Prueba Confirmatoria Inmunoblot	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos contra Hepatitis C, mediante prueba suplementaria, en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoblot de Última Generación en cada marca. Con Antígenos Recombinantes ó Péptidos Sintéticos. ACCESORIOS: Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 54 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



826	030106138	Hepatitis C Antígeno	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno contra Hepatitis C en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Con Antígenos Recombinantes y/o Péptidos Sintéticos. Debe incluir detección de anticuerpos contra la región NS5 en cada marca. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10 ó 11. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
827	030103883	Hepatitis D Anticuerpo IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgG contra Hepatitis D en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
828	030103922	Hepatitis D Anticuerpo IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Anticuerpos IgM contra Hepatitis D en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. Sin precipitación, con neutralización de Factor Reumatoideo. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
829	030106181	Test de Acido Hialuronico	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Acido Hialuronico en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
830	030103974	Test de Actividad de Complemento Sérico	PB A	-4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Actividad del Complemento Sérico en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
831	030103838	Test de Alfafetoproteína	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Alfafetoproteína en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 7, 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
832	030106014	Test de Amiloide Beta	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Amiloide Beta en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Líquido Cefalorraquídeo.




833	030103839	Test de Amiloide Sérico	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Amiloide Sérico en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
834	030103951	Test de Antiestreptodornasa B	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antiestreptodornasa B en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
835	030103952	Test de Antiestreptolisina O	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antiestreptolisina O en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
836	030100461	Test de Antiestreptolisina O por Látex	PB A	2	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antiestreptolisina O en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Aglutinación en Látex cuantitativa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
837	030100475	Test de Antígeno CA 125	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antígeno CA 125 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
838	030100476	Test de Antígeno CA 15-3	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antígeno CA 15-3 ó análogo BR 27.29, en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
839	030100477	Test de Antígeno CA 19-9	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antígeno CA 19-9 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
840	030103953	Test de Antígeno CA 72.4	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antígeno CA 72.4 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



841	030103954	Test de Antígeno Carcinoembrionario (CEA)	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antígeno Carcinoembrionario (CEA) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
842	030103955	Test de Antígeno de Carcinoma de Células Escamosas	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antígeno de Carcinoma de Células Escamosas en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
843	030103957	Test de Antígeno Polipéptido Tisular	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antígeno Polipeptido Tisular en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
844	030100515	Test de Antígeno Prostático Específico (PSA)	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antígeno Prostático Específico (PSA) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
845	030106015	Test de Antígeno Prostático Específico Libre (PSA Libre)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antígeno Prostático Específico Libre (PSA Libre) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
846	030106016	Test de Antígeno Tau	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antígeno Tau en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Líquido Cefalorraquídeo.
847	030103958	Test de Antígeno Tumoral de Vejiga	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Antígeno Tumoral de Vejiga ó análogo NMP22, en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma, Orina.
848	030106182	Test de Aspartyl (Asparagynil) B-hidroxilasa (HAAH)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Aspartyl (Asparagynil) B-hidroxilasa (HAAH) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma, Orina.





849	030103795	Test de Beta 2 Microglobulina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Beta 2 Microglobulina en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría, Nefelometría, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5, 7 ó 8 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma y Orina.
850	030104026	Test de Cadena Kappa	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Cadena Kappa en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma y Orina.
851	030104027	Test de Cadena Lambda	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Cadena Lambda en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma y Orina.
852	030103965	Test de Complemento C1q	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Complemento C1q en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
853	030103966	Test de Complemento C1r	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Complemento C1r en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
854	030103967	Test de Complemento C3	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Complemento C3 en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
855	030103968	Test de Complemento C4	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Complemento C4 en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.




856	030103978	Test de CYFRA 21.1	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de CYFRA 21.1 (Citoqueratina 19 fragmentos) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
857	030103986	Test de Enolasa Neuroespecifica	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Enolasa Neuroespecifica en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
858	030103987	Test de Eritropoyetina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Eritropoyetina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ú 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
859	030103991	Test de Factor de Crecimiento Epidemal	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Factor de Crecimiento Epidemal en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
860	030103989	Test de Factor de Crecimiento I similar a la Insulina (ILGF-I)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Factor de Crecimiento I similar a la Insulina (IGF-I) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
861	030103990	Test de Factor de Crecimiento II similar a la Insulina (ILGF-II)	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Factor de Crecimiento II similar a la Insulina (IGF-II) en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
862	030103992	Test de Factor de Necrosis Tumoral Alfa	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Factor de Necrosis Tumoral Alfa en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.





863	030103993	Test de Factor de Necrosis Tumoral Beta	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Factor de Necrosis Tumoral Beta en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
864	030103994	Test de Factor Reumatoide	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Factor Reumatoide en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
865	030103995	Test de Factor Reumatoide IgA	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Factor Reumatoide IgA en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
866	030103996	Test de Factor Reumatoide IgG	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Factor Reumatoide IgG en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
867	030103997	Test de Factor Reumatoide IgM	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Factor Reumatoide IgM en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
868	030101543	Test de Factor Reumatoide por látex	PB A	2	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Factor Reumatoide por látex en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Aglutinación en Látex cuantitativa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
869	030103998	Test de Fibronectina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Fibronectina en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4, que permitan la realización completa de la prueba.




870	030106017	Test de Fosfatasa Alcalina Placentaria	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Fosfatasa Alcalina Placentaria en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
871	030101816	Test de Glutation Transferasa alfa	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Glutation Transferasa alfa en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma, Orina.
872	030101817	Test de Glutation Transferasa pi	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Glutation Transferasa pi en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma, Orina.
873	030103999	Test de GM-CSF	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de GM-CSF en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
874	030105761	Test de HER-2/neu	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de HER-2/neu en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
875	030104011	Test de Histamina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Histamina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
876	030104012	Test de ICAM 1	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de ICAM-1 en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.





877	030104013	Test de ICAM 2	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de ICAM-2 en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
878	030104014	Test de ICAM 3	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de ICAM-3 en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
879	030104015	Test de Inhibidor de Complemento C1	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación del Inhibidor de Complemento C1 en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
880	030106023	Test de Inhibina A	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Inhibina A en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
881	030104018	Test de Inmunoglobulina A	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Inmunoglobulina A en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
882	030104019	Test de Inmunoglobulina E	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Inmunoglobulina E en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7 ó 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
883	030104020	Test de Inmunoglobulina G	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Inmunoglobulina G en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
884	030104021	Test de Inmunoglobulina G subtipo 1	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Inmunoglobulina G subtipo 1 en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



885	030104022	Test de Inmunoglobulina G subtipo 2	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Inmunoglobulina G subtipo 2 en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
886	030104023	Test de Inmunoglobulina G subtipo 3	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Inmunoglobulina G subtipo 3 en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
887	030104024	Test de Inmunoglobulina G subtipo 4	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Inmunoglobulina G subtipo 4 en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
888	030104025	Test de Inmunoglobulina M	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Inmunoglobulina M en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
889	030104028	Test de Interferón alfa	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interferón alfa en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
890	030104029	Test de Interferón beta	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interferón beta en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.




891	030104030	Test de Interferón gamma	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interferón gamma en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
892	030104031	Test de Interleukina 1	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 1 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
893	030104032	Test de Interleukina 10	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 10 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
894	030104033	Test de Interleukina 11	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 11 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
895	030104034	Test de Interleukina 12	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 12 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
896	030104035	Test de Interleukina 13	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 13 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
897	030104036	Test de Interleukina 14	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 14 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.




898	030104037	Test de Interleukina 15	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 15 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
899	030104038	Test de Interleukina 16	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 16 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
900	030104039	Test de Interleukina 2	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 2 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
901	030104040	Test de Interleukina 3	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 3 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
902	030104041	Test de Interleukina 4	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 4 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
903	030104042	Test de Interleukina 5	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 5 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
904	030104043	Test de Interleukina 6	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 6 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



905	030104044	Test de Interleukina 7	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 7 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
906	030106186	Test de Interleukina 8	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 8 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
907	030104045	Test de Interleukina 9	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Interleukina 9 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
908	030106024	Test de Leptina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Leptina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
909	030104048	Test de Liposacarido A	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Liposacarido A en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, accesorios (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
910	030106188	Test de Metástasis Osea	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Liposacarido A en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
911	030104066	Test de Properdina Factor B	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Properdina Factor B en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría ó Nefelometría. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 5 de acuerdo a Metodología ó Protocolos de Adaptación para Equipos (de acuerdo a necesidad del servicio) TIPO 1, 2, 3 ó 4. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



912	030105654	Test de Proteína Básica de Mielina	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Proteína Básica de Mielina en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Líquido Ceforraquídeo.
913	030105044	Test de Proteína C Reactiva	PB A	2,3,4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Proteína C Reactiva en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría, Nefelometría ó Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5, 7, 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
914	030102618	Test de Proteína C Reactiva Látex	PB A	2	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Proteína C Reactiva en empaque de 20 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Aglutinación en Látex cuantitativa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
915	030106190	Test de Proteína C Reactiva Ultrasensible	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Proteína C Reactiva Ultrasensible en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría, Nefelometría ó Quimioluminiscencia Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 1, 2, 3, 4 ó 5, 7, 8. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
916	030104076	Test de Proteína p53	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Proteína P53 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
917	030106191	Test de Proteína S-100	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Proteína P53 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
918	030104080	Test de Receptor Soluble de GM-CSF	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Receptor Soluble de GM-CSF en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.




919	030104081	Test de Receptor Soluble de Interleukina 2	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Receptor Soluble de Interleukina 2 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
920	030104082	Test de Receptor Soluble de Interleukina 4	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Receptor Soluble de Interleukina 4 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.
921	030104083	Test de Receptor Soluble de Interleukina 6	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la determinación de Receptor Soluble de Interleukina 6 en empaque de 50 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimaimunoensayo, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos tipo 7,8,9,10,11 ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Suero ó Plasma.



10. MICROBIOLOGIA


N°	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	UM	NIVE L DE USO	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES
922	030100144	Agar Agar	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Agar en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
923	030103485	Agar Base Baird-Parker	G	4	PRESENTACIÓN: Agar Base Baird-Parker en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
924	030105766	Agar Base para Anaerobios	G	4	PRESENTACIÓN: Agar Base para Anaerobios en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
925	030100149	Agar Base Sangre	G	1 - 4	PRESENTACIÓN: Agar Base Sangre en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
926	030100151	Agar Base Sangre Azida	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Base Sangre Azida en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
927	030103242	Agar Base Sangre Triptosa	G	3,4	PRESENTACIÓN: Agar Base Sangre Triptosa en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
928	030104145	Agar Base Urea (Christensen)	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Base Urea (Christensen) en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado con Urea p.a. grado ACS en cantidad suficiente para la preparación del Agar Base Urea. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. USO: Cultivos de Microbiología.
929	030100156	Agar Bismuto Sulfito	G	4	PRESENTACIÓN: Agar Bismuto Sulfito en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
930	030100158	Agar Brucella	G	2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Brucella en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
931	030100169	Agar C.L.E.D.	G	2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar C.L.E.D. en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.



932	030100161	Agar Campylobacter Kit Blaser	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Campylobacter Kit Blaser en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado para ser usado con sangre de Carnero. Debe incluir Suplementos de Antimicrobianos (Vancomicina, Polimixina B, Trimetropin, Cefalotina y Anfotericina B) en cantidad suficiente para la preparación del Agar Campylobacter, en viales herméticamente sellados, no reenvasados, Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. USO: Aislamiento de Campylobacter.
933	030103542	Agar Caseína Soya Peptona	G	2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Caseína Soya Peptona en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
934	030103486	Agar Chapman (Manitol Salado)	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Chapman (Manitol Salado) en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
935	030100167	Agar Citrato Simons	G	1 - 4	PRESENTACIÓN: Agar Citrato Simons en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
936	030100171	Agar Columbia	G	3,4	PRESENTACIÓN: Agar Columbia en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
937	030105765	Agar DTM para Dermatofitos	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar DTM para Dermatofitos en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
938	030103487	Agar EMB (Eosin Methylene Blue)	G	3,4	PRESENTACIÓN: Agar EMB (Eosin Methylene Blue) en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
939	030100173	Agar Enterococo	G	4	PRESENTACIÓN: Agar Enterococo en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
940	030100159	Agar Infusión Cerebro Corazón	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Infusión Cerebro Corazón en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
941	030103489	Agar LIA (Lysine Iron Agar)	G	1 - 4	PRESENTACIÓN: Agar LIA (Lysine Iron Agar) en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
942	030100181	Agar MacConkey	G	1 - 4	PRESENTACIÓN: Agar MacConkey en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
943	030100185	Agar Muller Hinton	G	1 - 4	PRESENTACIÓN: Agar Muller Hinton en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.



944	030103492	Agar Nutritivo	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Nutritivo en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
945	030100195	Agar Pseudomona "F"	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Pseudomona "F" en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
946	030100196	Agar Pseudomona "P"	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Pseudomona "P" en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
947	030100197	Agar Sabouraud	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Sabouraud con Dextrosa en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
948	030100187	Agar Sabouraud con Antibióticos	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Sabouraud con Antibióticos en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
949	030100199	Agar Salmonella Shiguelia	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Salmonella Shiguelia en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
950	030105703	Agar Selectivo para Estreptococo	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Selectivo para Estreptococo en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
951	030103748	Agar Selectivo para Listeria	G	4	PRESENTACIÓN: Agar Selectivo para Listeria en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. Debe incluir Suplementos de Antimicrobiano (Moxalactm) en cantidad suficiente para la preparación del Agar Selectivo para Listeria, en viales herméticamente sellados, no reenvasados, Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. USO: Aislamiento de Listeria monocytogenes.
952	030103495	Agar SIM (Azufre, Indol, Movilidad)	G	1-4	PRESENTACIÓN: Agar SIM (Azufre, Indol, Movilidad) en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
953	030105768	Agar Thayer Martin con Inhibidores y Factores de Crecimiento	G	3,4	PRESENTACIÓN: Agar Thayer Martin con Inhibidores y Factores de Crecimiento en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Base Deshidratado. Debe incluir Factores de Crecimiento e Inhibidores (Vancomicina, Colistina, Trimetoprim) en cantidad suficiente para la preparación del Agar Thayer Martin, en viales herméticamente sellados, no reenvasados, Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. USO: Aislamiento de Neisserias patógenas.
954	030100206	Agar Thiosulfato Sacarosa (TCBS)	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Agar Thiosulfato Sacarosa (TCBS) en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.



955	030100208	Agar Tripticasa Soya	G	1 - 4	PRESENTACIÓN: Agar Tripticasa Soya en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
956	030103497	Agar TSI (Triple Sugar Iron)	G	1 - 4	PRESENTACIÓN: Agar TSI (Triple Sugar Iron) en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
957	030100214	Agar XLD (Xilosa Lysina Desoxicolato)	G	1 - 4	PRESENTACIÓN: Agar XLD (Xilosa Lysina Desoxicolato) en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
958	030105785	Antisuero anti Candida albicans	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Candida albicans, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero de Conejo para Candida albicans. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
959	030105783	Antisuero anti E.coli enteroinvasiva Polivalente	CM 3	4	PRESENTACION: Kit de Frascos hasta por 3 ml de Antisueros Polivalentes anti Escherichia coli enteroinvasiva, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisueros específicos para Antígenos OK Cepas 02Bac, 029, 0112ac, 0124, 0136, 0143, 0144, 0152, 0164, 0167 ó equivalentes. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
960	030105784	Antisuero anti E.coli enteropatogenico o Polivalente	CM 3	4	PRESENTACION: Kit de Frascos hasta por 3 ml de Antisueros Polivalentes anti Escherichia coli enteropatogenico, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisueros específicos para Antígenos OK Cepas 026, 055, 086, 0111, 0114, 0119, 0125, 0126, 0127, 0128, 0142, 0158 ó equivalentes. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
961	030104354	Antisuero anti E.coli O157:H7	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Escherichia coli O157:H7, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos O157:H7. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
962	030105786	Antisuero anti Estafilococo aureus	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Estafilococo aureus, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Estafilococo aureus. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
963	030105787	Antisuero anti Streptococo grupo A	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Streptococo grupo A, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Streptococo grupo A. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.




964	030105788	Antisuero anti Estreptococo grupo B	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Estreptococo grupo B, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Estreptococo grupo B. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
965	030105789	Antisuero anti Estreptococo grupos A, B, C, D, F, G	CM 3	4	PRESENTACION: Kit de Frascos hasta por 3 ml de Antisueros Estreptococo grupos A, B, C, D, F y G como mínimo, herméticamente sellados, no reenvasados. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Estreptococo grupos A, B, C, D, F y G, como mínimo. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
966	030105790	Antisuero anti Haemophylus influenzae Polivalente	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero Polivalente anti Haemophylus influenzae, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Haemophylus influenzae. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
967	030105791	Antisuero anti Haemophylus Influenzae tipo b	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Haemophylus Influenzae tipo b, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Haemophylus Influenzae tipo b. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
968	030105792	Antisuero anti Pneumococo Polivalente	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero Polivalente anti Pneumococo, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Pneumococo. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
969	030104363	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo A	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo A, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo A Factores 1, 2 y 12, como mínimo. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
970	030104366	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo B	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo B, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo B Factores 4, 5 y 12, como mínimo. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
971	030104368	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo C1	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo C1, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo C1 Factores 6 y 7, como mínimo. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.




972	030105793	Antisuero anti Salmonella Somático grupo C3	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo C3, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo C3 Factores 8 y 20, como mínimo. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
973	030104370	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo D	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo D, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo D Factores 9 y 12, como mínimo. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
974	030104374	Antisuero anti Salmonella Somático Grupo E1	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo E1, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo E1 Factores 3, 10 y 15, como mínimo. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
975	030105794	Antisuero anti Salmonella Somático grupo E4	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Salmonella Somático Grupo E4, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupo E4 Factores 1, 3 y 19, como mínimo. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
976	030104361	Antisuero anti Salmonella Somático Polivalente	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero Polivalente anti Salmonella Somático, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos Somáticos de Salmonella Grupos A, B, C, D, E + Vi, como mínimo. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
977	030104376	Antisuero anti Salmonella Vi	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Salmonella Somático Vi, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígeno Somático Vi de Salmonella. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
978	030104384	Antisuero anti Shiguelia Grupo A	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Shiguelia Grupo A, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Shiguelia Grupo A (Shiguelia dysenteriae). USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
979	030104386	Antisuero anti Shiguelia Grupo B	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Shiguelia Grupo B, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Shiguelia Grupo B (Shiguelia flexnerie). USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.





980	030104378	Antisuero anti Shiguella Grupo C	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Shiguella Grupo C, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Shiguella Grupo C (Shiguella boydii). USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
981	030104388	Antisuero anti Shiguella Grupo D	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Shiguella Grupo D, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Shiguella Grupo D (Shiguella sonnei). USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
982	030105796	Antisuero anti Vibrio cholerae Inaba	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Vibrio cholerae Inaba, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Vibrio cholerae Inaba. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
983	030105797	Antisuero anti Vibrio cholerae Ogawa	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero anti Vibrio cholerae Ogawa, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Vibrio cholerae Ogawa. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
984	030105795	Antisuero anti Vibrio cholerae Polivalente	CM 3	4	PRESENTACION: Frasco hasta por 3 ml de Antisuero Polivalente anti Vibrio cholerae, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Antisuero específico para Antígenos de Vibrio cholerae. USO: Aglutinación en Lámina. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba.
985	030100694	Asa descartable estéril de 1 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Asa de Plástico calibrada en empaque estéril de 10 a 50 unidades, herméticamente sellado. CARACTERISTICAS: Asa de Poliestireno, estéril, de 1 ul de capacidad, descartable. USO: Siembra en Medios de Cultivo.
986	030105832	Asa descartable estéril de 10 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Asa de Plástico calibrada en empaque estéril de 10 a 50 unidades, herméticamente sellado. CARACTERISTICAS: Asa de Poliestireno, estéril, de 10 ul de capacidad, descartable. USO: Siembra en Medios de Cultivo.
987	030100685	Asa para siembra calibrada 1/100	UN	1 - 4	PRESENTACION: Asa de Siembra en estuches de 20 a 100 asas. CARACTERISTICAS: Asa de nichrome, calibrada de acuerdo a los estándares de la Asociación Americana de Salud Pública. USO: Cultivos microbiológicos.




988	030100686	Asa para siembra calibrada 1/1000	UN	1 - 4	PRESENTACION: Asa de Siembra en estuches de 20 a 100 asas. CARACTERISTICAS: Asa de nichrome, calibrada de acuerdo a los estándares de la Asociación Americana de Salud Pública. USO: Cultivos microbiológicos.
989	030100687	Asa para siembra calibrada 1/200	UN	1 - 4	PRESENTACION: Asa de Siembra en estuches de 20 a 100 asas. CARACTERISTICAS: Asa de nichrome, calibrada de acuerdo a los estándares de la Asociación Americana de Salud Pública. USO: Cultivos microbiológicos.
990	030105833	Asa para siembra en punta	UN	1 - 4	PRESENTACION: Asa de Siembra en estuches de 20 a 100 asas. CARACTERISTICAS: Asa de nichrome en Punta, para siembra por puntura. USO: Cultivos Microbiológicos.
991	030105843	Bromo q.p.	CM 3	4	PRESENTACION: Bromo q.p. en Frasco por 30 ó 150 ó 250 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
992	030100850	Caldo Infusión Cerebro Corazón	G	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Caldo Infusión Cerebro Corazón en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Caldo Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
993	030103539	Caldo Nutritivo	G	1 - 4	PRESENTACIÓN: Caldo Nutritivo en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Caldo Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
994	030100902	Caldo Peptonado	G	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Caldo Peptonado en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Caldo Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
995	030100903	Caldo Selenito	G	1 - 4	PRESENTACIÓN: Caldo Selenito en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Caldo Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
996	030100907	Caldo Tripticasa Soya	G	1,2,3 ,4	PRESENTACIÓN: Caldo Tripticasa Soya en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Caldo Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
997	030103538	Caldo Urea	G	3,4	PRESENTACIÓN: Caldo Urea en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Caldo Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
998	030100924	Campana para cultivo de anaerobios	UN	2,3,4	PRESENTACION: Campana ó Jarra de Plástico con Tapa. CARACTERISTICAS: Campana de Policarbonato con Tapa a rosca hermética, con capacidad para 10 ó más Placas Petri de 15 x 100 mm. Uso: Aislamiento de Bacterias Anaerobias.
999	030105870	Capreomicina	G	4	PRESENTACIÓN: Capreomicina en Frasco por 1gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Sulfato de capreomicina. USO: Microbiología.



1000	030106095	Cepa de Control de Calidad Candida albicans ATCC	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Cepa de Control de Calidad Candida albicans ATCC 10231 ó 66027 en empaque apropiado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: 1 unidad de Cepa en Suspensión (1 CM3) ó equivalente (1 unidad en Asa ó 1 unidad en Hisopo ó 1 unidad Liofilizada para reconstituir). USO: Control de Calidad en Microbiología.
1001	030106094	Cepa de Control de Calidad Candida Tropicalis ATCC	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Cepa de Control de Calidad Candida Tropicalis ATCC 66029 en empaque apropiado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: 1 unidad de Cepa en Suspensión (1 CM3) ó equivalente (1 unidad en Asa ó 1 unidad en Hisopo ó 1 unidad Liofilizada para reconstituir). USO: Control de Calidad en Microbiología.
1002	030106096	Cepa de Control de Calidad Criptococo Neoformans ATCC	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Cepa de Control de Calidad Criptococo Neoformans ATCC 66031 en empaque apropiado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: 1 unidad de Cepa en Suspensión (1 CM3) ó equivalente (1 unidad en Asa ó 1 unidad en Hisopo ó 1 unidad Liofilizada para reconstituir). USO: Control de Calidad en Microbiología.
1003	030106097	Cepa de Control de Calidad Enterococo Faecalis ATCC	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Cepa de Control de Calidad Enterococo Faecalis ATCC 33186, 29212 ó 51229 en empaque apropiado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: 1 unidad de Cepa en Suspensión (1 CM3) ó equivalente (1 unidad en Asa ó 1 unidad en Hisopo ó 1 unidad Liofilizada para reconstituir). USO: Control de Calidad en Microbiología.
1004	030106098	Cepa de Control de Calidad Escherichia coli ATCC	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Cepa de Control de Calidad Escherichia coli ATCC 25922 en empaque apropiado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: 1 unidad de Cepa en Suspensión (1 CM3) ó equivalente (1 unidad en Asa ó 1 unidad en Hisopo ó 1 unidad Liofilizada para reconstituir). USO: Control de Calidad en Microbiología.
1005	030106099	Cepa de Control de Calidad Streptococo Pneumoniae ATCC	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Cepa de Control de Calidad Streptococo Pneumoniae ATCC 27336 en empaque apropiado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: 1 unidad de Cepa en Suspensión (1 CM3) ó equivalente (1 unidad en Asa ó 1 unidad en Hisopo ó 1 unidad Liofilizada para reconstituir). USO: Control de Calidad en Microbiología.
1006	030106100	Cepa de Control de Calidad Haemophilus influenzae ATCC	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Cepa de Control de Calidad Haemophilus influenzae ATCC 10211 en empaque apropiado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: 1 unidad de Cepa en Suspensión (1 CM3) ó equivalente (1 unidad en Asa ó 1 unidad en Hisopo ó 1 unidad Liofilizada para reconstituir). USO: Control de Calidad en Microbiología.
1007	030106101	Cepa de Control de Calidad Pseudomona aeruginosa ATCC	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Cepa de Control de Calidad Pseudomona aeruginosa ATCC 27853 en empaque apropiado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: 1 unidad de Cepa en Suspensión (1 CM3) ó equivalente (1 unidad en Asa ó 1 unidad en Hisopo ó 1 unidad Liofilizada para reconstituir). USO: Control de Calidad en Microbiología.
1008	030106102	Cepa de Control de Calidad Staphylococcus aureus ATCC	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Cepa de Control de Calidad Staphylococcus aureus ATCC 25923 ó 29213 en empaque apropiado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: 1 unidad de Cepa en Suspensión (1 CM3) ó equivalente (1 unidad en Asa ó 1 unidad en Hisopo ó 1 unidad Liofilizada para reconstituir). USO: Control de Calidad en Microbiología.



1009	030106103	Cepa de Control de Calidad Streptococcus pyogenes ATCC	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Cepa de Control de Calidad Streptococcus pyogenes ATCC 12344 en empaque apropiado, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: 1 unidad de Cepa en Suspensión (1 CM3) ó equivalente (1 unidad en Asa ó 1 unidad en Hisopo ó 1 unidad Liofilizada para reconstituir). USO: Control de Calidad en Microbiología.
1010	030105886	Cicloserina	G	4	PRESENTACIÓN: Cicloserina en Frasco por 5 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: D-Cicloserina, concentración aproximada 99%. USO: Microbiología.
1011	030101072	Ciprofloxacina	G	4	PRESENTACIÓN: Ciprofloxacina en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Polvo conservado a 5 °C. USO: Microbiología.
1012	030105888	Colorante Azul de Lactofenol	CM 3	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Colorante Azul de Lactofenol en Frasco por 100 ml ó equivalente, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Safranina O-Y-A, Rojo Básico 2, Rojo Algodón. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Listo para usar. USO: Microscopía.
1013	030102777	Colorante Safranina BSC	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Colorante Safranina BSC en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Safranina O-Y-A, Rojo Básico 2, Rojo Algodón. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 80%. USO: Microscopía (Bacteriología).
1014	030103428	Colorante Verde metilo BSC	G	4	PRESENTACIÓN: Colorante Verde metilo BSC en Frasco por 5 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 90%. USO: Para Microscopía.
1015	030104603	Control de Calidad Coloración Gram	UN	4	PRESENTACIÓN: Láminas para Control de Calidad de Coloración Gram en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Lamina porta objetos preparada para coloración. USO: Control de Calidad en Microbiología.
1016	030104604	Control de Calidad de Coloración de Ziehl-Neelsen	UN	4	PRESENTACIÓN: Láminas para Control de Calidad de Coloración de Ziehl-Neelsen en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Lamina porta objetos preparada para coloración. USO: Control de Calidad en Microbiología.
1017	030101267	Cromotopos 2 r	G	4	PRESENTACIÓN: Cromotopos 2 r en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Chromotopos 2R, Acid Red 29. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 85%. USO: Para Análisis.
1018	030105776	Detección de Antígeno de Adenovirus	PB A	4	PRESENTACIÓN: Reactivos para la detección de Antígeno de Adenovirus en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Directa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11, ó 12. El(Lo)s equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLÓGICA: Heces, Secreciones respiratorias.




1019	030105777	Detección de Antígeno de Aspergillus	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Aspergillus en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Directa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones respiratorias.
1020	030103962	Detección de Antígeno de Chlamydia pneumoniae	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Chlamydia pneumoniae en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Directa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones Bronquiales.
1021	030101044	Detección de Antígeno de Chlamydia trachomatis	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Chlamydia trachomatis en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Directa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos (incluido el Set de Toma de Muestra), Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones Urogenitales.
1022	030101259	Detección de Antígeno de Criptococo	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección rápida de Antígeno de Criptococo en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Aglutinación en Látex tituable. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: LCR, Suero, opcional Orina.
1023	030101260	Detección de Antígeno de Criptosporidium	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Criptosporidium en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Directa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Hece.
1024	030106110	Detección de Antígeno de Entamoeba histolytica	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Entamoeba histolytica en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Hece.
1025	030105830	Detección de Antígeno de Helicobacter Pylori	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Helicobacter Pylori en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzaimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta.




					adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Heces ó Jugo Gástrico.
1026	030105779	Detección de Antígeno de Herpes Simple Virus	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Herpes Simple Virus en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Directa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreción de úlcera.
1027	030105780	Detección de Antígeno de Legionella	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Legionella en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Orina
1028	030104269	Detección de Antígeno de Neisseria gonorrhoeae	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Neisseria gonorrhoeae en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos (incluido el Set de Toma de Muestra), Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones Urogenitales.
1029	030105645	Detección de Antígeno de Pneumocystis carini	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Pneumocystis carini en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Directa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones respiratorias
1030	030106111	Detección de Antígeno de Streptococcus grupo A	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Streptococcus grupo A en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Directa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones respiratorias.
1031	030105781	Detección de Antígeno de Virus Sincicial Respiratorio	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Virus Sincicial Respiratorio en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Directa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11,ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones respiratorias.



1032	030100470	Detección de Antígenos Bacterianos en LCR - identificación rápida	PB A	3,4	PRESENTACION: Reactivos para la detección rápida de Antígenos Bacterianos en LCR (Neumococo, Haemophylus, Meningococo, Estreptococo grupo B) en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Aglutinación en Látex. ACCESORIOS: Controles, Complementos y Accesorios, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: LCR. Opcional en Sangre.
1033	030102770	Detección de Rotavirus	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la detección de Antígeno de Rotavirus en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó Inmunofluorescencia Directa. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11, ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Heces.
1034	030101137	Detección de Toxina de Clostridium difficile	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la Detección de Toxina de Clostridium difficile en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11, ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Heces, Suero ó Plasma.
1035	030101521	Detección de Toxinas de Estafilococo	PB A	4	PRESENTACION: Reactivos para la Detección de Toxinas de Estafilococo en empaque de 10 ó más pruebas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Enzimainmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente, Quimioluminiscencia ó Electroquimioluminiscencia. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 7,8,9,10,11, ó 12. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Heces, Suero ó Plasma.
1036	030104130	Disco de Acido Nalidixico 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Acido Nalidixico 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1037	030104186	Disco de Amikacina 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Amikacina 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1038	030104201	Disco de Amoxicilina + Acido Clavulánico 20/10 ug.	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Amoxicilina + Acido Clavulánico 20/10 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.




1039	030104202	Disco de Ampicilina 10 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Ampicilina 10 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1040	030105892	Disco de Azitromicina 15 ug	UN	3,4	PRESENTACIÓN: Discos de Azitromicina 15 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1041	030105893	Disco de Aztreonam 30 ug	UN	2,3,4	PRESENTACIÓN: Discos de Aztreonam 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1042	030104499	Disco de Cefaclor 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Cefaclor 30 ug, en cartucho herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1043	030104502	Disco de Cefalexina 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Cefalexina 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1044	030104504	Disco de Cefalotina 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Cefalotina 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1045	030104506	Disco de Cefazolina 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Cefazolina 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.



1046	030105894	Disco de Cefepime 30 ug	UN	2,3,4	PRESENTACIÓN: Discos de Cefepime 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1047	030104509	Disco de Cefotaxime 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Cefotaxime 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1048	030104513	Disco de Ceftazidime 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Ceftazidime 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1049	030104515	Disco de Ceftriaxona 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Ceftriaxona 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1050	030104517	Disco de Cefuroxima 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Cefuroxima 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1051	030104537	Disco de Ciprofloxacino 5 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Ciprofloxacino 5 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1052	030104556	Disco de Clindamicina 2 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Clindamicina 2 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.



1053	030104558	Disco de Cloramfenicol 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Cloramfenicol 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1054	030104676	Disco de Diferenciación ALA	UN	4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Porfirina Acido Delta aminolevulinico, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Haemophylus.
1055	030104427	Disco de Diferenciación Bacitracina 0.04 U	UN	4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Bacitracina 0.04 Unidades, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Estreptococo del Grupo A.
1056	030105895	Disco de Diferenciación Bilis Esculina	UN	4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Bilis Esculina, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Detección de Hidrólisis de Esculina:
1057	030105897	Disco de Diferenciación de Urea	UN	4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Urea, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Anaerobios por detección rápida de urea.
1058	030104682	Disco de Diferenciación Factor V	UN	4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación Factor V, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Haemophylus.
1059	030104683	Disco de Diferenciación Factor X	UN	4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación Factor X, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Haemophylus.
1060	030104844	Disco de Diferenciación Hippurate	UN	4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación Hippurate, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Identificación presuntiva de Estreptococo del Grupo B.
1061	030105632	Disco de Diferenciación Metronidazol 5 ug	UN	4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Metronidazol 5 ug, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Anaerobios.



1062	030104969	Disco de Diferenciación Novobiocina 5 ug	UN	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Novobiocina 5 ug, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Estafilococo Coagulasa negativo.
1063	030101387	Disco de Diferenciación ONPG	UN	4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación ONPG, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Detección de Fermentadores de Lactosa.
1064	030104973	Disco de Diferenciación Optoquina	UN	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Optoquina, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Streptotoco pneumoniae.
1065	030104680	Disco de Diferenciación SPS	UN	4	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de SPS, en Envase por 10 ó más unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de G. vaginalis y P. anaerobius.
1066	030104701	Disco de Doxiciclina 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Doxiciclina 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1067	030104717	Disco de Eritromicina 15 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Eritromicina 15 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1068	030104787	Disco de Furazolidona 100 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Furazolidona 100 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.




1069	030104791	Disco de Gentamicina 10 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Gentamicina 10 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1070	030104853	Disco de Imipenem 10 ug	UN	2,3,4	PRESENTACIÓN: Discos de Imipenem 10 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1071	030105898	Disco de Meropenem 10 ug	UN	2,3,4	PRESENTACIÓN: Discos de Meropenem 10 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1072	030104963	Disco de Nitrofurantoina 300 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Nitrofurantoina 300 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1073	030104967	Disco de Norfloxacin 10 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Norfloxacin 10 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1074	030104976	Disco de Oxacilina 1 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Oxacilina 1 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1075	030105002	Disco de Penicilina 10 U	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Penicilina 10 Unidades, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.



1076	030105899	Disco de Piperacilina 100 ug	UN	3,4	PRESENTACIÓN: Discos de Piperacilina 100 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1077	030105900	Disco de Piperacilina/Tazobactam 100 ug/10 ug	UN	3,4	PRESENTACIÓN: Discos de Piperacilina/Tazobactam 100 ug/10 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1078	030105105	Disco de Rifampicina 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Rifampicina 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1079	030105265	Disco de Tetraciclina 30 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Tetraciclina 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1080	030105901	Disco de Ticarcilina 75 ug	UN	2,3,4	PRESENTACIÓN: Discos de Ticarcilina 75 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1081	030105902	Disco de Ticarcilina/Acido Clavulánico 75 ug/10 ug	UN	3,4	PRESENTACIÓN: Discos de Ticarcilina/Acido Clavulánico 75 ug/10 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1082	030105314	Disco de Trimetoprim/sulfametoxazol 1.25/23.75 ug	UN	1 - 4	PRESENTACIÓN: Discos de Trimetoprim/sulfametoxazol 1.25/23.75 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.




1083	030105340	Disco de Vancomicina 30 ug	UN	2,3,4	PRESENTACIÓN: Discos de Vancomicina 30 ug, en cartucho por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm ó mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 47 según cuadro adjunto, que permitan la realización completa de la prueba.
1084	030101473	Encendedor de gas a chispa	UN	1 - 4	PRESENTACION: Encendedor de gas. CARACTERISTICAS: Encendedor de pico largo, con regulador de intensidad de llama, con reservorio hermético para gas. USO: Encendido de Mechero de Bunsen y/o Alcohol.
1085	030105359	Esculina	G	3,4	PRESENTACIÓN: Esculina en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Polvo libre de impurezas. USO: Cultivos de Microbiología.
1086	030105916	Estreptomicina Sulfato	G	4	PRESENTACIÓN: Estreptomicina en Frasco por 25 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Sulfato de Dihidroestreptomicina. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Sulfato de Estreptomicina, Concentración mínima 90%. USO: Microbiología.
1087	030105917	Etambutol	G	4	PRESENTACIÓN: Etambutol en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Clorhidrato de Etambutol, polvo cristalino. USO: Microbiología.
1088	030105918	Etionamida	G	4	PRESENTACIÓN: Etionamida en Frasco por 5 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Etionamida en polvo cristalino. USO: Microbiología.
1089	030105919	Extracto de Carne para Microbiología	G	4	PRESENTACIÓN: Extracto de Carne en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Extracto liofilizado deshidratado en polvo. USO: Cultivos de Microbiología.
1090	030101538	Extracto de Levadura	G	4	PRESENTACIÓN: Extracto de Levadura en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Autolizado de Levaduras, desecado, en polvo. USO: Cultivos de Microbiología.
1091	030105928	Hemina	G	4	PRESENTACIÓN: Hemina en Frasco por 5 ó 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Cloruro de Hemina bovina. USO: Cultivos de Microbiología.



1092	030101947	Identificación + Antibiograma de Bacterias Anaerobias	PB A	4	PRESENTACION: Panel de Identificación Bioquímica y Sensibilidad Antimicrobiana de Bacterias Anaerobias. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Identificación con Set de Sustratos y Sensibilidad MIC y/o Break Point, para Lectura Fotométrica ó Fluorescente Automatizada. ACCESORIOS: Cepa Control ATCC 25285 (Bacteroides fragilis), Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 43,44 ó 45. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Cepa Unica.
1093	030101945	Identificación + Antibiograma de Bacterias Gram Negativas Sistémicas	PB A	4	PRESENTACION: Panel de Identificación Bioquímica y Sensibilidad Antimicrobiana de Bacterias Gram Negativas Sistémicas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Identificación con Set de Sustratos y Sensibilidad MIC y/o Break Point, para Lectura Fotométrica ó Fluorescente Automatizada. ACCESORIOS: Cepa Control ATCC 27853 (Pseudomona aeruginosa), Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 43,44 ó 45. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Cepa Unica.
1094	030105930	Identificación + Antibiograma de Bacterias Gram Negativas Sistémicas Prueba Rápida	PB A	4	PRESENTACION: Panel de Identificación Bioquímica y Sensibilidad Antimicrobiana de Bacterias Gram Negativas Sistémicas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Prueba Rápida de Identificación con Set de Sustratos y Sensibilidad MIC y/o Break Point, para Lectura Fotométrica ó Fluorescente Automatizada. ACCESORIOS: Cepa Control ATCC 27853 (Pseudomona aeruginosa), Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 43,44 ó 45. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Cepa Unica.
1095	030101944	Identificación + Antibiograma de Bacterias Gram Negativas Urinarias	PB A	4	PRESENTACION: Panel de Identificación Bioquímica y Sensibilidad Antimicrobiana de Bacterias Gram Negativas Urinarias. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Identificación con Set de Sustratos y Sensibilidad MIC y/o Break Point, para Lectura Fotométrica ó Fluorescente Automatizada. ACCESORIOS: Cepa Control ATCC 25922 (Escherichia coli), Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 43,44 ó 45. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Cepa Unica.
1096	030105931	Identificación + Antibiograma de Bacterias Gram Negativas Urinarias Prueba Rápida	PB A	4	PRESENTACION: Panel de Identificación Bioquímica y Sensibilidad Antimicrobiana de Bacterias Gram Negativas Urinarias. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Prueba Rápida de Identificación con Set de Sustratos y Sensibilidad MIC y/o Break Point, para Lectura Fotométrica ó Fluorescente Automatizada. ACCESORIOS: Cepa Control ATCC 25922 (Escherichia coli), Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 43,44 ó 45. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Cepa Unica.
1097	030101946	Identificación + Antibiograma de Bacterias Gram Positivas	PB A	4	PRESENTACION: Panel de Identificación Bioquímica y Sensibilidad Antimicrobiana de Bacterias Gram Positivas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Identificación con Set de Sustratos y Sensibilidad MIC y/o Break Point, para Lectura Fotométrica ó Fluorescente Automatizada. ACCESORIOS: Cepas Control ATCC 29213 (S.aureus) y 29212 (E.faecalis), Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 43,44 ó 45. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Cepa Unica.
1098	030105932	Identificación + Antibiograma de Bacterias Gram Positivas Prueba Rápida	PB A	4	PRESENTACION: Panel de Identificación Bioquímica y Sensibilidad Antimicrobiana de Bacterias Gram Positivas. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Prueba Rápida de Identificación con Set de Sustratos y Sensibilidad MIC y/o Break Point, para Lectura Fotométrica ó Fluorescente Automatizada. ACCESORIOS: Cepas Control ATCC 29213 (S.aureus) y 29212 (E.faecalis), Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 43,44 ó 45. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Cepa Unica.



1099	030101950	Identificación Bioquímica de Levaduras	PB A	4	PRESENTACION: Panel de Identificación Bioquímica de Hongos Levaduriformes. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Identificación Bioquímica con Set de Sustratos para Lectura Fotométrica ó Fluorescente Automatizada. ACCESORIOS: Cepas Control ATCC 66027(C.albicans), 66029 (C.tropicalis) y 66031(C.neoformans), Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 43,44 ó 45. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Cepa Unica.
1100	030105660	Indol (DMACA)	CM 3	2,3,4	PRESENTACIÓN: Indol (DMACA) en Dispensadores individuales de 0.75 ml ó similar, herméticamente sellados, no reenvasados. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.. CARACTERISTICAS: p-dimethylaminocinnamaldehido para prueba rápida. USO: En Microbiología.
1101	030105933	Isoniacida	G	4	PRESENTACIÓN: Isoniacida en Frasco por 5 ó 50 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Hidrazida del Acido Isonicotínico, concentración mínima 99%. USO: Microbiología.
1102	030103594	Kanamicina	G	4	PRESENTACION: Kanamicina en Frasco por 1 ó 5 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 750 ug/mg. USO: Microbiología.
1103	030106144	Kit para Aislamiento Automatizado de Mycobacterias	PB A	4	PRESENTACION: Kit para Aislamiento e Identificación de Mycobacterias, que incluya Medio de Cultivo más Suplementos Antimicrobianos y de Crecimientos. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Aislamiento e Identificación con Sustratos para Lectura Fotométrica ó Fluorescente. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 46 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones Respiratorias, Líquidos Biológicos.
1104	030105942	Kit para Sensibilidad Antibiótica Automatizado de Mycobacterias	PB A	4	PRESENTACION: Kit para Sensibilidad Antibiótica de Mycobacterias para Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida y Etambutol, como mínimo. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Sensibilidad Antibiótica para Lectura Fotométrica ó Fluorescente. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 46 de acuerdo a Metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLOGICA: Secreciones Respiratorias, Líquidos Biológicos.
1105	030102722	Kovacs para Indol	CM 3	1 - 4	PRESENTACIÓN: Kovacs para Indol en Frasco color ámbar de 30 ml ó más, con gotero dispensador, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Listo para usar. USO: Identificación de Microorganismos Indol Positivos ó Negativos.
1106	030104869	L-asparagina p.a.	G	4	PRESENTACION: L-asparagina p.a. en Frasco por 100 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1107	030102101	Mango para asas de siembra	UN	1 - 4	PRESENTACION: Mango para Asas de Siembra. CARACTERISTICAS: Mango de Aluminio de 24 cm de largo aproximadamente, forrado de Plástico, con Sistema de Rosca para sujetar las Asas. USO: Soporte de Asas de Siembra.



1108	030102117	Mechero de vidrio	UN	1 - 4	PRESENTACION: Mechero de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Mechero de Vidrio, con capacidad de 120 ml ó más, con Tapa metálica a rosca con criba para mecha recambiable y Tapa metálica extintora. USO: General en Laboratorio.
1109	030100891	Medio Base de Dubos	G	4	PRESENTACIÓN: Medio Base de Dubos en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
1110	030105743	Medio Cultivo MFC	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio de Cultivo MFC en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio líquido. USO: Cultivos de Microbiología.
1111	030104918	Medio Cultivo MF-ENDO	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio de Cultivo MF-ENDO en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio líquido. USO: Cultivos de Microbiología.
1112	030104917	Medio cultivo M-T-GE	CM 3	4	PRESENTACIÓN: Medio de Cultivo M-T-GE en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio líquido. USO: Cultivos de Microbiología.
1113	030102139	Medio de Lowenstein jensen	G	4	PRESENTACIÓN: Medio de Lowenstein jensen en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
1114	030102142	Medio de Movilidad	G	3,4	PRESENTACIÓN: Medio de Movilidad en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio Deshidratado que contenga Ornitina, Indol y Movilidad. USO: Cultivos de Microbiología.
1115	030102149	Medio de Thioglicolato	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Medio de Thioglicolato en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología.
1116	030104922	Medio de Transporte Amies	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Medio de Transporte Amies en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio Deshidratado. USO: Transporte de muestras microbiológicas.
1117	030104923	Medio de Transporte Cary Blair	G	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Medio de Transporte Cary Blair en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio Deshidratado. USO: Transporte de muestras microbiológicas.



118	030102144	Medio de Transporte de Stuart	G	1,2,3,4	PRESENTACION: Medio de Transporte Stuart en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Medio Deshidratado. USO: Transporte de muestras microbiológicas.
119	030102147	Medio Difásico Ruiz Castañeda	FR	1 - 4	PRESENTACION: Medio Difásico Ruiz Castañeda en Frasco de vidrio transparente, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Caldo y Agar de Tripticosa Soya ó Caldo y Agar Infusión Cerebro Corazón, con Atmósfera CO ₂ de 5 a 10%. En caso de ser nacional debe ser producido en el Instituto Nacional de Salud. MUESTRA: Sangre y Aspirado Medular.
1120	030105953	Medio para hemocultivo adulto automatizado en frasco	UN	2,3,4	PRESENTACION: Caldo enriquecido con Removedor de Antibióticos, atmósfera adecuada y anticoagulante, en Frasco de Vidrio transparente. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Hemocultivo Automatizado (Fluorometría ó Colorimetría), que también pueda ser procesado manualmente. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 40,41 ó 42. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre, Aspirado Medular ó Líquidos Biológicos de pacientes adultos.
1121	030105954	Medio para hemocultivo pediátrico automatizado en frasco	UN	2,3,4	PRESENTACION: Caldo enriquecido con Removedor de Antibióticos, atmósfera adecuada y anticoagulante, en Frasco de Vidrio transparente. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGIA: Hemocultivo Automatizado (Fluorometría ó Colorimetría), que también pueda ser procesado manualmente. ACCESORIOS: Complementos, Accesorios y Equipos TIPO 40,41 ó 42. El(Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre, Aspirado Medular ó Líquidos Biológicos de pacientes pediátricos.
1122	030104981	Oxidasa	PB A	1 - 4	PRESENTACION: Oxidasa en Frasco de 10 ml ó más, con gotero dispensador, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Listo para usar. USO: Identificación de Bacilos Gram Negativos (Productores de Enzima Oxidasa).
1123	030105004	Penicilina Estreptomicina p.a.	CM 3	3,4	PRESENTACION: Penicilina Estreptomicina en Frasco por 100 ml; herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Contiene Penicilina Base 5,000 unidades y Estreptomicina Base 5,000 ug en Solución Salina 0.85%. USO: Cultivo Celular.
1124	030105977	Pirazinamida	G	4	PRESENTACION: Pirazinamida en Frasco por 10 ó 50 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. Sinónimo: Pirazincarboximida, Acido Amido Pirazinoico. CARACTERISTICAS: Concentración aproximada 98%. USO: Microbiología.
1125	030102488	Piruvato de Sodio p.a.	G	4	PRESENTACION: Piruvato de Sodio p.a. en Frasco por 50 ó 250 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Acido Pirúvico sal sódica. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1126	030102507	Placa Petri de vidrio borosilicato 15 x 60 mm con tapa	UN	1 - 4	PRESENTACION: Placa Petri con Tapa de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Placa Petri y Tapa de Vidrio Borosilicato, de 15 mm de alto y 60 mm de diámetro aproximadamente, sin divisiones, autoclavable, reusable. USO: Cultivos Microbiológicos.





127	030102505	Placa Petri de vidrio borosilicato 15 x 100 mm con tapa	UN	1 - 4	PRESENTACION: Placa Petri con Tapa de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Placa Petri y Tapa de Vidrio Borosilicato, de 15 mm de alto y 100 mm de diámetro aproximadamente, sin divisiones, autoclavable, reusable. USO: Cultivos Microbiológicos.
128	030102514	Placa Petri de vidrio borosilicato 20 x 150 mm con tapa	UN	1 - 4	PRESENTACION: Placa Petri con Tapa de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Placa Petri y Tapa de Vidrio Borosilicato, de 20 mm de alto y 150 mm de diámetro aproximadamente, sin divisiones, autoclavable, reusable. USO: Cultivos Microbiológicos.
129	030102508	Placa petri estéril de plástico descartable de 15 x 100 mm con 2 divisiones	UN	1 - 4	PRESENTACION: Placa Petri de plástico con tapa en empaque de 10 a 30 unidades. CARACTERISTICAS: Placa y Tapa de Poliestireno, con tres divisiones, de 15 mm de alto y aproximadamente de 90 a 100 mm de diámetro, estéril, descartable. USO: Cultivos Microbiológicos.
130	030102509	Placa petri estéril de plástico descartable de 15 x 100 mm con 3 divisiones	UN	1 - 4	PRESENTACION: Placa Petri de plástico con tapa en empaque de 10 a 30 unidades. CARACTERISTICAS: Placa y Tapa de Poliestireno, con tres divisiones, de 15 mm de alto y de 90 a 100 mm de diámetro, estéril, descartable. USO: Cultivos Microbiológicos.
131	030102517	Placa petri estéril de plástico descartable de 15 x 100 mm con 4 divisiones	UN	1 - 4	PRESENTACION: Placa Petri de plástico con tapa en empaque de 10 a 30 unidades. CARACTERISTICAS: Placa y Tapa de Poliestireno, con cuatro divisiones, de 15 mm de alto y aproximadamente de 90 a 100 mm de diámetro, estéril, descartable. USO: Cultivos Microbiológicos.
132	030102511	Placa petri estéril de plástico descartable de 15 x 100 mm sin división	UN	1 - 4	PRESENTACION: Placa Petri de plástico con tapa en empaque de 10 a 30 unidades. CARACTERISTICAS: Placa y Tapa de Poliestireno, sin divisiones, de 15 mm de alto y de 90 a 100 mm de diámetro, estéril, descartable. USO: Cultivos Microbiológicos.
133	030105972	PYR Prueba Rápida	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Pyroglutamato (PYR) seca en láminas, en paquetes de 10 ó más unidades (pruebas). Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Láminas secas preparadas para la identificación de <i>Streptococo</i> del grupo A y <i>enterococo</i> . USO: Detección rápida de <i>Streptococo</i> del grupo A y <i>Enterococo</i> .
134	030103653	Rack porta placa petri	UN	1 - 4	PRESENTACION: Rack Metálico Porta Placa Petri. CARACTERISTICAS: Canastilla de alambre de Acero Inoxidable, con capacidad mínima para 20 placas petri de 15 x 100 mm. USO: Organizador de Placas Petri.
135	030105997	Reducción del Nitrato Kit	PB A	3,4	PRESENTACIÓN: Test de Reducción del Nitrato en tiras, en paquetes de 10 ó más unidades (pruebas). Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Tiras que permiten la identificación de la conversión del nitrato en Nitrito. USO: Diferenciación rápida de Anaerobios.
136	030105999	Rifampicina	G	4	PRESENTACIÓN: Rifampicina en Frasco por 1 ó 5 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 95%. USO: Microbiología.



1137	030106177	Sensibilidad de levaduras para agentes fungicos	PB A	4	PRESENTACIÓN: Microplacas para prueba de sensibilidad en levaduras, en envase adecuado de 10 a 50 pruebas, herméticamente sellado en empaque individual, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Microplacas para prueba de sensibilidad a antimicóticos por la metodología de breakpoint, incluyendo Anfotericin B, Fluconazol e Itraconazol como mínimo, aplicables a ser trabajadas por cepas individuales. USO: Determinación de sensibilidad a levaduras.
1138	030102797	Sistema de colección y transporte aeróbico con torundas	UN	1 - 4	PRESENTACION: Sistema de obtención y transporte de muestras con Tubo con Medio de Transporte y dos torundas, en empaque individual estéril único ó con segunda torunda en empaque individual externo. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico con Medio de Transporte Amies ó Stuart (semisólido), con tapa, con etiqueta para rotulación. Torunda de Alginato, Dacron ó fibra similar, con mango de Plástico ó Madera acoplado a la tapa para cierre hermético del tubo. Tiempo de Expiración no menor de 1año a partir de la fecha de entrega. USO: Para obtención y transporte de gérmenes aerobios.
1139	030105118	Sistema de colección y transporte aeróbico con torundas en medio fluido	UN	2,3,4	PRESENTACION: Sistema de obtención y transporte de muestras con Tubo con Medio de Transporte y dos torundas, en empaque individual estéril único ó con segunda torunda en empaque individual externo. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico con Medio de Transporte Amies ó Stuart (líquido), con tapa, con etiqueta para rotulación. Torunda de Alginato, Dacron ó fibra similar, con mango de Plástico ó Madera acoplado a la tapa para cierre hermético del tubo. Tiempo de Expiración no menor de 1año a partir de la fecha de entrega. USO: Para obtención y transporte de muestras de secreciones.
1140	030102799	Sistema de colección y transporte anaeróbico con torundas	UN	1 - 4	PRESENTACION: Sistema de obtención y transporte de muestras con Tubo con Medio de Transporte y dos torundas, en empaque individual estéril único ó con segunda torunda en empaque individual externo. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico con Medio de Transporte Amies ó Stuart (semisólido con Carbón Activado), con tapa, con etiqueta para rotulación. Torunda de Alginato, Dacron ó fibra similar, con mango de Plástico ó Madera acoplado a la tapa para cierre hermético del tubo. Tiempo de Expiración no menor de 1año a partir de la fecha de entrega. USO: Para obtención y transporte de gérmenes Anaerobios.
1141	030105119	Sistema de colección y transporte con torundas de aluminio	UN	2,3,4	PRESENTACION: Sistema de obtención y transporte de muestras con Tubo con Medio de Transporte y una torunda, en empaque individual estéril. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico con Medio de Transporte Medio de Transporte Amies ó Stuart (semisólido) con carbón activado, con tapa, con etiqueta para rotulación. Torunda de Alginato, Dacron ó fibra similar, con mango metálico acoplado a la tapa para cierre hermético del tubo. Tiempo de Expiración no menor de 1año a partir de la fecha de entrega. USO: Para colección y transporte de muestras Uretrales, Nasales, Oticas.
1142	030100842	Sobre Generador de Anaerobiosis con indicador	UN	2, 3,4	PRESENTACIÓN: Sistema Generador de Anaerobiosis en Sobre, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Sobre con reactivos liofilizados de Bicarbonato de Sodio, Hidróxido de Potasio y Acido Clorhídrico ó equivalentes, para reconstituir con Agua Destilada. Debe adicionarse un Indicador de Anaerobiosis por cada Sobre, compatible con el Sistema Generador de Anaerobiosis. USO: Generación de Ambiente Anaeróbico.
1143	030102803	Sobre Generador de CO2 con indicador	UN	1,2,3,4	PRESENTACIÓN: Sistema Generador de CO2 en Sobre, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Sobre con reactivos liofilizados de CO ó equivalentes, para reconstituir con Agua Destilada. Debe adicionarse un Indicador de CO2 por cada Sobre, compatible con el Sistema Generador de CO2. USO: Generación de Ambiente de CO2.
1144	030106000	Soguilla trenzada de algodón para mechero de vidrio	M	1 - 4	PRESENTACION: Soguilla en Rollo de 50 metros ó mayor. CARACTERISTICAS: Soguilla trenzada de Algodón. USO: Para mechero de vidrio estándar. En el caso de ser Nacional debe contar con Aprobación de Norma Técnica Nacional (ITINTEC).




1145	030103691	Tiacetazona	G	4	PRESENTACION: Tiacetazona en Frasco por 100 ó 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: En cristales. USO: Microbiología.
1146	030106037	Vancomicina	G	4	PRESENTACIÓN: Vancomicina en Frasco por 1 ó 5 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Potencia aproximada de 1000 ug/mg. USO: Microbiología.
1147	030103425	Verde de malaquita	G	4	PRESENTACION: Verde de Malaquita en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima: 90%. USO: Cultivos microbiológicos.




11. PRODUCTOS GENERALES


N°	CODIGO SAP	DENOMINACION COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TECNICAS FINALES
1148	030104105	2 Mercaptoetanol	CM 3	3,4	PRESENTACION: 2 Mercaptoetanol en Frasco de 100 ó 250 ó 500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1149	030105357	Aceite de Inmersión para microscopía	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Aceite de Inmersión para Microscopía en Frasco por 100 ó 500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Aceite de Cedro. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Índice de Refracción de 1,515 a 1,517, Viscosidad de 100 a 120 mPa.s (100 a 150 centistokes), libre de PCB.
1150	030100030	Acetato de Sodio Trihidrato p.a. grado ACS	G	3,4	PRESENTACION: Acetato de Sodio Trihidrato p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1151	030104113	Acetona p.a. grado ACS	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Acetona p.a. grado ACS en Frasco por 1000 ó 2500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%. USO: Para Análisis.
1152	030100045	Acido Acético Glacial p.a. grado ACS	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Acido Acético Glacial p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 ó 2500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para análisis.
1153	030100049	Acido Ascórbico p.a.	G	3,4	PRESENTACION: Acido Ascórbico p.a. en Frasco por 100 ó 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Acido L- Ascórbico. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1154	030104119	Acido Cítrico p.a.	G	4	PRESENTACION: Acido Cítrico p.a. en Frasco por 100 ó 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1155	030104095	Acido Clorhídrico p.a. grado ACS	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Acido Clorhídrico p.a. grado ACS en Frasco por 1000 ó 2500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 37%. USO: Para Análisis.
1156	030104122	Acido Crómico p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Acido Crómico p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Cromo VI Óxido, Cromo Trióxido, Anhídrido crómico. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1157	030100069	Acido Fénico (Fenol, Acido Carbólico) p.a. grado ACS	G	1 - 4	PRESENTACION: Acido Fénico (Fenol, Acido Carbólico) p.a. grado ACS en Frasco por 250 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.




1158	030100073	Acido Fosfomolibdico p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Acido Fosfomolibdico p.a. grado ACS en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS. USO: Para Análisis.
1159	030100078	Acido Fosfotúngstico p.a.	G	2,3,4	PRESENTACION: Acido Fosfotúngstico p.a. en Frasco por 50 ó 100 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Acido Fosfowolfrámico, Acido Tungstosfórico. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Polvo libre de impurezas. USO: Para Análisis.
1160	030100088	Acido Oxálico p.a.	G	4	PRESENTACION: Acido Oxálico p.a. en Frasco por 100 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%. USO: Para Análisis.
1161	030100093	Acido Peryódico p.a.	G	4	PRESENTACION: Acido Peryódico p.a. en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1162	030104140	Acido Sulfúrico p.a. grado ACS	CM 3	3,4	PRESENTACION: Acido Sulfúrico p.a. grado ACS en Frasco por 1000 ó 2500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 95%. USO: Para Análisis.
1163	030104159	Aguja para extracción al vacío múltiple 21 G x 1"	UN	1 - 4	PRESENTACION: Aguja en empaque individual estéril con sello de seguridad. CARACTERISTICAS: Aguja 21 x 1", siliconizada, de doble punta, pared ultrafina, con válvula de goma para extracción múltiple, con área para ajuste por presión y/o rosca. ACCESORIOS: 1 Adaptador para extracción al vacío por cada 5000 agujas. USO: Extracción con tubos al vacío de muestras sanguíneas.
1164	030105769	Albúmina Bovina Liofilizada	G	4	PRESENTACION: Albúmina Bovina Liofilizada en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 97%. USO: Para Análisis.
1165	030103499	Alcohol Etilico (Alcohol Rectificado) de 70°	L	1 - 4	PRESENTACION: Alcohol Etilico (Alcohol Rectificado) de 70° en Recipientes por 4 lt ó más. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 70%. USO: General de Laboratorio. CERTIFICACION: Aprobación de Norma Técnica Nacional (ITINTEC); Certificación de DIGEMID.
1166	030100259	Alcohol Etilico Absoluto (Etanol) p.a. grado ACS	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Alcohol Etilico Absoluto (Etanol) p.a. grado ACS en Frasco por 1000 ó 2500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.8%. USO: Para Análisis.
1167	030104169	Alcohol Isoamílico p.a. grado ACS	CM 3	4	PRESENTACION: Alcohol Isoamílico p.a. grado ACS en Frasco por 1000 ó 2500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 98.5%. USO: Para Análisis.
1168	030104170	Alcohol Isopropilico (Isopropanol) p.a. grado ACS	CM 3	4	PRESENTACION: Alcohol Isopropilico (Isopropanol) p.a. grado ACS en Frasco por 1000 ó 2500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: 2-Propanol. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99 %. USO: Para Análisis.



1169	030104171	Alcohol Metílico (Metanol) p.a. grado ACS	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Alcohol Metílico (Metanol) p.a. grado ACS en Frasco por 1000 ó 2500 ó 4000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.8%. USO: Para Análisis.
1170	030105183	Aluminio y Amonio Sulfato p.a. (Alumbre de Amonio)	G	2,3,4	PRESENTACION: Aluminio y Amonio Sulfato p.a. (Alumbre de Amonio) en Frasco por 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 98%. USO: Para Análisis.
1171	030102982	Aluminio y Potasio Sulfato p.a. (Alumbre de Potasio)	G	2,3,4	PRESENTACION: Aluminio y Potasio Sulfato p.a. (Alumbre de Potasio) en Frasco por 100 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 98%. USO: Para Análisis.
1172	030100706	Auxiliar de macropipeteado (0.1-100 mL) Tipo Brinkman	UN	1 - 4	PRESENTACION: Auxiliar de Macropipeteado para pipetas de 0.1 a 100 ml. CARACTERISTICAS: Tipo Brinkmann, con Pera de Aspiración y Soplado, Palanca de Pipeteado, Adaptador de Pipetas y 2 Filtros de Membrana Hidrófobos lavables e intercambiables. USO: Fluidos Biológicos y Soluciones Analíticas. ACCESORIOS: 10 Filtros de Membrana Hidrófobo adicionales, por cada auxiliar.
1173	030100745	Bagueta de vidrio de 5 mm (varilla)	UN	1 - 4	PRESENTACION: Varilla de Vidrio. CARACTERISTICAS: Varilla cilíndrica de Vidrio de Soda, de 20 cm de largo, de 5 mm de diámetro, con extremos romos. USO: Para agitar Fluidos Biológicos y Soluciones Analíticas. En el caso de ser Nacional debe contar con Aprobación de Norma Técnica Nacional (ITINTEC).
1174	030100755	Balón de vidrio borosilicato fondo plano x 1000 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Balón de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Balón de Vidrio Borosilicato, de 1000 ml de capacidad, de fondo plano, reusable. USO: General en Laboratorio.
1175	030100756	Balón de vidrio borosilicato fondo plano x 2000 mL	UN	2,3,4	PRESENTACION: Balón de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Balón de Vidrio Borosilicato, de 2000 ml de capacidad, de fondo plano, reusable. USO: General en Laboratorio.
1176	030100753	Balón de vidrio borosilicato fondo plano X 250mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Balón de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Balón de Vidrio Borosilicato, de 250mL de capacidad, de fondo plano, reusable. USO: General en Laboratorio.
1177	030100754	Balón de vidrio borosilicato fondo plano x 500 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Balón de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Balón de Vidrio Borosilicato, de 500 ml de capacidad, de fondo plano, reusable. USO: General en Laboratorio.
1178	030100757	Balón de vidrio borosilicato fondo plano x 6000 mL	UN	2,3,4	PRESENTACION: Balón de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Balón de Vidrio Borosilicato, de 6000 ml de capacidad, de fondo plano, reusable. USO: General en Laboratorio.
1179	030100781	Beaker de vidrio borosilicato graduado x 1000 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Beaker de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Beaker de Vidrio Borosilicato, de 1000 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.




180	030100775	Beaker de vidrio borosilicato graduado x 150 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Beaker de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Beaker de Vidrio Borosilicato, de 150 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.
181	030100782	Beaker de vidrio borosilicato graduado x 2000 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Beaker de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Beaker de Vidrio Borosilicato, de 2000 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.
182	030100777	Beaker de vidrio borosilicato graduado x 250 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Beaker de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Beaker de Vidrio Borosilicato, de 250 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.
183	030100779	Beaker de vidrio borosilicato graduado x 500 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Beaker de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Beaker de Vidrio Borosilicato, de 500 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.
184	030103959	Bencidina p.a.	G	4	PRESENTACION: Bencidina p.a. en Frasco por 5 ó 10 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
185	030100806	Bicarbonato de Sodio p.a.grado ACS	G	4	PRESENTACION: Bicarbonato de Sodio p.a.grado ACS en Frasco por 100 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.7%. USO: Para Análisis.
186	030103711	Bisulfito de Sodio anhidro p.a.grado ACS	G	4	PRESENTACION: Bisulfito de Sodio p.a.grado ACS en Frasco por 100 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 58.5%. USO: Para Análisis.
187	030100875	Caja criogénica para crioviales	UN	2,3,4	PRESENTACION: Caja de Plástico con Tapa. CARACTERISTICAS: Caja y Tapa de Policarbonato, resistente a temperaturas de - 180°C, con 81 posiciones (9 x 9) de almacenamiento. Tapa marcada para registro de muestras. USO: Muestras Biológicas en Crioviales de 2 ml.
188	030100922	Cámara Neubauer con doble espejo	UN	1 - 4	PRESENTACION: Cámara modificada de Neubauer en caja protectora de Plástico. CARACTERISTICAS: Placa base de vidrio óptico de 75 x 32 x 4.5 mm, con 2 Cámaras de 0.1 mm de profundidad, divididas por líneas oscuras sobre fondo claro en 9 cuadrantes de 1mm ² cada uno. Los cuadrantes ubicados en cada una de las cuatro esquinas estarán divididos a su vez en 16 cuadrados. El cuadrante central estará dividido en 25 cuadrados. ACCESORIOS: 4 Laminillas cubrecámaras. USO: Recuento Celular en Cámara.
189	030100929	Canastilla de acero inoxidable con asa 20 x 20 x 15 cm	UN	1 - 4	PRESENTACION: Canastilla con Asas fijas. CARACTERISTICAS: Canastilla de Alambre de Acero Inoxidable de 20 x 25 x 15 cm, con 2 asas fijas, resistente a esterilización por calor seco. Grosor mínimo del alambre 2 mm. Separación máxima entre alambres de 5 mm. USO: Transporte y Esterilización por calor seco de Tubos de Laboratorio. En el caso de ser Nacional debe contar con Aprobación de Norma Técnica Nacional (ITINTEC).
190	030100942	Canastilla organizadora para toma de muestra	UN	1 - 4	PRESENTACION: Canastilla Modular de Plástico con Asa. CARACTERISTICAS: Canastilla de Polietileno ó Polipropileno de alta densidad, con Divisiones para Gradilla de Tubos, Láminas, Aguas y Soluciones Desinfectantes. ACCESORIOS: Gradilla de Tubos y Portaláminas. USO: Toma de Muestra de Laboratorio.




1191	030100947	Capilares con heparina	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo por 100 unidades (capilares), con código de color rojo. CARACTERISTICAS: Capilar de Vidrio, de 75 mm de longitud aproximado, diámetro interior de 1.1 a 1.2 mm, con espesor de la pared 0.2 mm ó mayor, aforo a 60 mm, con revestimiento interno de Heparina Sódica. USO: Recolección de Sangre Capilar.
1192	030100949	Capilares sin heparina	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo por 100 unidades (capilares), con código de color azul. CARACTERISTICAS: Capilar de Vidrio, de 75 mm de longitud aproximado, diámetro interior de 1.1 a 1.2 mm, con espesor de la pared 0.2 mm ó mayor, aforo a 60 mm. USO: Recolección de Sangre Capilar.
1193	030104488	Carbón Vegetal	G	4	PRESENTACION: Carbón Vegetal en Frasco por 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Absorbente General. USO: Para Análisis.
1194	030104492	Carbonato de Sodio p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Carbonato de Sodio p.a. grado ACS en Frasco por 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%. USO: Para Análisis.
1195	030102556	Cilindro de acero inoxidable para esterilizar pipetas	UN	1 - 4	PRESENTACION: Cilindro con Tapa a Presión. CARACTERISTICAS: Cilindro y Tapa de Acero Inoxidable, resistente a esterilización por calor seco. Aproximadamente 10 cm de Diámetro por 50 cm de largo. USO: Esterilización de Pipetas por Calor Seco. En el caso de ser Nacional debe contar con Aprobación de Norma Técnica Nacional (TINTEC).
1196	030104545	Citrato Trisódico dihidratado p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Citrato Trisódico dihidratado p.a. grado ACS en Frasco por 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1197	030101107	Cloroformo (Triclorometano) p.a. grado ACS	CM 3	4	PRESENTACION: Cloroformo (Triclorometano) p.a. grado ACS en Frasco por 1000 ó 2500 ó 4000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1198	030103555	Cloruro de Calcio p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Cloruro de Calcio p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Dihidratado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%. USO: Para Análisis.
1199	030101128	Cloruro de Sodio p.a. grado ACS	G	1 - 4	PRESENTACION: Cloruro de Sodio p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1200	030100727	Colorante Azul de Metileno	G	1 - 4	PRESENTACION: Colorante Azul de Metileno en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 82%. USO: Bacteriología, Histología.
1201	030104424	Colorante Azul de Toluidina BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Azul de Toluidina BSC en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración 85%. USO: Microscopía.
1202	030101745	Colorante Fucsina Ácida	G	1 - 4	PRESENTACION: Colorante Fucsina Ácida en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 60%. USO: Microscopía.




1203	030101747	Colorante Fucsina Básica	G	1 - 4	PRESENTACION: Colorante Fucsina Básica en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Parafucsina Básica ó Pararosanilina. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 88%. USO: Microscopía.
1204	030101784	Colorante Giemsa BSC	G	1 - 4	PRESENTACION: Colorante Giemsa BSC en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC. USO: Microscopía.
1205	030101170	Colorante Leishman BSC	G	3,4	PRESENTACION: Colorante Leishman BSC en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Eosina-Azul de Metileno según Leishman. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC. USO: Microscopía.
1206	030102547	Colorante Ponceau S (Rojo Ponceau)	G	4	PRESENTACION: Colorante Ponceau S (Rojo Ponceau) en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 88%. USO: Microscopía, Electroforésis.
1207	030105154	Colorante Sudan III BSC	G	3,4	PRESENTACION: Colorante Sudan III BSC en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 75%. USO: Microscopía (Coloración de Grasas).
1208	030105156	Colorante Sudan Negro B BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Sudan Negro B BSC en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 60%. USO: Microscopía.
1209	030102920	Colorante Sudan Rojo	G	4	PRESENTACION: Colorante Sudan Rojo en Frasco por 10 gr ó 50 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Sudan Rojo 7B, Fat Red 7B. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC. USO: Microscopía
1210	030105347	Colorante Violeta de Cresilo BSC	G	4	PRESENTACION: Colorante Violeta de Cresilo BSC en Frasco por 10 ó 25 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración mínima 70%. USO: Microscopía.
1211	030103441	Colorante Violeta de Genciana	G	1 - 4	PRESENTACION: Colorante Violeta de Genciana en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Violeta Cristal. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC, Concentración 88%. USO: Microscopía.
1212	030101175	Colorante Wright BSC	G	1 - 4	PRESENTACION: Colorante Wright BSC en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Certificación BSC. USO: Microscopía.
1213	030104615	Criovial de Polipropileno 2.0 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Crioviales en Bolsa de 100 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo de Polipropileno, de 2 mL de capacidad, no estéril, no graduado. Tapa de Polietileno enroscable con cierre hermético. USO: Almacenamiento de Fluidos Biológicos y Soluciones Analíticas. ACCESORIOS: 1 Soporte de 30 a 100 viales, por cada 10,000 unidades.





214	030105370	Criovial de Polipropileno 5.0 mL	UN	4	PRESENTACION: Crioviales en Bolsa de 100 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo de Polipropileno, de 5 mL de capacidad, no estéril, graduación opcional. Tapa de Polietileno enroscable con cierre hermético. ACCESORIOS: 1 Soporte de 30 a 100 viales, por cada 10,000 unidades. USO: Almacenamiento de Fluidos Biológicos y Soluciones Analíticas.
215	030104624	Depósito de reactivo para pipeta multicanal	UN	3,4	PRESENTACION: Depósito de Plástico con Tapa. CARACTERISTICAS: Depósito y Tapa de Polietileno o Polipropileno, fondo en "V", capacidad mínima 50 ml. USO: Para cargado de reactivos con pipetas multicanales de 8 a 12 canales.
216	030105393	Detergente aniónico y no iónico PH 7.5 para lavar material de vidrio	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Detergente aniónico y no iónico en Frasco por 2000 ml ó más, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Detergente Iónico y no Aniónico, Concentrado, pH neutro de 7.2 a 7.5, Biodegradable. USO: Lavado Manual de Material de Laboratorio.
217	030103802	Dithiothreitol (DTT) p.a.	G	4	PRESENTACION: Dithiothreitol (DTT) p.a. en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
218	030101459	Embudo analítico de polipropileno D.S. 100 mm D.I. 7.5 mm	UN	1 - 4	PRESENTACION: Embudo de Polipropileno. CARACTERISTICAS: Embudo de Polipropileno, Diámetro Superior de 100 mm aproximadamente, Diámetro inferior de 7.5 mm aproximadamente. Autoclavables. USO: Filtración de Muestras Biológicas y Soluciones Inorgánicas.
219	030101460	Embudo analítico de polipropileno D.S. 150 mm D.I. 18 mm	UN	1 - 4	PRESENTACION: Embudo de Polipropileno. CARACTERISTICAS: Embudo de Polipropileno, Diámetro Superior de 150 mm aproximadamente, Diámetro inferior de 18 mm aproximadamente. Autoclavables. USO: Filtración de Muestras Biológicas y Soluciones Inorgánicas.
220	030105912	Embudo analítico de polipropileno D.S. 180mm D.I. 40 mm	UN	1 - 4	PRESENTACION: Embudo de Polipropileno. CARACTERISTICAS: Embudo de Polipropileno, Diámetro Superior de 180 mm aproximadamente, Diámetro inferior de 40 mm aproximadamente. Autoclavables. USO: Filtración de Muestras Biológicas y Soluciones Inorgánicas.
221	030105361	Embudo analítico de polipropileno D.S. 65 mm D.I. 8.5 mm	UN	1 - 4	PRESENTACION: Embudo de Polipropileno. CARACTERISTICAS: Embudo de Polipropileno, Diámetro Superior de 65 mm aproximadamente, Diámetro inferior de 8.5 mm aproximadamente. Autoclavables. USO: Filtración de Muestras Biológicas y Soluciones Inorgánicas.
222	030101468	Embudo analítico de vidrio borosilicato D.S. 150 mm D.I. 18 mm	UN	1 - 4	PRESENTACION: Embudo de Vidrio Borosilicato en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Embudo de Vidrio Borosilicato, Diámetro Superior de 150 mm aproximadamente, Diámetro inferior de 15 a 18 mm aproximadamente. Autoclavables. USO: Filtración de Muestras Biológicas y Soluciones Inorgánicas.
223	030106133	Escobilla para lavar tubo kit	UN	1 - 4	PRESENTACION: Escobilla para lavado de tubos. CARACTERISTICAS: Escobilla para Tubos, mango de alambre acerado, cerdas de Nylon con brocha terminal de Nylon, para tubos de 12x75mm hasta 20x150mm USO: Lavado Manual de Tubos de Ensayo. En el caso de ser Nacional debe contar con Aprobación de Norma Técnica Nacional (ITINTEC).
224	030101515	Espátula de acero de 10 cm de largo	UN	1 - 4	PRESENTACION: Espátula de Acero con mango. CARACTERISTICAS: Espátula de Acero Inoxidable con acabado tipo espejo, de 10 cm de largo aproximadamente, flexible, con mango de madera, según necesidad del servicio de acuerdo a anexo USO: General en Laboratorio.




1225	030101516	Espátula de acero de 20 cm de largo	UN	1 - 4	PRESENTACION: Espátula de Acero con mango. CARACTERISTICAS: Espátula de Acero Inoxidable con acabado tipo espejo, de 20 cm de largo aproximadamente, flexible, con mango de madera. USO: General en Laboratorio.
1226	030104729	Eter Etilico (Anhidro, Dietilico) p.a. grado ACS	CM 3	3,4	PRESENTACION: Eter Etilico (Anhidro, Dietilico) p.a. grado ACS en Frasco por 250 ó 500 ó 1000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado, en envase de Seguridad. Sinónimos: Etil Eter, Dietil Eter, Eter. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1227	030101561	Ferricianuro de Potasio p.a. grado ACS	G	3,4	PRESENTACION: Ferricianuro de Potasio p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1228	030101575	Filtro de membrana descartable para jeringa 0.22 um	UN	3,4	PRESENTACION: Filtro en empaque individual. CARACTERISTICAS: Filtro de Membrana de Acetato de Celulosa con poros de 0.22 um, estéril, descartable, con adaptador para Jeringa Tipo Luer. USO: Esterilización por filtración rápida con Jeringa.
1229	030104748	Filtro descartable para unidad de filtración reusable	UN	3,4	PRESENTACION: Filtros de Membrana para Unidad de Filtración Reusable, en empaque por 100 unidades. CARACTERISTICAS: Filtro de Membrana de Acetato de Celulosa de poros de 0.22 um, estéril, autoclavable. USO: Esterilización en frío ó clarificación de Soluciones Proteínicas por filtración con Unidad de Filtración reusable.
1230	030101589	Fiola aforada de vidrio borosilicato x 10 mL	UN	3,4	PRESENTACION: Fiola Aforada de Vidrio con Tapón esmerilado en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Fiola y Tapón de Vidrio Borosilicato, de 10 ml de capacidad, reusable. USO: General en Laboratorio.
1231	030101592	Fiola aforada de vidrio borosilicato x 100 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Fiola Aforada de Vidrio con Tapón esmerilado en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Fiola y Tapón de Vidrio Borosilicato, de 100 ml de capacidad, reusable. USO: General en Laboratorio.
1232	030101596	Fiola aforada de vidrio borosilicato x 1000 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Fiola Aforada de Vidrio con Tapón esmerilado en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Fiola y Tapón de Vidrio Borosilicato, de 1000 ml de capacidad, reusable. USO: General en Laboratorio.
1233	030101593	Fiola aforada de vidrio borosilicato x 200 mL	UN	3,4	PRESENTACION: Fiola Aforada de Vidrio con Tapón esmerilado en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Fiola y Tapón de Vidrio Borosilicato, de 200 ml de capacidad, reusable. USO: General en Laboratorio.
1234	030101597	Fiola aforada de vidrio borosilicato x 2000 mL	UN	3,4	PRESENTACION: Fiola Aforada de Vidrio con Tapón esmerilado en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Fiola y Tapón de Vidrio Borosilicato, de 2000 ml de capacidad, reusable. USO: General en Laboratorio.
1235	030101590	Fiola aforada de vidrio borosilicato x 25 mL	UN	3,4	PRESENTACION: Fiola Aforada de Vidrio con Tapón esmerilado en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Fiola y Tapón de Vidrio Borosilicato, de 25 ml de capacidad, reusable. USO: General en Laboratorio.




1236	030101594	Fiola aforada de vidrio borosilicato x 250 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Fiola Aforada de Vidrio con Tapón esmerilado en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Fiola y Tapón de Vidrio Borosilicato, de 250 ml de capacidad, reusable. USO: General en Laboratorio.
1237	030101591	Fiola aforada de vidrio borosilicato x 50 mL	UN	3,4	PRESENTACION: Fiola Aforada de Vidrio con Tapón esmerilado en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Fiola y Tapón de Vidrio Borosilicato, de 50 ml de capacidad, reusable. USO: General en Laboratorio.
1238	030101595	Fiola aforada de vidrio borosilicato x 500 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Fiola Aforada de Vidrio con Tapón esmerilado en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Fiola y Tapón de Vidrio Borosilicato, de 500 ml de capacidad, reusable. USO: General en Laboratorio.
1239	030104764	Fosfato de Potasio dibásico p.a. grado ACS	G	3,4	PRESENTACION: Fosfato de Potasio dibásico p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Anhidro. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 98%. USO: Para Análisis.
1240	030104766	Fosfato de Potasio monobásico p.a. grado ACS	G	3,4	PRESENTACION: Fosfato de Potasio monobásico p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Anhidro. Sinónimo: Potasio dihidrógenofosfato, Fosfato Monopotásico. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%. USO: Para Análisis.
1241	030104774	Fosfato de Sodio monobásico p.a. grado ACS	G	3,4	PRESENTACION: Fosfato de Sodio monobásico p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Anhidro. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 98.5%. USO: Para Análisis.
1242	030101635	Fosfato Disódico (Dibásico) anhidro p.a. grado ACS	G	3,4	PRESENTACION: Fosfato Disódico (Dibásico) anhidro p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Anhidro. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1243	030104771	Fosfato Disódico hidratado 12 H ₂ O p.a. grado ACS	G	3,4	PRESENTACION: Fosfato Disódico hidratado 12 H ₂ O p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1244	030101646	Fosfato Trisódico p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Fosfato Trisódico p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Dodecahidratado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 98%. USO: Para Análisis.
1245	030101681	Frasco de plástico estéril tapa a rosca para urocultivo	UN	1 - 4	PRESENTACION: Frasco de Plástico en empaque individual sellado. CARACTERISTICAS: Frasco de Polietileno ó Polipropileno clarificado de 100 a 150 ml de capacidad, de boca ancha sin rebordes, estéril, con etiqueta para rotulación, con forma de Cono invertido de base truncada (diámetro superior mayor que el inferior). Tapa de Polietileno a rosca, con cierre hermético. USO: Recolección de Orina para Urocultivo. En el caso de ser Nacional debe contar con Aprobación de Norma Técnica Nacional (ITINTEC) y Certificación de Esterilización por Rayos Gamma del IPEN.
1246	030105920	Frasco de plástico tapa a rosca con espátula para heces	UN	1 - 4	PRESENTACION: Frasco de Plástico en empaque de 50 o más unidades. CARACTERISTICAS: Frasco de Poliestireno ó Polipropileno clarificado de 15 a 40 ml de capacidad, de forma tubular y fondo cónico, de 20 mm de diámetro máximo, con etiqueta para rotulación. Tapa de Polietileno a rosca, con cierre de alta seguridad, con cuchara ó espátula insertada en la cara interna de la tapa. USO: Recolección de Heces.





					En el caso de ser Nacional debe contar con Aprobación de Norma Técnica Nacional (ITINTEC).
247	030101735	Frasco de plástico tapa a rosca para secreciones biológicas	UN	1 - 4	PRESENTACION: Frasco de Plástico en empaque de 50 o más unidades. CARACTERISTICAS: Frasco de Polietileno ó Polipropileno clarificado, de 50 a 100 ml de capacidad, de boca ancha sin reborde interno ni externo, estéril, con etiqueta para rotulación. Tapa de Polietileno a rosca, con cierre hermético. USO: Recolección de Líquidos ó Secreciones Biológicas. En el caso de ser Nacional debe contar con Aprobación de Norma Técnica Nacional (ITINTEC) y Certificación de Esterilización por Rayos Gamma del IPEN.
248	030101712	Frasco de poliestireno tapa a rosca para orina	UN	1 - 4	PRESENTACION: Frasco de Plástico en empaque de 50 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Frasco de Poliestireno de alta densidad ó Polipropileno clarificado de 100 a 150 ml de capacidad, de boca ancha sin reborde interno ni externo, graduado, con forma de Cono invertido de base truncada (diámetro superior mayor que el inferior), con etiqueta para rotulación. Tapa de Polietileno a rosca, con cierre hermético. USO: Recolección de Orina, permitiendo el Examen Físico directamente. En el caso de ser Nacional debe contar con Aprobación de Norma Técnica Nacional (ITINTEC).
249	030101690	Frasco de vidrio con tapa a rosca x 1000 mL autoclavable	UN	2,3,4	PRESENTACION: Frasco de Vidrio con Tapa a Rosca en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Frasco de Vidrio Borosilicato, de 1000 ml de capacidad, autoclavable, graduado, con Tapa Rosca de Plástico según ASTM - E982, autoclavable. USO: General en Laboratorio.
250	030105922	Frasco de vidrio con tapa a rosca x 250 mL autoclavable	UN	2,3,4	PRESENTACION: Frasco de Vidrio con Tapa a Rosca en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Frasco de Vidrio Borosilicato, de 250 ml de capacidad, autoclavable, graduado, con Tapa Rosca de Plástico según ASTM - E982, autoclavable. USO: General en Laboratorio.
251	030101723	Frasco gotero de vidrio x 150 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Frasco Gotero de Vidrio con Tapón esmerilado en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Frasco de Vidrio Ambar, de 150 ml de capacidad aproximadamente. Tapón dispensador esmerilado de vidrio, sin rosca, con canal para dispensar góta a góta por inclinación y cierre por rotación de la tapa. USO: General en Laboratorio.
252	030101725	Frasco para cultivo celular con tapa X 30 mL	UN	4	PRESENTACION: Frasco de Plástico con Tapa Rosca en empaque de 5 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Frasco de Poliestireno de 30 ml de capacidad, de 25 cm2 de área de crecimiento, estéril, libre de pirógenos, graduado, apilable, descartable, cuello angulado con tope para prevención de volcaduras. USO: Cultivo Celular.
253	030101726	Frasco para cultivo celular con tapa X 50 mL	UN	4	PRESENTACION: Frasco de Plástico con Tapa Rosca en empaque de 5 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Frasco de Poliestireno de 50 ml de capacidad, de 25 cm2 de área de crecimiento, estéril, libre de pirógenos, graduado, apilable, descartable, cuello angulado con tope para prevención de volcaduras. USO: Cultivo Celular.
254	030101737	Fructuosa p.a.	G	4	PRESENTACION: Fructuosa p.a. en Frasco por 250 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: D(-) Levulosa ó Azúcar de Frutas. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
255	030104798	Glicerina (Glicerol) p.a. grado ACS	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Glicerina (Glicerol) p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%. USO: Para Análisis.
256	030101840	Gradilla de polipropileno para crioviales (microtubos)	UN	1 - 4	PRESENTACION: Gradilla de Polipropileno. CARACTERISTICAS: Gradilla de Polipropileno Compactado, capacidad mínima de 40 posiciones, autoclavable, apilable. USO: Colocación de Crioviales.



257	030105926	Gradilla de polipropileno para tubo de 13 mm de diámetro	UN	1 - 4	PRESENTACION: Gradilla de Polipropileno. CARACTERISTICAS: Gradilla de Polipropileno Compactado, capacidad mínima de 60 posiciones, autoclavable, apilable. USO: Tubos de Ensayo de hasta 13 mm de diámetro.
258	030105924	Gradilla de polipropileno para tubo de 20 mm de diámetro	UN	1 - 4	PRESENTACION: Gradillas de Polipropileno. CARACTERISTICAS: Gradillas de Polipropileno Compactado, capacidad mínima de 40 posiciones, autoclavable, apilable. USO: Tubos de Ensayo de hasta 20 mm de diámetro.
259	030105925	Gradilla de polipropileno para tubo de 25 mm de diámetro	UN	1 - 4	PRESENTACION: Gradillas de Polipropileno. CARACTERISTICAS: Gradillas de Polipropileno Compactado, capacidad mínima de 20 posiciones, autoclavable, apilable. USO: Tubos de Ensayo de hasta 25 mm de diámetro.
260	030101896	Hidróxido de Amonio (amoniaco) p.a. grado ACS	CM 3	4	PRESENTACION: Hidróxido de Amonio (amoniaco) p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 25%. USO: Para Análisis.
261	030101907	Hidróxido de Potasio en lentejas p.a. grado ACS	G	1 - 4	PRESENTACION: Hidróxido de Potasio en lentejas p.a. grado ACS en Frasco por 250 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 85%. USO: Para Análisis.
262	030101909	Hidróxido de Sodio en Lentejas p.a. grado ACS	G	1 - 4	PRESENTACION: Hidróxido de Sodio en Lentejas p.a. grado ACS en Frasco por 250 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
263	030106140	Jeringa de polipropileno para pipeteador repetitivo	UN	2,3,4	PRESENTACION: Jeringa de Plástico con Embolo. CARACTERISTICAS: Jeringa de Polipropileno, Embolo de Polietileno de alta densidad, autoclavable, compatible con Pipeteadores Repetitivos Eppendorf, Finnipipette, Brand, entre otras. USO: Fluidos Biológicos y Soluciones Analíticas.
264	030103517	Juego de barras magnéticas mezcladoras	UN	2,3,4	PRESENTACION: Kit de 12 Barras Magnéticas Mezcladoras en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Barras Magnéticas (Imanes) Octogonales con anillo central, recubiertas de Plástico Politetrafluoretileno ó similar, resistentes a altas temperaturas, reusables. Kit de 6 pares de Barras entre 12.5 x 8 mm y 64 x 9.5 mm aproximadamente. USO: General en Laboratorio.
265	030104875	Lámina portaobjeto 25 x 75 mm	UN	1 - 4	PRESENTACION: Caja por 50 ó más unidades (láminas). CARACTERISTICAS: Láminas de Vidrio Optico de 25 x 75 mm, con cantos pulidos no cortantes. USO: Microscopía.
266	030102037	Lámina portaobjeto con franja de identificación	UN	3,4	PRESENTACION: Caja por 50 ó más unidades (láminas). CARACTERISTICAS: Láminas de Vidrio Optico de 25 x 75 mm, con cantos pulidos no cortantes y área despulida para identificación de muestra. USO: Microscopía.
267	030102048	Laminilla cubre cámara Neubauer	UN	1 - 4	PRESENTACION: Envase protector por 10 ó más unidades (laminillas), adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Laminilla rectangular de vidrio borosilicato, de 20 x 26 x 0.4 mm, con superficies planas y pulidas, bordes pulidos, con índice refracción 1.52 +/-0.01. USO: Cubrecámara Neubauer.




268	030104880	Laminilla cubreobjeto 18 x 18 mm	UN	1 - 4	PRESENTACION: Cajas por 100 ó más unidades (laminillas). CARACTERISTICAS: Laminillas de Vidrio Borosilicato 18 x 18 mm, espesor hasta 0.17 mm. USO: Microscopía.
269	030104881	Laminilla cubreobjeto 22 x 22 mm	UN	1 - 4	PRESENTACION: Cajas por 100 ó más unidades (laminillas). CARACTERISTICAS: Laminillas de Vidrio Borosilicato 22 x 22 mm, espesor hasta 0.17 mm. USO: Microscopía.
270	030104882	Laminilla cubreobjeto 22 x 30 mm	UN	3,4	PRESENTACION: Cajas por 100 ó más unidades (laminillas). CARACTERISTICAS: Laminillas de Vidrio Borosilicato 22 x 30 mm, espesor hasta 0.17 mm. USO: Microscopía.
271	030104883	Laminilla cubreobjeto 22 x 40 mm	UN	3,4	PRESENTACION: Cajas por 100 ó más unidades (laminillas). CARACTERISTICAS: Laminillas de Vidrio Borosilicato 22 x 40 mm, espesor hasta 0.17 mm. USO: Microscopía.
272	030104885	Laminilla cubreobjeto 22 x 60 mm	UN	3,4	PRESENTACION: Cajas por 100 ó más unidades (laminillas). CARACTERISTICAS: Laminillas de Vidrio Borosilicato 22 x 60 mm, espesor hasta 0.17 mm. USO: Microscopía.
273	030105944	Lanceta neonatal, descartable con disparador	UN	1 - 4	PRESENTACION: Lanceta en Cassette de Plástico. CARACTERISTICAS: Lanceta tipo cuchilla, con disparador automático. Debe permitir la recolección adecuada de la muestra de sangre, sin interrupción del flujo. USO: Para extracción de Sangre del Talón en Neonatos.
274	030102055	Lápiz con punta de diamante	UN	1 - 4	PRESENTACION: Lápiz de Punta fija. CARACTERISTICAS: Punta de Diamante Industrial ó Carburo de Tungsteno, de forma cónica labrada a 90°, fija. Montura de aluminio con un largo aproximado de 12 cm. USO: Para marcar Vidrios y Cerámicos.
275	030102056	Lápiz de cera para marcar vidrio	UN	1 - 4	PRESENTACION: Lápiz de Cera en cajas de 10 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Punta de Cera con envoltura de papel enrollado precortado, de alta resistencia, desenrollable para exponer la punta de cera, colores azul y rojo. Lápiz de aproximadamente 15 cm. USO: Para escritura en vidrio, metal y plástico.
276	030104870	L-Cistina	G	4	PRESENTACION: L-Cistina en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Polvo cristalino libre de impurezas. USO: Para medio de cultivos.
277	030104914	Marcador de escritura para criopreservación	UN	2,3,4	PRESENTACION: Marcador en empaque de 4 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Marcador (Plumón) Indeleble para uso en Laboratorio, de punta fina, con tinta resistente a Temperaturas menores de 80 °C. Los colores de los marcadores se indicarán en tabla adicional. USO: Rotulación e Identificación de Muestras y Materiales.
278	030102022	Matraz de Kitasato x 1000 mL	UN	3,4	PRESENTACION: Matraz de Kitasato de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Matraz de Vidrio Borosilicato, de 1000 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.





279	030102021	Matraz de Kitasato x 500 mL	UN	3,4	PRESENTACION: Matraz de Kitasato de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Matraz de Vidrio Borosilicato, de 500 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.
280	030101499	Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato 100 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Matraz Erlenmeyer de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Matraz de Vidrio Borosilicato, de 100 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.
281	030101504	Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato 1000 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Matraz Erlenmeyer de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Matraz de Vidrio Borosilicato, de 1000 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.
282	030101505	Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato 2000 mL	UN	2,3,4	PRESENTACION: Matraz Erlenmeyer de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Matraz de Vidrio Borosilicato, de 2000 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.
283	030101502	Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato 250 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Matraz Erlenmeyer de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Matraz de Vidrio Borosilicato, de 250 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.
284	030105947	Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato 3000 mL	UN	2,3,4	PRESENTACION: Matraz Erlenmeyer de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Matraz de Vidrio Borosilicato, de 3000 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.
285	030103573	Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato 50 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Matraz Erlenmeyer de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Matraz de Vidrio Borosilicato, de 50 ml a 300mL de capacidad, graduado, reusable, de acuerdo a anexo. USO: General en Laboratorio.
286	030101503	Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato 500 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Matraz Erlenmeyer de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Matraz de Vidrio Borosilicato, de 500 ml de capacidad, graduado, reusable. USO: General en Laboratorio.
287	030105630	Metil isobutil ketona p.a. grado ACS	CM 3	4	PRESENTACION: Metil isobutil ketona p.a. grado ACS en Frasco por 1000 ó 2500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: 4-Metil-2-Pentanol, Isometil-Butil-Carbinol. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
288	030103366	Microtubo de plástico para extracción con citrato de sodio 3.8%	UN	1 - 4	PRESENTACION: Microtubo para extracción al Vacío en empaques de 50 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Microtubo de plástico, de 1 ml de capacidad, con anticoagulante Citrato de Sodio al 3.8%, con código de colores para identificación, resistente a la centrifugación y caídas, descartables. USO: Obtención de Sangre en Neonatos para Pruebas de Coagulación.
289	030102196	Microtubo de plástico para extracción con EDTA-K3	UN	1 - 4	PRESENTACION: Microtubo para extracción al Vacío en empaques de 50 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Microtubo de plástico, de 1 ml de capacidad, con anticoagulante EDTA K3, con código de colores para identificación, resistente a la centrifugación y caídas, descartables. USO: Obtención de Sangre en Neonatos para Hemogramas.



1290	030105955	Microtubo de plástico para extracción con gel separador	UN	1 - 4	PRESENTACION: Microtubo para extracción al Vacío en empaques de 50 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Microtubo de plástico, de 1 ml de capacidad, sin anticoagulante, con Gel Separador de suero y activador de Coagulación, con código de colores para identificación, resistente a la centrifugación y caídas, descartables. USO: Obtención de Sangre en Neonatos para Pruebas Bioquímicas.
1291	030103352	Microtubo de plástico para microcentrifuga con tapa x 0.5 mL	UN	3, 4	PRESENTACION: Microtubo para Microcentrifuga en empaque de 50 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Microtubo cónico de Plástico, de 0.5 ml de capacidad, estéril, no graduado, con tapa de presión unida al tubo. Libre de RNAsa, DNAsa, ADN. USO: Centrifugación de muestras biológicas en Pruebas de Biología Molecular e Inmunología.
1292	030103281	Microtubo de plástico para microcentrifuga con tapa x 2 mL	UN	3, 4	PRESENTACION: Microtubo para Microcentrifuga en empaque de 50 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Microtubo cilíndrico de plástico, de fondo cónico, de 2 ml de capacidad, estéril, no graduado, con tapa rosca unida al tubo por asa circular que permita el giro de la tapa, con empaque de sellado entre la tapa y el tubo, resistencia sin deformación entre menos 120°C y más 120 °C. Libre de RNAsa, DNAsa, ADN. USO: Para extracción de pellet en Pruebas de Biología Molecular e Inmunología.
1293	030102216	Mortero chico con pilón	UN	1 - 4	PRESENTACION: Mortero Chico de Cerámica color Blanco con Pilón en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Mortero y Pilón de Porcelana vitrificada, con Pico para vaciado. Capacidad 250 ml aproximadamente. USO: General en Laboratorio.
1294	030102217	Mortero grande con pilón	UN	1 - 4	PRESENTACION: Mortero Grande de Cerámica color Blanco con Pilón en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Mortero y Pilón de Porcelana vitrificada, con Pico para vaciado. Capacidad 750 ml aproximadamente. USO: General en Laboratorio.
1295	030100037	N-Acetil Cisteína	G	4	PRESENTACION: N-Acetil Cisteína en Frasco por 25 ó 100 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinonimia: NALC (N acetil-L-cisteína). Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1296	030104957	Nitrato de Potasio p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Nitrato de Potasio p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1297	030102253	Nitroprusiato de Sodio p.a.	G	4	PRESENTACION: Nitroprusiato de Sodio p.a. en Frasco por 25 ó 100 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1298	030102281	Oxalato de Potasio p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Oxalato de Potasio p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 250 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%. USO: Para Análisis.
1299	030104053	Paño plastificado de bioseguridad para secado de líquidos biológicos	UN	1 - 4	PRESENTACION: Paquetes de 200 a 500 Unidades. CARACTERISTICAS: Paño de 10 cm por 10 cm aprox, Capa Superior impermeable plastificada, Cara Inferior de material poroso altamente absorbente. USO: General en Laboratorio.
1300	030105637	Papel de parafina	CM	1 - 4	PRESENTACION: Rollo de Papel de Parafina en empaque individual. CARACTERISTICAS: Rollo de cera de parafina impermeable. Extensibilidad de 200% o mayor. ACCESORIOS: Un Contenedor de Rollo con Cortador por cada 20 Unidades. USO: Muestras Biológicas y Soluciones Inorgánicas.



301	030102304	Papel filtro corriente	HJ	1 - 4	PRESENTACION: Papel Filtro en Pliego. CARACTERISTICAS: Pliego de 60 cm de largo por 40 cm de ancho, como mínimo. USO: Filtración de colorantes y reactivos. En el caso de ser Nacional debe contar con Aprobación de Norma Técnica Nacional (ITINTEC).
302	030102306	Papel lente para microscopio	HJ	1 - 4	PRESENTACION: Papel lente en Block por 20 ó más hojas. CARACTERISTICAS: Papel en hojas de 4 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de largo como mínimo, de grado óptico, 100 % libre de pelusas USO: Para limpieza de Vidrio Óptico.
303	030105973	Papel Whatman N° 40 - diámetro 15 cm	UN	1 - 4	PRESENTACION: Caja por 100 unidades. CARACTERISTICAS: Filtro de alfa celulosa de algodón, con poros de 8 um. USO: Filtración de Soluciones Analíticas.
304	030102333	Paradimetil aminobenzaldehído p.a.	G	3.4	PRESENTACION: Paradimetil aminobenzaldehído p.a. en Frasco por 50 ó 100 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Reactivo de Erlich. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS. USO: Para Análisis.
305	030103628	Paranitrofenil glucopiranosido	G	4	PRESENTACION: Paranitrofenil glucopiranosido en Frasco por 1 ó 5 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 97%. USO: Para Análisis.
306	030102362	Perlas de vidrio	G	3,4	PRESENTACION: Perlas de Vidrio en empaque por 250 gr ó mayor, herméticamente sellado, no reenvasado. CARACTERISTICAS: Perlas de Vidrio de Soda, de 5 mm de diámetro aproximadamente. USO: Desfibración. En el caso de ser Nacional debe contar con Aprobación de Norma Técnica Nacional (ITINTEC).
307	030102365	Pemanganato de Potasio p.a. grado ACS	G	3.4	PRESENTACION: Pemanganato de Potasio p.a. grado ACS en Frasco por 25 ó 100 ó 250 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
308	030102490	Piceta de plástico x 250 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Piceta de plástico. CARACTERISTICAS: Piceta de Polietileno de baja densidad, de 250 ml de capacidad. USO: Soluciones Analíticas buferadas.
309	030102491	Piceta de plástico x 500 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Piceta de plástico. CARACTERISTICAS: Piceta de Polietileno de baja densidad, de 500 ml de capacidad. USO: Soluciones Analíticas buferadas.
310	030102396	Pipeta automática de repetición	UN	2,3,4	PRESENTACION: Pipeta Automática de Repetición con accesorios completos. CARACTERISTICAS: Pipeta graduable, con Jeringas de Polipropileno. Diseño ergonómico. Autoclavable. ACCESORIOS: 1 Soporte de Pipeta y Set de 5 Jeringas de cada medida. USO: Material Biológico y Reactivos.
311	030102418	Pipeta automática graduable 8 canales rango mínimo entre 50 uL y 200 uL	UN	3,4	PRESENTACION: Pipeta multicanal digital de 8 canales. Rango mínimo de 50 - 200 uL. CARACTERISTICAS: Pipeta con émbolo de aire, graduable, con Visor Digital. Incrementos máximos de 1uL. Con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.6 a 3.0%. Imprecisión máxima: +/- 0.2 a 1.0%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte de Pipeta Multicanal para cada pipeta. USO: Material Biológico y Reactivos.
312	030102405	Pipeta automática graduable rango mínimo entre 10 uL y 40 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta Digital de émbolo de aire. Rango mínimo de 10 - 40 uL. CARACTERISTICAS: Pipeta graduable, con Visor digital, Incrementos máximos de 0.5 uL, con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.5 a 2.0%, Imprecisión máxima: +/- 0.3 a 2.0%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Muestras Biológicas y Reactivos.




313	030102423	Pipeta automática graduable rango mínimo entre 1mL y 5 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta digital de émbolo de aire. Rango mínimo de 1 - 5 ml. CARACTERISTICAS: Graduable, con Visor digital, Incrementos máximos de 0.05 ml, con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.5 a 0.8%. Imprecisión máxima: +/- 0.15 a 0.6%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Muestras Biológicas y Reactivos.
314	030102400	Pipeta automática graduable rango mínimo entre 1uL y 10 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta Digital de émbolo de aire. Rango mínimo 1 a 10 ul. CARACTERISTICAS: Graduable, con Visor Digital, Incrementos máximos de 0.1 ul, con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 1.0 a 2.5%. Imprecisión máxima: 0.4 a 2.0%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Muestras Biológicas y Reactivos.
315	030102416	Pipeta automática graduable rango mínimo entre 200 uL y 1000 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta digital de émbolo de aire. Rango mínimo de 200 - 1000 ul. CARACTERISTICAS: Graduable, con Visor digital, Incrementos máximos de 5.0 ul, con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.6 a 1.6%. Imprecisión máxima: +/- 0.2 a 0.6%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Muestras Biológicas y Reactivos.
316	030102408	Pipeta automática graduable rango mínimo entre 40 uL y 200 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta Digital de émbolo de aire Rango mínimo de 40 - 200 ul. CARACTERISTICAS: Graduable, con Visor digital, Incrementos máximos de 1.0 ul, con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.6 a 1.8%. Imprecisión máxima: +/- 0.2 a 0.7%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Muestras Biológicas y Reactivos.
317	030102382	Pipeta automática rango fijo 10 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta de émbolo de aire, Rango fijo de 10 uL CARACTERISTICAS: Con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 1.0%. Imprecisión máxima: +/- 0.5%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Material biológico y Reactivos.
318	030102384	Pipeta automática rango fijo 100 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta de émbolo de aire, Rango fijo de 100 uL CARACTERISTICAS: Con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.7%. Imprecisión máxima: +/- 0.3%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Material biológico y Reactivos.
319	030102376	Pipeta automática rango fijo 1000 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta de émbolo de aire, Rango fijo de 1000 uL CARACTERISTICAS: Con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.6%. Imprecisión máxima: +/- 0.2%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Material biológico y Reactivos.
320	030102386	Pipeta automática rango fijo 20 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta de émbolo de aire, Rango fijo de 20 uL CARACTERISTICAS: Con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.8%. Imprecisión máxima: +/- 0.3%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Material biológico y Reactivos.
321	030102388	Pipeta automática rango fijo 200 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta de émbolo de aire, Rango fijo de 200 uL CARACTERISTICAS: Con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.6%. Imprecisión máxima: +/- 0.2%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Material biológico y Reactivos.



322	030102392	Pipeta automática rango fijo 5 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta digital de émbolo de aire, Rango fijo de 5 uL. CARACTERISTICAS: Con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 1.5%. Imprecisión máxima: $\leq$ 0.8%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Material biológico y Reactivos.
323	030102394	Pipeta automática rango fijo 50 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta de émbolo de aire, Rango fijo de 50 uL. CARACTERISTICAS: Con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.7%. Imprecisión máxima: $\leq$ 0.4%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Material biológico y Reactivos.
324	030102395	Pipeta automática rango fijo 500 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta de émbolo de aire, Rango fijo de 500 uL. CARACTERISTICAS: Con expulsor de puntas. Diseño ergonómico. Inexactitud máxima: +/- 0.5%. Imprecisión máxima: $\leq$ 0.2%. Autoclavable. ACCESORIOS: 2 Racks de puntas por cada pipeta y 1 Soporte para Pipetas Automáticas por cada 5 pipetas. USO: Material biológico y Reactivos.
325	030102448	Pipeta de plástico estéril de 1 mL graduada 1/100	UN	4	PRESENTACION: Pipeta de Plástico con empaque individual sellado. CARACTERISTICAS: Pipeta de Poliestireno, de 1 ml de capacidad, estéril, graduada 1/100. USO: Líquidos Biológicos.
326	030102449	Pipeta de plástico estéril de 10 mL graduada 1/10	UN	4	PRESENTACION: Pipeta de Plástico con empaque individual sellado. CARACTERISTICAS: Pipeta de Poliestireno, de 10 ml de capacidad, estéril, graduada 1/10. USO: Líquidos Biológicos.
327	030102450	Pipeta de plástico estéril de 2 mL graduada 1/100	UN	4	PRESENTACION: Pipeta de Plástico con empaque individual sellado. CARACTERISTICAS: Pipeta de Poliestireno, de 2 ml de capacidad, estéril, graduada 1/100. USO: Líquidos Biológicos.
328	030102451	Pipeta de plástico estéril de 5 mL graduada 1/10	UN	4	PRESENTACION: Pipeta de Plástico con empaque individual sellado. CARACTERISTICAS: Pipeta de Poliestireno, de 5 ml de capacidad, estéril, graduada 1/10. USO: Líquidos Biológicos. CERTIFICACION: ISO-9001. Aprobación de Norma ASTM, DIN ó
329	030102454	Pipeta graduada vidrio borosilicato de 1 mL al 1/100	UN	1 - 4	PRESENTACION: 3Pipeta de Vidrio. CARACTERISTICAS: Pipeta de Vidrio Borosilicato Tipo I Clase B de ASTM - E438, de 1 ml de capacidad, graduada 1/100, reusable. USO: General en Laboratorio.
330	030102462	Pipeta graduada vidrio borosilicato de 10 mL al 1/10	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta de Vidrio. CARACTERISTICAS: Pipeta de Vidrio Borosilicato Tipo I Clase B de ASTM - E438, de 10 ml de capacidad, graduada 1/10, reusable. USO: General en Laboratorio.
331	030102455	Pipeta graduada vidrio borosilicato de 2 mL al 1/100	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta de Vidrio. CARACTERISTICAS: Pipeta de Vidrio Borosilicato Tipo I Clase B de ASTM - E438, de 2 ml de capacidad, graduada 1/100, reusable. USO: General en Laboratorio.
332	030102456	Pipeta graduada vidrio borosilicato de 5 mL al 1/10	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta de Vidrio. CARACTERISTICAS: Pipeta de Vidrio Borosilicato Tipo I Clase B de ASTM - E438, de 5 ml de capacidad, graduada 1/10, reusable. USO: General en Laboratorio.



333	030102437	Pipeta para recuento de glóbulos blancos	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta mezcladora para contar Glóbulos Blancos. CARACTERISTICAS: Vidrio de Soda ó Borosilicato, Contrastable, Divisiones a 0,5 y 1.0 ml. USO: Recuento de Glóbulos Blancos.
334	030102438	Pipeta para recuento de glóbulos rojos y plaquetas	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta mezcladora para contar Glóbulos Rojos. CARACTERISTICAS: Vidrio de Soda ó Borosilicato, Contrastable, Divisiones a 0,5 y 1.0 ml. USO: Recuento de Glóbulos Rojos y Plaquetas.
335	030102446	Pipeta Pasteur de plástico de 1 mL a 2 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta Tipo Pasteur en empaque individual. CARACTERISTICAS: Pipeta de Polietileno transparente de baja densidad, estéril, de 1 a 2 ml de capacidad, no graduada, sin bordes ni marcas en la superficie, con punta normal. USO: Para transferencia de material de biológico.
336	030102447	Pipeta Pasteur de plástico de 3 mL a 5 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta Tipo Pasteur en empaque individual. CARACTERISTICAS: Pipeta de Polietileno transparente de baja densidad, estéril, de 3 a 5 ml de capacidad, graduada, de tallo largo, longitud mínima de 15cm. USO: Para transferencia de material de biológico.
337	030102440	Pipeta Pasteur de vidrio x 150 mm.	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta Pasteur de Vidrio en caja por 100 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Pipeta de Vidrio de Soda, de 150 mm de largo, no graduada, descartable. USO: Para Muestras Biológicas.
338	030102442	Pipeta Pasteur de vidrio x 250 mm.	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipeta Pasteur de Vidrio en caja por 200 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Pipeta de Vidrio de Soda, de 250 mm de largo, no graduada, descartable. USO: Para Muestras Biológicas.
339	030102480	Pipetor graduable rango de 0.1 a 1 mL con frasco	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipetor Graduable (Dispensador) con Frasco de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Pipetor con Sistema de ajuste de volumen mediante regleta dentada visible, de fácil manejo, resistente a soluciones alcalinas, ácidos débiles y disolventes polares, con capacidad para dispensar entre 0.1 y 1.0 ml, con incrementos de 0.02 ml. Frasco de vidrio ámbar de 250 ml ó más de capacidad. USO: General en Laboratorio.
340	030102478	Pipetor graduable rango de 0.1 a 2.5 mL con frasco	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipetor Graduable (Dispensador) con Frasco de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Pipetor con Sistema de ajuste de volumen mediante regleta dentada visible, fácil manejo, resistente a soluciones alcalinas, ácidos débiles y disolventes polares, con capacidad de dispensar entre 0.1 y 2.5 ml, con un incremento de 0.2 ml. Frasco de vidrio ámbar de 250 ml ó más de capacidad. USO: General en Laboratorio.
341	030102477	Pipetor graduable rango de 1 a 10 mL con frasco	UN	1 - 4	PRESENTACION: Pipetor Graduable (Dispensador) con Frasco de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Pipetor con Sistema de ajuste de volumen mediante regleta dentada visible, de fácil manejo, resistente a soluciones alcalinas, ácidos débiles y disolventes polares, con capacidad de dispensar entre 1 y 10 ml, con un incremento de 0.2 ml. Frasco de vidrio ámbar de 1000 ml de capacidad. USO: General en Laboratorio.
342	030102500	Placa de vidrio excavada para prueba serológica	UN	1 - 4	PRESENTACION: Placa de Vidrio. CARACTERISTICAS: Placa excavada, reusable. USO: Pruebas Serológicas.



1343	030102555	Porta lámina de plástico	UN	1 - 4	PRESENTACION: Bandeja de plástico para láminas portaobjeto. CARACTERISTICAS: Bandeja de Plástico, rectangular, para 20 a 40 láminas de 25 x 75 mm, apilable, sin tapa, color blanco. USO: Soporte para Láminas para Lectura.
1344	030103640	Probeta de plástico graduada de 2000 mL con asa	UN	1 - 4	PRESENTACION: Probeta de Plástico con asa. CARACTERISTICAS: Probeta de Polietileno de alta densidad, de 2000 ml de capacidad, reusable, graduada, con asa fija. USO: General en Laboratorio.
1345	030102592	Probeta de vidrio borosilicato graduada de 100 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Probeta de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Probeta de Vidrio Borosilicato, de 100 ml de capacidad, graduada, reusable. USO: General en Laboratorio.
1346	030102596	Probeta de vidrio borosilicato graduada de 1000 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Probeta de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Probeta de Vidrio Borosilicato, de 1000 ml de capacidad, graduada, reusable. USO: General en Laboratorio.
1347	030102598	Probeta de vidrio borosilicato graduada de 10mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Probeta de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Probeta de Vidrio Borosilicato, de 10 ml a 2000 mL de capacidad, graduada, reusable, según anexo. USO: General en Laboratorio.
1348	030102597	Probeta de vidrio borosilicato graduada de 2000 mL	UN	2,3,4	PRESENTACION: Probeta de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Probeta de Vidrio Borosilicato, de 2000 ml de capacidad, graduada, reusable. USO: General en Laboratorio.
1349	030102584	Probeta de vidrio borosilicato graduada de 25 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Probeta de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Probeta de Vidrio Borosilicato, de 25 ml de capacidad, graduada, reusable. USO: General en Laboratorio.
1350	030102594	Probeta de vidrio borosilicato graduada de 250 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Probeta de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Probeta de Vidrio Borosilicato, de 250 ml de capacidad, graduada, reusable. USO: General en Laboratorio.
1351	030102591	Probeta de vidrio borosilicato graduada de 50 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Probeta de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Probeta de Vidrio Borosilicato, de 50 ml de capacidad, graduada, reusable. USO: General en Laboratorio.
1352	030102595	Probeta de vidrio borosilicato graduada de 500 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Probeta de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Probeta de Vidrio Borosilicato, de 500 ml de capacidad, graduada, reusable. USO: General en Laboratorio.
1353	030105403	Propilenglicol p.a.	CM 3	4	PRESENTACION: Propilenglicol p.a. en Frasco por 25 ó 100 ó 500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: 1,2 Propanodiol. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.5%. USO: Para Análisis.



1354	030105278	Puntera para pipeta automática rango 1 a 5 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Puntera descartable en empaque de 100 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Puntera de plástico con reborde externo, capacidad mínima de 1 a 5 ml, de baja retención, universal, compatible con pipetas Eppendorf y Finn timer entre otras. ACCESORIOS: 1 Soporte para punteras por cada 2500 unidades. USO: Material Biológico y Reactivos.
1355	030102641	Puntera universal para pipeta automática rango mínimo 1-10 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Puntera descartable en empaque de 100 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Puntera de plástico, compatible con pipetas Eppendorf, Brand, Oxford o Finn timer entre otras de acuerdo a cuadro de necesidades adjunto. ACCESORIOS: 1 Soporte para punteras por cada 2500 unidades. USO: Material Biológico y Reactivos.
1356	030102646	Puntera universal para pipeta automática rango mínimo 200-1000 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Puntera descartable en empaque de 250 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Puntera de plástico, color Celeste, con reborde externo, capacidad mínima de 200 a 1000 uL, de baja retención, universal, compatible con pipetas Eppendorf y Finn timer entre otras. ACCESORIOS: 1 Soporte para punteras por cada 2500 unidades. USO: Material Biológico y Reactivos.
1357	030105993	Puntera universal para pipeta automática rango mínimo 5 - 200 uL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Puntera descartable en empaque de 250 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Puntera de plástico, color amarillo, con reborde externo, capacidad mínima de 5 a 200 uL, de baja retención, universal, compatible con pipetas Eppendorf y Finn timer entre otras. ACCESORIOS: 1 Soporte para punteras por cada 5000 unidades. USO: Material Biológico y Reactivos.
1358	030105111	Sacarosa (Sucrosa) p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Sacarosa (Sucrosa) p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración 90%. USO: Para Análisis.
1359	030102992	Sulfato de Cobre II 5H ₂ O p.a. grado ACS	G	4	PRESENTACION: Sulfato de Cobre II 5H ₂ O p.a. grado ACS en Frasco por 250 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Pentahidratado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 98%. USO: Para Análisis.
1360	030103685	Sulfato de Cobre II Anhidro p.a.	G	4	PRESENTACION: Sulfato de Cobre II Anhidro p.a. en Frasco por 250 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Anhidro. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Concentración mínima 98%. USO: Para Análisis.
1361	030103008	Sulfato de Zinc 7H ₂ O p.a. grado ACS	G	1 - 4	PRESENTACION: Sulfato de Zinc 7H ₂ O p.a. grado ACS en Frasco por 100 ó 500 ó 1000 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Heptahidratado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1362	030105273	Tiosulfato de Sodio p.a. grado ACS	G	1 - 4	PRESENTACION: Tiosulfato de Sodio p.a. grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 ó 2500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.
1363	030104534	Tira para medir pH rango mínimo de 1 - 14	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tira para medir pH rango mínimo de 1 - 14 en Envase por 50 o más tiras. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Tiras individuales precortadas, con rango de pH mínimo de 1 a 14, con sensibilidad mínima de 0.5 unidades. USO: Medición de pH en Líquidos Orgánicos ó Soluciones Analíticas.
1364	030104535	Tira para medir pH rango mínimo de 1 - 5	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tira para medir pH rango mínimo de 1 - 5 en Envase por 50 o más tiras. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Tiras individuales precortadas, con rango de pH mínimo de 1 a 5, con sensibilidad mínima de 0.5 unidades. USO: Medición de pH en Líquidos Orgánicos ó Soluciones Analíticas.




1365	030106032	Tira para medir pH rango mínimo de 6 - 8	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tira para medir pH rango mínimo de 6 - 8 en Envase por 50 o más tiras. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Tiras individuales precortadas, con rango de pH mínimo de 6 a 8, con sensibilidad mínima de 0.5 unidades. USO: Medición de pH en Líquidos Orgánicos ó Soluciones Analíticas.
1366	030103360	Tubo de plástico 12 x 75 mm.	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubos de Plástico en empaque por 50 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo de Polietileno (opcional de Poliestireno), de 12 mm de diámetro x 75 mm de longitud, resistente a centrifugación de 4000 g ó mayor, sin reborde, sin tapa. USO: Para Fluidos Biológicos y Soluciones Analíticas.
1367	030103279	Tubo de plástico cónico estéril con tapa x 15 mL	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo de Plástico en empaque por 25 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo cónico de Polipropileno, graduado, capacidad de 15 ml, con tapa rosca de Polietileno. Esterilizado por Radiación Gamma, autoclavable, resistente a centrifugación de 4000 g ó mayor. USO: Para métodos de Extracción y Separación Celular.
1368	030103280	Tubo de plástico cónico estéril con tapa x 50 mL	UN	4	PRESENTACION: Tubo de Plástico en empaque por 25 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo cónico de Polipropileno, graduado, capacidad de 50 ml, con tapa rosca de Polietileno. Esterilizado por Radiación Gamma, autoclavable, resistente a centrifugación de 4000 g ó mayor. USO: Para métodos de Extracción y Separación Celular.
1369	030103292	Tubo de vidrio borosilicato 12 x 75 mm. ASTM - E438	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubos de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Tubo de Vidrio Borosilicato, de 12 mm de diámetro x 75 mm de largo, resistente a centrifugación de 4000 g ó mayor, sin tapa. USO: General en Laboratorio.
1370	030103293	Tubo de vidrio borosilicato 13 x 100 mm ASTM - E982	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Tubo de Vidrio Borosilicato, de 13 mm de diámetro x 100 mm de largo, sin tapa, reusable. USO: General en Laboratorio.
1371	030103294	Tubo de vidrio borosilicato 13 x 100 mm con tapa rosca ASTM - E982	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo de Vidrio con Tapa a Rosca en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Tubo de Vidrio Borosilicato, de 13 mm de diámetro x 100 mm de largo, reusable, con Tapa Rosca de Plástico según ASTM - E982. USO: General en Laboratorio.
1372	030103301	Tubo de vidrio borosilicato 16 x 125 mm ASTM - E982	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo de Vidrio en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Tubo de Vidrio Borosilicato, de 16 mm de diámetro x 125 mm de largo, sin tapa, reusable. USO: General en Laboratorio.
1373	030103309	Tubo de vidrio borosilicato 18 x 150 mm con tapa rosca ASTM - E982	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo de Vidrio con Tapa a Rosca en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Tubo de Vidrio Borosilicato, de 18 mm de diámetro x 150 mm de largo, reusable, con Tapa Rosca de Plástico según ASTM - E982. USO: General en Laboratorio.
1374	030103312	Tubo de vidrio borosilicato 20 x 150 mm con tapa rosca ASTM - E982	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo de Vidrio con Tapa a Rosca en embalaje adecuado para transporte y almacenamiento. CARACTERISTICAS: Tubo de Vidrio Borosilicato, de 20 mm de diámetro x 150 mm de largo, reusable, con Tapa Rosca de Plástico según ASTM - E982. USO: General en Laboratorio.
1375	030103338	Tubo plástico para extracción al vacío con ACD	UN	4	PRESENTACION: Tubo para extracción al Vacío EN EMPAQUE DE 25 o más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico, con ACD, con tapa hermética perforable, que no tienda a formar aerosoles al abrirlo, con código de colores para identificación, resistente a la centrifugación y caídas, descartables USO: Obtención y/o preservación de células sanguíneas



376	030103365	Tubo plástico para extracción al vacío con citrato de sodio 3.8%	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo para extracción al Vacío en empaque por 25 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico, con anticoagulante Citrato de Sodio 3.8%, con tapa hermética perforable, que no tienda a formar aerosoles al abrirlo, con código de colores para identificación, resistente a la centrifugación y caídas, descartables. USO: Obtención de Sangre para Pruebas de Coagulación.
377	030104090	Tubo plástico para extracción al vacío con EDTA-K3	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo para extracción al Vacío en empaque por 25 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico, con anticoagulante EDTA K3, con tapa hermética perforable, que no tienda a formar aerosoles al abrirlo, con código de colores para identificación, resistente a la centrifugación y caídas, descartables. USO: Obtención de Sangre para Hemogramas.
378	030103262	Tubo plástico para extracción al vacío con gel separador	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo para extracción al Vacío en empaque por 25 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico, sin anticoagulante, con Gel Separador de suero y Activador de Coagulación, con tapa hermética perforable, que no tienda a formar aerosoles al abrirlo, con código de colores para identificación, resistente a la centrifugación y caídas, descartables. USO: Obtención de Sangre para Pruebas Bioquímicas e Inmunológicas.
379	030103263	Tubo plástico para extracción al vacío con heparina de Litio y gel separador	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo para extracción al Vacío en empaque por 25 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico, con anticoagulante Heparina de Litio y Gel Separador de Plasma, con tapa hermética perforable, que no tienda a formar aerosoles al abrirlo, con código de colores para identificación, resistente a la centrifugación y caídas, descartables. USO: Obtención de Sangre para Pruebas Bioquímicas e Inmunológicas.
380	030103268	Tubo plástico para extracción al vacío sin aditivo	UN	1 - 4	PRESENTACION: Tubo para extracción al Vacío en empaque por 25 ó más unidades. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico, sin aditivo, con tapa hermética perforable, que no tienda a formar aerosoles al abrirlo, con código de colores para identificación, resistente a la centrifugación y caídas, descartables. USO: Obtención de Sangre para Pruebas de Laboratorio.
381	030105327	Tween 20	CM 3	4	PRESENTACION: Tween 20 en Frasco por 100 ó 500 ó 1000 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Densidad 1.100 a 1.110. USO: Para Análisis.
382	030105328	Tween 80	CM 3	4	PRESENTACION: Tween 80 en Frasco por 500 ó 1000 ó 2500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Densidad 1.073 a 1.083. USO: Para Análisis.
383	030103372	Unidad de filtración descartable x 250mL	UN	4	PRESENTACION: Unidad de Filtración Completa en empaque individual estéril. CARACTERISTICAS: Unidad de Filtración Completa de 250 mL con Embudo, Tapa, Filtro y Frasco Contenedor. Embudo, Tapa y Contenedor de Polisulfonato, graduados, autoclavables. Filtro de Membrana de Acetato de Celulosa con poro de 0.22 um. USO: Esterilización en frío ó clarificación de Soluciones Proteináceas.
384	030103373	Unidad de filtración descartable x 500 mL	UN	4	PRESENTACION: Unidad de Filtración Completa en empaque individual estéril. CARACTERISTICAS: Unidad de Filtración Completa de 500 mL con Embudo, Tapa, Filtro y Frasco Contenedor. Embudo, Tapa y Contenedor de Polisulfonato, graduados, autoclavables. Filtro de Membrana de Acetato de Celulosa con poro de 0.22 um. USO: Esterilización en frío ó clarificación de Soluciones Proteináceas.
385	030106036	Unidad de filtración reusable	UN	3,4	PRESENTACION: Unidad de Filtración Completa con Embudo con Tapa, Filtro y Frasco Contenedor. CARACTERISTICAS: Embudo, Tapa y Contenedor de Polisulfonato de 500 ml de volumen, graduados, autoclavables, reusables. Filtro de Membrana de Acetato de Celulosa de poros de 0.22 um. ACCESORIOS: 10 Filtros de Membrana de Acetato de Celulosa de 0.22 um.
386	030103407	Vaso de Coplin para colorear láminas	UN	1 - 4	PRESENTACION: Vaso de Coplin de Plástico. CARACTERISTICAS: Vaso de Coplin y Tapa de Polietileno de alta densidad, con capacidad para 10 láminas portaobjeto de 75 x 25 mm. USO: Coloración de Láminas.



1387	030103450	Xilol p.a. Grado ACS	CM 3	1 - 4	PRESENTACION: Xilol p.a. Grado ACS en Frasco por 500 ó 1000 ó 2500 ml, herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Xylene. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración de Isómeros mínima 98.5%. USO: Para Análisis.
1388	030103453	Yodo sublimado	G	1 - 4	PRESENTACION: Yodo sublimado en Frasco por 100 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99.8%. USO: Para Análisis.
1389	030103458	Yoduro de Potasio p.a. grado ACS	G	1 - 4	PRESENTACION: Yoduro de Potasio p.a. grado ACS en Frasco por 50 ó 100 ó 500 gr, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Grado ACS, Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.



DOCUMENTO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS EN CESION EN USO



LISTADO GENERAL DE EQUIPOS

1. ANALIZADOR BIOQUÍMICO EXTRAGRANDE
2. ANALIZADOR BIOQUÍMICO GRANDE
3. ANALIZADOR BIOQUÍMICO MEDIANO
4. ANALIZADOR BIOQUÍMICO CHICO
5. ANALIZADOR NEFELOMÉTRICO/INMUNOENSAYOS HOMOGENEOS
6. FOTÓMETRO DIGITAL
7. ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS RANDOM PEQUEÑO
8. ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS RANDOM MEDIANO.
9. ANALIZADOR GRANDE DE INMUNOENSAYOS EN MICROPLACA
10. ANALIZADOR MEDIANO DE INMUNOENSAYOS EN MICROPLACA
11. ANALIZADOR CHICO DE INMUNOENSAYOS EN MICROPLACA
12. MODULAR PARA INMUNOENSAYOS EN MICROPLACA
13. MODULAR PARA CENTELLEO GAMMA
14. MODULAR PARA SCREENING NEONATAL
15. ANALIZADOR DE ELECTROFORESIS EN GEL
16. MODULAR PARA ELECTROFORESIS EN GEL
17. ANALIZADOR DE ELECTROFORESIS CAPILAR
18. ANALIZADOR DE GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS
19. ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS
20. ANALIZADOR DE TIRAS DE ORINA
21. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO MEDIANO DE TIRAS DE ORINA
22. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO CHICO DE TIRAS DE ORINA
23. ANALIZADOR DE SEDIMENTO URINARIO
24. ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DIFERENCIAL DE 3 ESTIRPES
25. ANALIZADOR HEMATOLÓGICO GRANDE DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES
26. ANALIZADOR HEMATOLÓGICO MEDIANO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES
27. ANALIZADOR HEMATOLÓGICO CHICO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES
28. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN GRANDE
29. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN MEDIANO
30. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN CHICO
31. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE COAGULACION
32. EQUIPO PARA AGREGACION PLAQUETARIA
33. MODULAR MEDIANO PARA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION AUTOMATIZADA
34. MODULAR CHICO PARA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION AUTOMATIZADA
35. EQUIPO PARA INMUNOHEMATOLOGÍA EN TARJETA
36. MODULAR PARA INMUNOHEMATOLOGÍA EN TARJETA
37. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA AFERESIS
38. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA SEPARACIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS.
39. EQUIPO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO
40. INCUBADOR AUTOMATIZADO GRANDE DE HEMOCULTIVOS
41. INCUBADOR AUTOMATIZADO MEDIANO DE HEMOCULTIVOS
42. INCUBADOR AUTOMATIZADO CHICO DE HEMOCULTIVOS
43. ANALIZADOR AUTOMATIZADO GRANDE DE DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA



44. ANALIZADOR AUTOMATIZADO MEDIANO DE DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA
45. MODULAR PARA DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA
46. ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICOBACTERIANA
47. EQUIPO DISPENSADOR DE DISCOS DE SENSIBILIDAD
48. MODULAR PARA LECTURA AUTOMATIZADA DE SENSIBILIDAD MICROBIANA POR DISCOS
49. ANALIZADOR DE CITOMETRIA DE FLUJO PEQUEÑO
50. ANALIZADOR DE CITOMETRIA DE FLUJO MEDIANO
51. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA BIOLOGIA MOLECULAR
52. MODULAR PARA BIOLOGIA MOLECULAR
53. MODULAR PARA HIBRIDIZACION
54. MODULAR PARA INMUNOBLOT
55. MODULAR PARA CROMATOGRAFIA LIQUIDA
56. EQUIPO FOTÓMETRO DIGITAL UV
57. MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA DE FASE INVERTIDA
58. ANALIZADOR DE CALCIO IÓNICO
59. COLOREADOR AUTOMATICO PARA INMUNOHISTOQUIMICA




EQUIPOS CON ESPECIFICACIONES TECNICAS


1. ANALIZADOR BIOQUIMICO EXTRAGRANDE	
1. Tipo	- Analizador Random de Acceso Discreto completamente Automatizado.
2. Metodología	- Espectrofotometría y/o Turbidimetría ó Reflectometría, e ISE incorporado.
3. Performance	- 950 ó más pruebas por hora.
4. Características	- 50 ó más Reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. Con 8 o más canales libres para el procesamiento de pruebas adquiridas en forma independiente ó no agrupada. - 40 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 50 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Tubos Primarios. - Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Dilución automática de muestras.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio. - Sistema de Información de Laboratorio (LIS ó SIL): Software abierto con capacidad de interconectarse al Sistema de Gestión Hospitalaria y de manejar toda la información del Laboratorio (Resultados, Históricos, Control de Calidad, Estadísticas, como mínimo) por 1 año ó más, con una librería de interfaces para todos los Analizadores existentes en el Laboratorio, permitiendo la conexión sin costo de los diferentes Analizadores al Sistema. Hardware constituido por Servidor que permita el funcionamiento adecuado del Software del Sistema de Información de Laboratorio y Concentrador (Hub) con el número de Puertos suficientes para todos los Analizadores del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



2. ANALIZADOR BIOQUÍMICO GRANDE	
1. Tipo	- Analizador Random de Acceso Discreto completamente Automatizado.
2. Metodología	- Espectrofotometría y/o Turbidimetría ó Reflectometría, e ISE incorporado.
3. Performance	- 600 o más pruebas fotométricas por hora.
4. Características	- 40 o más Reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. Debe contar con 8 o más canales libres para el procesamiento de pruebas adquiridas en forma independiente o no agrupada. - 35 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 40 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Tubos Primarios. - Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Dilución automática de muestras.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio. - Sistema de Información de Laboratorio (LIS ó SIL): Software abierto con capacidad de interconectarse al Sistema de Gestión Hospitalaria y de manejar toda la información del Laboratorio (Resultados, Históricos, Control de Calidad, Estadísticas, como mínimo) por 1 año ó más, con una librería de Interfases para todos los Analizadores existentes en el Laboratorio, permitiendo la conexión sin costo de los diferentes Analizadores al Sistema. Hardware constituido por Servidor que permita el funcionamiento adecuado del Software del Sistema de Información de Laboratorio y Concentrador (Hub) con el número de Puertos suficientes para todos los Analizadores del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



3. ANALIZADOR BIOQUIMICO MEDIANO	
1. Tipo	- Analizador Random de Acceso Discreto completamente Automatizado.
2. Metodología	- Espectrofotometría y/o Turbidimetría ó Reflectometría, e ISE incorporado.
3. Performance	- 250 ó más pruebas por hora.
4. Características	- 30 ó más Reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. Debe contar con 6 o más canales libres para el procesamiento de pruebas adquiridas en forma independiente o no agrupada. - 30 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 30 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Tubos Primarios. - Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Dilución automática de muestras.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina, y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio. - Sistema de Información de Laboratorio (LIS ó SIL): Software abierto con capacidad de interconectarse al Sistema de Gestión Hospitalaria y de manejar toda la información del Laboratorio (Resultados, Históricos, Control de Calidad, Estadísticas, como mínimo) por 1 año ó más, con una librería de interfases para todos los Analizadores existentes en el Laboratorio, permitiendo la conexión sin costo de los diferentes Analizadores al Sistema. Hardware constituido por Servidor que permita el funcionamiento adecuado del Software del Sistema de Información de Laboratorio y Concentrador (Hub) con el número de Puertos suficientes para todos los Analizadores del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



4. ANALIZADOR BIOQUIMICO CHICO	
1. Tipo	- Analizador Random de Acceso Discreto completamente Automatizado.
2. Metodología	- Espectrofotometría y/o Turbidimetría ó Reflectometría, ISE opcional.
3. Performance	- 100 ó más pruebas fotométricas por hora.
4. Características	- 20 ó más reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. Debe contar con 4 o más canales libres para el procesamiento de pruebas adquiridas en forma independiente o no agrupada. - 20 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 20 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Tubos Primarios. - Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Dilución automática de muestras.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina, y otros fluidos biológicos
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio. - Sistema de Información de Laboratorio (LIS ó SIL): Software abierto con capacidad de interconectarse al Sistema de Gestión Hospitalaria y de manejar toda la información del Laboratorio (Resultados, Históricos, Control de Calidad, Estadísticas, como mínimo) por 1 año ó más, con una librería de interfases para todos los Analizadores existentes en el Laboratorio, permitiendo la conexión sin costo de los diferentes Analizadores al Sistema. Hardware constituido por Servidor que permita el funcionamiento adecuado del Software del Sistema de Información de Laboratorio y Concentrador (Hub) con el número de Puertos suficientes para todos los Analizadores del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



5. ANALIZADOR DE NEFELOMETRICO/INMUNOENSAYOS HOMOGENEOS	
1. Tipo	- Analizador Random de Acceso Discreto completamente Automatizado.
2. Metodología	- Nefelometría Cinética ó Espectrofotometría.
3. Performance	- 60 o más pruebas por hora.
4. Características	- 10 ó más Reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. - 10 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 20 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Tubos Primarios. - Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Dilución automática de muestras.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina, y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



6. FOTOMETRO DIGITAL	
1. Tipo	- Equipo Semiautomatizado.
2. Metodología	- Fotometría Cinética.
3. Performance	- 20 ó más lecturas fotométricas por hora.
4. Características	- Lectura Fotométrica en longitudes de onda de 300 a 800 nm. - Con sistema de aspiración de muestras y celda de flujo interna. - Volumen de Aspiración de 500 microlitros o menor. - Reacciones de Punto Final, 2 puntos y Cinéticas. - Memoria para 20 o más protocolos de pruebas.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras ó Cubetas de muestra con alícuota. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- No aplicable
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a las necesidades del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




7. ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS RANDOM PEQUEÑO	
1. Tipo	- Analizador Random Pequeño de Acceso Discreto completamente Automatizado.
2. Metodología	- Fluorescencia enzimática, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó similar.
3. Performance	- 80 ó más pruebas por hora.
4. Características	- 12 ó más reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. - 12 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 20 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Tubos Primarios. - Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Dilución automática de muestras. - Sistema atemperado para reactivos (Según requerimiento del usuario)
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina, y otros fluidos biológicos. - Sistema atemperado para reactivos
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr. y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




8. ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS RANDOM MEDIANO	
1. Tipo	- Analizador Random Mediano de Acceso Discreto completamente Automatizado.
2. Metodología	- Fluorescencia Enzimática, Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia ó similar.
3. Performance	- 150 ó más pruebas por hora.
4. Características	- 18 ó más reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. - 18 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 50 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Tubos Primarios. - Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Dilución automática de muestras.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina, y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr. y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



9. ANALIZADOR GRANDE DE INMUNOENSAYOS EN MICROPLACA	
1. Tipo	- Analizador Multibatch de Microplacas de Canal Abierto.
2. Metodología	- Enzima inmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente ó similar.
3. Performance	- 600 ó más pruebas por corrido.
4. Características	- 9 ó más microplacas en procesamiento e incubación simultánea a 37°C. - 9 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo. - 90 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Tubos Primarios. - Filtros de Lectura apropiados y Filtro de Referencia para lectura dual. - Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores y Controles del Kit: Deben venir dentro de los Kits de Reactivos, manteniendo una concordancia con lo señalado en la etiqueta de la caja. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana (para Índice de Cut-off), de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



10. ANALIZADOR MEDIANO DE INMUNOENSAYOS EN MICROPLACA	
1. Tipo	- Analizador Multibatch de Microplacas de Canal Abierto.
2. Metodología	- Enzima inmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente ó similar.
3. Performance	- 300 ó más pruebas por corrido.
4. Características	- 4 ó más microplacas en procesamiento e incubación simultánea a 37°C. - 4 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo. - 60 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Tubos Primarios. - Filtros de Lectura apropiados y Filtro de Referencia para lectura dual. - Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores y Controles del Kit: Deben venir dentro de los Kits de Reactivos, manteniendo una concordancia con lo señalado en la etiqueta de la caja. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana (para Índice de Cut-off), de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



11. ANALIZADOR CHICO DE INMUNOENSAYOS EN MICROPLACA	
1. Tipo	- Analizador Multibatch de Microplacas de Canal Abierto automatizado.
2. Metodología	- Enzimaimunoensayo
3. Performance	- 192 ó más pruebas por corrido.
4. Características	- 2 ó más microplacas en procesamiento e incubación simultánea a 37°C. - 2 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo. - 30 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Tubos Primarios. - Filtros de Lectura apropiados y Filtro de Referencia para lectura dual. - Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestras.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores y Controles del Kit: Deben venir dentro de los Kits de Reactivos, manteniendo una concordancia con lo señalado en la etiqueta de la caja. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana (para Índice de Cut-off), de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




12. MODULAR PARA INMUNOENSAYOS EN MICROPLACA	
1. Tipo	- Modular conformado por un Lavador de Tiras, un Incubador de Microplacas y un Lector de Microplacas.
2. Metodología	- Enzimaimmunoensayo, Inmunoensayo Fluorescente ó similar.
3. Performance	- 96 ó más pruebas por corrido.
4. Características	- Lector: Filtros de Lectura apropiados y Filtro de Referencia para lectura dual. - Lavador: Programable, con peine de lavado para 1 ó 2 tiras de 8 pozos. - Incubador: Incubación simultánea de 3 ó más microplacas. temperatura programable a 37°C como mínimo.
5. Muestra	- Suero o plasma
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores y Controles del Kit: Deben venir dentro de los Kits de Reactivos, manteniendo una concordancia con lo señalado en la etiqueta de la caja. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana (para Índice de Cut-off), de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado al requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




13. MODULAR PARA CENTELLEO GAMMA	
1. Tipo	- Lector de Centelleo Gamma.
2. Metodología	- Radioinmunoanálisis ó Análisis de Radiorreceptor.
3. Performance	- 20 ó más lecturas de centelleo por hora.
4. Características	- 1 ó más Cubetas de lectura de Centelleo Gamma. - Memoria para 20 o más protocolos de pruebas.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras ó Cubetas de muestra con alicuota.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado al requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



14. MODULAR PARA SCREENING NEONATAL	
1. Tipo	- Modular conformado por un equipo Perforador de Papel de Filtro y un equipo Elutor ó por un equipo Perforador/Elutor.
2. Metodología	-
3. Performance	- 96 muestras eluidas en microplacas ó 100 muestras eluidas en tubos, por ciclo:
4. Características	- Perforador de Papel de Filtro: Con perforador de tamaño variable para microplacas de 96 pozos ó gradillas de 10 por 10 tubos, como mínimo. - Elutor: Con capacidad para eluir muestras en microplacas de 96 pozos ó gradillas de 10 por 10 tubos. - Perforador/Elutor: Con perforador de tamaño variable para microplacas de 96 pozos ó gradillas de 10 por 10 tubos, y con capacidad para eluir muestras en tales soportes.
5. Muestra	- Sangre seca en papel de filtro.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



15. ANALIZADOR DE ELECTROFORESIS EN GEL	
1. Tipo	- Analizador completamente automatizado ó Modular conformado por Unidad de Procesamiento Automatizado y Densitómetro.
2. Metodología	- Electroforesis en Gel de Agarosa.
3. Performance	- 24 ó más pruebas por corrido.
4. Características	- Unidad de Procesamiento Automatizado: Cargado de muestras, desarrollo del corrido y tinción. - Densitómetro: Lectura y Almacenamiento de datos de corridos electroforéticos.
5. Muestra	- Suero, plasma, orina y/o LCR en tubo primario con Código de Barras ó Cubetas de muestra con alicuota.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado al requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



16. MODULAR PARA ELECTROFORESIS EN GEL	
1. Tipo	- Modular conformado por una Fuente de Poder, una Cámara de Electroforesis y Escáner.
2. Metodología	- Electroforesis en Gel de Agarosa.
3. Performance	- 8 ó más pruebas por corrido.
4. Características	- Fuente de Poder: compatible con la cámara. - Cámara de Electroforesis: adecuada para corridos en Gel. - Escáner: Lectura de corridos electroforéticos.
5. Muestra	- Suero, plasma, orina y/o LCR.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado al requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




17. ANALIZADOR DE ELECTROFORÉISIS CAPILAR	
1. Tipo	- Analizador Random de Acceso Discreto completamente Automatizado.
2. Metodología	- Electroforesis Capilar.
3. Performance	- 10 ó más pruebas por hora.
4. Características	- 1 ó más reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. - 10 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Tubos Primarios. - Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Opcional: Dilución automática de muestras.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina, y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado al requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




18. ANALIZADOR DE GASES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS	
1. Tipo	- Analizador de Flujo Continuo.
2. Metodología	- Fotometría, Potenciometría, ISE, Amperometría, Conductividad y/o Medición Electroquímica y/o Métodos Complementarios.
3. Performance	- 20 ó más pruebas por hora.
4. Características	- Determinación directa de Gases Arteriales: pH, pCO ₂ , pO ₂ . - Determinación directa de Electrolitos: Na, K, Cl y Ca iónico. Opcional Mg iónico. - Determinación directa de Hemoglobina y/o Hematocrito. - Determinación directa de Metabolitos: Glucosa y Lactato. Opcional: Urea/BUN y/o Creatinina - Lector de Códigos de Barras para las muestras. - Co-Oximetría (de acuerdo a producción): O ₂ Hb, COHb, HHb, methb. Opcional: SulfHb. - Opcional: Detección de microcoágulos en la muestra.
5. Muestra	- Sangre arterial en jeringa heparinizada. - Sangre en capilares heparinizados. - Suero en viales.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz adecuada, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar tres niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.





19. ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS	
1. Tipo	- Analizador de Flujo Continuo.
2. Metodología	- Potenciometría, ISE, Amperometría, Conductividad y/o Medición Electroquímica y/o Métodos Complementarios.
3. Performance	- 20 ó más pruebas por hora.
4. Características	- Determinación directa de Gases Arteriales: pH, Pco2, pO2. - Determinación directa de Electrolitos: Na, K, Cl y/o Ca iónico. - Lector de Códigos de Barras para las muestras. - Opcional: Detección de microcoágulos en la muestra.
5. Muestra	- Sangre arterial en jeringa heparinizada. - Sangre en capilares heparinizados - Suero en viales.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el período de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el período de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz adecuada, de un único lote para todo el período de compra, en cantidad suficiente para procesar tres niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




20. ANALIZADOR DE TIRAS DE ORINA	
1. Tipo	- Analizador de Acceso Discreto y/o Continuo completamente Automatizado.
2. Metodología	- Reflectometría.
3. Performance	- 200 ó más tiras por hora.
4. Características	- Lectura reflectométrica automatizada de Tiras de Orina. - Reporte cuantitativo de resultados para Densidad, pH, Proteínas, Glucosa y Eritrocitos, como mínimo. - 30 ó más Tubos de Orina con Códigos de Barras. - Lector de Códigos de Barra para los Tubos de Orina. - Opcional: Equipo para Lectura Automatizada de Sedimento Urinario.
5. Muestra	- Orina en Tubo con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del-Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado al requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



21. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO MEDIANO DE TIRAS DE ORINA	
1. Tipo	- Analizador Random de Acceso Discreto Semiautomatizado.
2. Metodología	- Reflectometría.
3. Performance	- 100 ó más tiras por hora.
4. Características	- Lectura reflectométrica semiautomatizada de Tiras de Orina. - Reporte cuantitativo de resultados para Densidad, pH, Proteínas, Glucosa y Eritrocitos, como mínimo. - Opcional: Lector de Códigos de Barra para las muestras de Orina. - Opcional: Terminal para ingreso de Sedimento Urinario.
5. Muestra	- Orina.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado al requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




22. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO CHICO DE TIRAS DE ORINA	
1. Tipo	- Analizador Random de Acceso Discreto Semiautomatizado.
2. Metodología	- Reflectometría.
3. Performance	- 40 ó más tiras por hora
4. Características	- Lectura reflectométrica semiautomatizada de Tiras de Orina. - Reporte cuantitativo de resultados para Densidad, pH, Proteínas, Glucosa y Eritrocitos, como mínimo. - Opcional: Lector de Códigos de Barra para las muestras de Orina. - Opcional: Terminal para ingreso de Sedimento Urinario.
5. Muestra	- Orina.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado al requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




23. ANALIZADOR DE SEDIMENTO URINARIO	
1. Tipo	- Analizador de Flujo Continuo.
2. Metodología	- Impedancia Volumétrica y Citometría de Flujo.
3. Performance	- 50 ó más sedimentos urinarios por hora.
4. Características	- Sedimentos Urinarios con determinación de leucocitos, Hematíes, Células Epiteliales, Cilindros y Bacterias.. - Lector de Códigos de Barras para Tubos Primarios. - Autocargador de muestras. - Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra.
5. Muestra	- Orina en Tubo con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar tres niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



24. ANALIZADOR HEMATOLOGICO DIFERENCIAL DE 3 ESTIRPES	
1. Tipo	- Analizador de Flujo Continuo.
2. Metodología	- Impedancia Volumétrica.
3. Performance	- 20 ó más hemogramas por hora.
4. Características	- Hemogramas con determinación de 3 estirpes leucocitarias. - Lector de Códigos de Barras para Tubos Primarios. - Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Autocargador de muestras y/o Agitador de Tubos.
5. Muestra	- Sangre total anticoagulada con EDTA-k3 en Tubo primario con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar tres niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



25. ANALIZADOR HEMATOLOGICO GRANDE DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES	
1. Tipo	- Analizador de Flujo Continuo.
2. Metodología	- Impedancia Volumétrica y/ló Láser y/ló Radiofrecuencia y/ló Citoquímica y/ló Citometría de Flujo.
3. Performance	- Más de 100 hemogramas por hora.
4. Características	- Hemogramas con determinación de 5 estirpes leucocitarias. - Lector incorporado de Códigos de Barras para Tubos Primarios. - Autocargador de muestras. - Procesamiento de muestras STAT. - Opcional: Cuantificación de Reticulocitos. - Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Opcional: Cuantificación de CD3, CD4, CD8, CD32 y CD61, entre otros.
5. Muestra	- Sangre total anticoagulada con EDTA-k3 en Tubo primario con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar tres niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




26. ANALIZADOR HEMATOLOGICO MEDIANO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES	
1. Tipo	- Analizador de Flujo Continuo.
2. Metodología	- Impedancia Volumétrica y/ló Láser y/ló Radiofrecuencia y/ló Citoquímica y/ló Citometria de Flujo.
3. Performance	- 80 ó más hemogramas por hora.
4. Características	- Hemogramas con determinación de 5 estirpes leucocitarias. - Lector incorporado de Códigos de Barras para Tubos Primarios. - Autocargador de muestras y/ló Agitador de Tubos. - Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Opcional: Cuantificación de Reticulocitos.
5. Muestra	- Sangre total anticoagulada con EDTA-k3 en Tubo primario con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar tres niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



27. ANALIZADOR HEMATOLOGICO CHICO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES	
1. Tipo	- Analizador de Flujo Continuo.
2. Metodología	- Impedancia Volumétrica y/ló Láser y/ló Radiofrecuencia y/ló Citoquímica y/ló Citometría de Flujo.
3. Performance	- 60 ó más hemogramas por hora.
4. Características	- Hemogramas con determinación de 5 estirpes leucocitarias. - Lector incorporado de Códigos de Barras para Tubos Primarios. - Autocargador de muestras y/ló Agitador de Tubos. - Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Opcional: Cuantificación de Reticulocitos.
5. Muestra	- Sangre total anticoagulada con EDTA-k3 en Tubo primario con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos); en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar tres niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



28. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN GRANDE	
1. Tipo	- Analizador Random de Acceso Discreto.
2. Metodología	- Coagulométrica, Cromogénica e Inmunológica.
3. Performance	- 300 TP/Hora o más y 200 TTPA/Hora ó más.
4. Características	- 20 ó más Reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. Con 5 ó más canales libres para el procesamiento de pruebas adquiridas en forma independiente ó no agrupada. - 20 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 50 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Tubos Primarios. - Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Dilución automática de muestras.
5. Muestra	- Plasma con Citrato de Sodio en Tubo primario con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control (Normal y Patológico) en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



29. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN MEDIANO	
1. Tipo	- Analizador Random de Acceso Discreto.
2. Metodología	- Coagulométrica. Opcional Cromogénica e Inmunológica.
3. Performance	- 120 TP/Hora o más y 60 TTPA/Hora o más.
4. Características	- 10 ó más Reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. Con 5 ó más canales libres para el procesamiento de pruebas adquiridas en forma independiente ó no agrupada. - 10 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 20 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Tubos Primarios. - Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Opcional: Dilución automática de muestras.
5. Muestra	- Plasma con Citrato de Sodio en Tubo primario con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el período de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control (Normal y Patológico) en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



30. ANALIZADOR DE COAGULACIÓN CHICO	
1. Tipo	- Analizador Random de Acceso Discreto.
2. Metodología	- Coagulométrica. Opcional Cromogénica e Inmunológica.
3. Performance	- 50 TP/Hora o más y 30 TTPA/Hora o más.
4. Características	- 3 ó más Reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. Con 5 ó más canales libres para el procesamiento de pruebas adquiridas en forma independiente ó no agrupada. - 3 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 5 ó más Tubos Primarios con Códigos de Barras. - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Tubos Primarios. - Opcional: Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Opcional: Dilución automática de muestras.
5. Muestra	- Plasma con Citrato de Sodio en Tubo primario con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control (Normal y Patológico) en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



31. EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE COAGULACION	
1. Tipo	- Analizador Semiautomatizado.
2. Metodología	- Coagulométrica.
3. Performance	- 20 ó más lecturas coagulométricas por hora.
4. Características	- 2 ó más Canales de Lectura Coagulométrica. - Bloque de Incubación para 4 ó más cubetas con alícuotas de muestras. - Area para colocación de Reactivos. - Volumen de Reacción de 500 microlítrros o menor. - Memoria para 3 ó más protocolos de pruebas. - Opcional: Lector de Códigos de Barras para los Tubos Primarios.
5. Muestra	- Plasma con Citrato de Sodio en Tubo primario con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control (Normal y Patológico) en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



32. EQUIPO PARA AGREGACION PLAQUETARIA	
1. Tipo	- Equipo Automatizado ó Semiautomatizado.
2. Metodología	- Agregación Plaquetaria.
3. Performance	- 20 ó más lecturas de Agregación Plaquetaria por hora.
4. Características	- 2 ó más Canales de Lectura de Agregación. - Memoria para 4 ó más protocolos de pruebas (Como mínimo ADP, Colágeno, Epinefrina, Ristocetina).
5. Muestra	- Plasma rico en plaquetas y/o sangre total con antiagregante.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado al requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año; Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




33. MODULAR MEDIANO PARA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION AUTOMATIZADA	
1. Tipo	- Equipo para Velocidad de Sedimentación Automatizada.
2. Metodología	- Medición Automatizada de Velocidad de Sedimentación.
3. Performance	- 60 ó más pruebas por hora.
4. Características	- Equipo con 30 ó más posiciones para Tubos Primarios de Velocidad de Sedimentación. - Sensores Opticos para medición de Velocidad de Sedimentación. - Lector de Código de Barras. - Adicional: Agitador de Tubos.
5. Muestra	- Plasma con Citrato de Sodio en Tubo primario con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control (Normal y Patológico) en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas; las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




34. MODULAR CHICO PARA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION AUTOMATIZADA	
1. Tipo	- Equipo para Velocidad de Sedimentación Automatizada.
2. Metodología	- Medición Automatizada de Velocidad de Sedimentación.
3. Performance	- 20 ó más pruebas por hora.
4. Características	- Equipo con 10 ó más posiciones para Tubos Primarios de Velocidad de Sedimentación. - Sensores Opticos para medición de Velocidad de Sedimentación. - Lector de Código de Barras. - Adicional: Agitador de Tubos.
5. Muestra	- Plasma con Citrato de Sodio en Tubo primario con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control (Normal y Patológico) en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a necesidad del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



35. EQUIPO PARA INMUNOHEMATOLOGIA EN TARJETA	
1. Tipo	- Equipo Automatizado ó Semiautomatizado (Procesador y Lector) para Inmunoematología en Tarjetas
2. Metodología	- Aglutinación de Eritrocitos en Gel.
3. Performance	- 20 ó más Tarjetas por corrido.
4. Características	- Identificación de Muestras y Tarjetas por Código de Barras. - Resuspensión automática de Hematíes. - Dilución y Dispensación automática de Reactivos. - Incubación y Centrifugación automática de Tarjetas - Lectura e Interpretación automática.
5. Muestra	- Suero o suspensión de eritrocitos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



36. MODULAR PARA INMUNOHEMATOLOGIA EN TARJETA	
1. Tipo	- Modular conformado por una Centrifuga de Tarjetas, un Incubador y Lector.
2. Metodología	- Aglutinación de Eritrocitos en Gel.
3. Performance	- 15 ó más Tarjetas por corrido.
4. Características	- Centrifuga de Tarjetas: Con capacidad para 15 tarjetas a la vez, como mínimo. - Incubador de Tarjetas: Con capacidad para 15 tarjetas a la vez, como mínimo. - Lector: Lectura de Tarjetas e Interpretación. - Equipos adicionales: Dispensador con Soporte, Gradilla para Tarjetas. Pipeta automática.
5. Muestra	- Suero o suspensión de eritrocitos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



37. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA AFERESIS	
1. Tipo	- Equipo Automatizado para Aféresis de Componentes Sanguíneos.
2. Metodología	- Separación por Centrifugación y Filtración Automatizada de Componentes Sanguíneos.
3. Performance	- 1 Procedimiento cada 3 a 4 horas, como mínimo.
4. Características	- Monitorización de Anticoagulante. - Capacidad de realizar: Plaquetaféresis, Recambio Plasmático Terapéutico y Colecta de Células Progenitoras. - Equipo con capacidad de desplazamiento hacia áreas fuera del Banco de Sangre.
5. Muestra	- Sangre Total anticoagulada.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de los Procedimientos programados para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




38. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA SEPARACIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS	
1. Tipo	- Equipo Automatizado para la Separación y Fraccionamiento de Componentes Sanguíneos.
2. Metodología	- Separación por Centrifugación y Filtración Automatizada de Componentes Sanguíneos.
3. Performance	- 1 Procedimiento cada 3 a 4 horas, como mínimo.
4. Características	- Monitorización de Anticoagulante. - Capacidad de realizar: Colecta y Fraccionamiento Automatizado de Concentrado de Hematíes, Plasma y Plaquetas leucorreducidas, y de Doble Colecta de Glóbulos Rojos. - Opcional: Plasmaféresis y Colecta de Células Progenitoras. - Equipo con capacidad de desplazamiento hacia áreas fuera del Banco de Sangre.
5. Muestra	- Sangre Total anticoagulada.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de los Procedimientos programados para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




39. EQUIPO PARA FRACCIONAMIENTO SANGUÍNEO	
1. Tipo	- Equipo Automatizado ó Semiautomatizado para el Fraccionamiento Sanguíneo.
2. Metodología	- Separación por Compresión controlada por mecanismo óptico.
3. Performance	- 2 ó más Procedimientos por hora por Equipo, con Leucorreducción mínima del 95 %.
4. Características	- Unidad Compresora con Sensor(es) Optico(s) para la separación de Plasma, Plaquetas y Buffy Coat de unidades de sangre. - Con sistema de Cierre y Apertura Automático para las tubuladuras de las unidades de sangre. - Sellado Automático incorporado de Tubuladuras y/o Sellador Eléctrico a calor accesorio. - Con capacidad de usar diferentes marcas de Bolsas de Extracción. - Lector de Código de Barras si el equipo lo requiere. - Adicional: Conector estéril de tubuladuras con obleas en cantidad suficiente.
5. Muestra	- Sangre Total anticoagulada.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de los Procedimientos programados para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




40: INCUBADOR AUTOMATIZADO GRANDE DE HEMOCULTIVOS	
1. Tipo	- Analizador Automatizado para Hemocultivos.
2. Metodología	- Fluorometría y/o Fotometría.
3. Performance	- Capacidad para incubar 200 o más Frascos de Hemocultivo simultáneamente.
4. Características	- Incubador con capacidad de agitación continua de los frascos de hemocultivos. - Sistema de Sensores Ópticos para detección continua del Crecimiento Bacteriano. - Alarmas para indicar la identificación de cultivos positivos.
5. Muestra	- Sangre Total en medio de cultivo apropiado.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días o más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




41. INCUBADOR AUTOMATIZADO MEDIANO DE HEMOCULTIVOS	
1. Tipo	- Analizador Automatizado para Hemocultivos.
2. Metodología	- Fluorometría y/o Fotometría.
3. Performance	- Capacidad para incubar 100 o más Frascos de Hemocultivo simultáneamente.
4. Características	- Incubador con capacidad de agitación continua de los frascos de hemocultivos. - Sistema de Sensores Opticos para detección continua del Crecimiento Bacteriano. - Alarmas para indicar la identificación de cultivos positivos.
5. Muestra	- Sangre Total en medio de cultivo apropiado.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días o más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




42. INCUBADOR AUTOMATIZADO CHICO DE HEMOCULTIVOS	
1. Tipo	- Analizador Automatizado para Hemocultivos.
2. Metodología	- Fluorometría y/o Fotometría.
3. Performance	- Capacidad para incubar 30 o más Frascos de Hemocultivo simultáneamente.
4. Características	- Incubador con capacidad de agitación continua de los frascos de hemocultivos. - Sistema de Sensores Opticos para detección continua del Crecimiento Bacteriano. - Alarmas para indicar la identificación de cultivos positivos.
5. Muestra	- Sangre Total en medio de cultivo apropiado.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días o más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




43. ANALIZADOR AUTOMATIZADO GRANDE DE DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA	
1. Tipo	- Analizador Automatizado para la Identificación y Sensibilidad Microbiana.
2. Metodología	- Fluorometría y/o Fotometría.
3. Performance	- Capacidad para procesar 80 o más muestras simultáneamente.
4. Características	- Incubador integrado con capacidad para 80 ó más paneles de diferenciación y sensibilidad. - Sistema Optico integrado para lectura de los paneles.
5. Muestra	- Cultivo primario aislado apropiadamente.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados, incluyendo el Perfil Epidemiológico), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Incluir todos los consumibles para la preparación y el cargado del inoculo incluyendo cargador estándar de inoculo bacteriano (nivel de turbidez de 0.5 en la escala de McFarland 1.8 x 10 ⁸ CFU/ML) para las placas de acuerdo al requerimiento de la metodología. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




44. ANALIZADOR AUTOMATIZADO MEDIANO DE DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA	
1. Tipo	- Analizador Automatizado para la Identificación y Sensibilidad Microbiana.
2. Metodología	- Fluorometría y/o Fotometría.
3. Performance	- Capacidad para procesar 30 o más muestras simultáneamente.
4. Características	- Incubador integrado con capacidad para 30 ó más paneles de diferenciación y sensibilidad. - Sistema Optico integrado para lectura de los paneles.
5. Muestra	- Cultivo primario aislado apropiadamente.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados, incluyendo el Perfil Epidemiológico), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Incluir todos los consumibles para la preparación y el cargado del inóculo incluyendo cargador estándar de inóculo bacteriano (nivel de turbidez de 0.5 en la escala de McFarland 1.8 x 10 ⁸ CFU/ML) para las placas de acuerdo al requerimiento de la metodología. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



45. MODULAR PARA DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICROBIANA	
1. Tipo	- Equipo Semiautomatizado para Lectura de Paneles de Diferenciación y Sensibilidad Microbiana.
2. Metodología	- Fluorometría y/o Fotometría.
3. Performance	- Lectura de 10 ó más Paneles por hora.
4. Características	- Equipo Lector Optico semiautomatizado para lectura de los paneles.
5. Muestra	- Cultivo primario aislado apropiadamente.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados, incluyendo el Perfil Epidemiológico), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Incluir todos los consumibles para la preparación y el cargado del inóculo incluyendo cargador estándar de inóculo bacteriano (nivel de turbidez de 0.5 en la escala de McFarland 1.8×10^8 CFU/ML) para las placas de acuerdo al requerimiento de la metodología. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



46. ANALIZADOR AUTOMATIZADO MEDIANO DE DIFERENCIACIÓN Y SENSIBILIDAD MICOBACTERIANA	
1. Tipo	- Analizador Automatizado para la Identificación y Sensibilidad Micobacteriana.
2. Metodología	- Fluorometría y/o Fotometría.
3. Performance	- Capacidad para procesar 30 o más muestras simultáneamente.
4. Características	- Incubador integrado con capacidad para 30 ó más paneles de diferenciación y sensibilidad. - Sistema Optico integrado para lectura de los paneles.
5. Muestra	- Secreciones y fluidos biológicos
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados, incluyendo el Perfil Epidemiológico), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



47. EQUIPO DISPENSADOR DE DISCOS DE SENSIBILIDAD	
1. Tipo	- Equipo Manual para dispensar Discos de Sensibilidad para Antibiograma
2. Metodología	- Dispensación mecánica de Discos de Sensibilidad.
3. Performance	- Dispensación simultánea de 6 Discos de Sensibilidad.
4. Características	- Equipo con mango perpendicular y disparador en el mango. - Capacidad de contener 6 cartuchos de 50 discos de 1/4"
	- Dispensación equidistante de Discos en placas de 15 x 100 mm.
5. Muestra	- No aplicable.
6. Procesamiento de Datos	- No aplicable.
7. Accesorios del Equipo	- No aplicable.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- No aplicable.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- No aplicable.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




48. MODULAR PARA LECTURA AUTOMATIZADA DE SENSIBILIDAD MICROBIANA POR DISCOS	
1. Tipo	- Equipo Automatizado para Lectura de Sensibilidad Microbiana por Discos.
2. Metodología	- Detección Optica de Halos de Inhibición.
3. Performance	- Lectura de 30 ó más Placas por hora.
4. Características	- Equipo Lector Optico para lectura de los halos de inhibición en las Placas de Antibiógrama por Discos.
5. Muestra	- Placas de Sensibilidad Microbiana por Discos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados, incluyendo el Perfil Epidemiológico), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de los procedimientos programados para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




49. ANALIZADOR DE CITOMETRIA DE FLUJO	
1. Tipo	- Analizador Automatizado de Flujo Continuo.
2. Metodología	- Citometría de Flujo.
3. Performance	- 20 ó más citometrías por hora.
4. Características	- Detección hasta 4 Fluorocromos mediante 1 o 2 Láser. - Capacidad de adquisición hasta 20,000 eventos por segundo - Opcional: Cell Sorting, Lectores de Códigos de Barras para Tubos Primarios, Autocargador de muestras.
5. Muestra	- Sangre total anticoagulada con EDTA-k3 en Tubo primario con Código de Barras si así se requiere.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




50. ANALIZADOR DE CITOMETRIA DE FLUJO	
1. Tipo	- Analizador Automatizado de Flujo Continuo.
2. Metodología	- Citometría de Flujo.
3. Performance	- 30 ó más citometrías por hora.
4. Características	- Detección de 6 ó más Fluorocromos mediante 2 a 3 Láser. - Capacidad de adquisición hasta 50,000 eventos por segundo - Opcional: Cell Sorting, Lectores de Códigos de Barras para Tubos Primarios, Autocargador de muestras, accesorios para disgregar ganglios y/o tejidos sólidos si así se requiere según cuadro adjunto.
5. Muestra	- Sangre total anticoagulada con EDTA-k3, medula ósea, ganglio u otros, en Tubo primario con Código de Barras si así se requiere.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software plataforma Windows y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, compensación, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 180 días ó más. - Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Opcional Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Lisantes, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios incluso de impresión deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración y compensación, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 05 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




51. ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA BIOLOGIA MOLECULAR	
1. Tipo	- Analizador Automatizado para Biología Molecular.
2. Metodología	- Análisis de Ácidos Nucleicos.
3. Performance	- 50 ó más pruebas de Biología Molecular por corrido.
4. Características	- Equipo Automatizado con capacidad de realizar: Aislamiento de Ácidos Nucleicos y/o Amplificación y/o Detección y/o Detección Amplificada de Ácidos Nucleicos. - Equipos adicionales para completar todas las Fases no automatizadas (Ej.: Centrifuga Refrigerada de microtubos, opcional Cabina de Flujo Laminar, opcional Congeladora Vertical de -80°C, etc.) - 1 ó más Reactivos a bordo identificados por Códigos de Barras. - 1 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 10 ó más muestras en simultáneo (Tubos Primarios con Códigos de Barras y/o Alicuotas). - Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Muestras.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras y/o Alicuotas. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo Plasma y/o Suero y/u Orina y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




52. MODULAR PARA BIOLOGIA MOLECULAR	
1. Tipo	- Modular conformado por Equipos Semiautomatizados para Análisis de Acidos Nucleicos.
2. Metodología	- Análisis de Acidos Nucleicos.
3. Performance	- 10 ó más pruebas de Biología Molecular por corrido.
4. Características	- Equipos Semiautomatizados con capacidad de realizar: Aislamiento de Acidos Nucleicos y/o Amplificación y/o Detección y/o Detección Amplificada de Acidos Nucleicos. - Equipos adicionales para completar todas las Fases (Ej.: Centrifuga Refrigerada de microtubos, etc.) - En el caso de requerir Termociclador, éste debe ser electrónico digital, con placa térmica para 96 microtubos y tapa térmica que permita mantener altas temperaturas en la parte superior de los microtubos de reacción, previniendo la evaporación. - 1 ó más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra. - 10 ó más muestras en simultáneo (Tubos Primarios con Códigos de Barras y/o Alicuotas). - Opcional: Lectores de Códigos de Barras para los Reactivos y Muestras.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras y/o Alicuotas. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo Plasma y/o Suero y/o Orina y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el período de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimientos del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




53. MODULAR PARA HIBRIDIZACION	
1. Tipo	- Modular conformado por un Procesador de Tiras de Hibridización y un Escáner.
2. Metodología	- Hibridización en Tira.
3. Performance	- 10 ó más tiras de Hibridización por corrido.
4. Características	- Equipos Semiautomatizados con capacidad para realizar la Aplicación de la muestra, las Incubaciones, los Lavados y el Desarrollo de Color de las Tiras de Hibridización. - Escáner con capacidad de realizar la Lectura adecuada de las tiras de Hibridización, de forma cualitativa y/o Semicuantitativa y/o Cuantitativa.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras y/o Alicuotas. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo Plasma y/o Suero y/lú Orina y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



54. MODULAR PARA INMUNOBLOT	
1. Tipo	- Modular conformado por un Procesador de Tiras de Inmunoblots y un Escáner.
2. Metodología	- Inmunoblot en Tiras.
3. Performance	- 10 ó más tiras de Inmunoblots por corrido.
4. Características	- Procesador de Inmunoblots con capacidad para realizar la Aplicación de la muestra, las Incubaciones, los Lavados y el Desarrollo de Color de las Tiras de Inmunoblot. - Escáner con capacidad de realizar la Lectura adecuada de las tiras de Inmunoblots, de forma cualitativa y/o Semicuantitativa y/o Cuantitativa.
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras y/o Alicuotas. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo Plasma y/o Suero y/o Orina y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato; ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




55. MODULAR PARA CROMATOGRAFIA LIQUIDA	
1. Tipo	- Equipo Semiautomatizado para Cromatografía Líquida de Alta ó Baja Presión
2. Metodología	- Cromatografía Líquida de Alta ó Baja Presión.
3. Performance	- 10 ó más pruebas por corrido.
4. Características	- Equipo con Columnas apropiadas para los Analitos a detectar. - Detección de microcoágulos por la pipeta de muestra. - Opcional: Lectores de Códigos de Barras para Tubos Primarios. - Opcional: Autocargador de muestras.
5. Muestra	- Sangre total anticoagulada con EDTA-k3 en Tubo primario con Código de Barras.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.




56. EQUIPO FOTOMETRO DIGITAL UV	
1. Tipo	- Equipo Semiautomatizado.
2. Metodología	- Fotometría Cinética UV.
3. Performance	- 20 ó más lecturas fotométricas por hora.
4. Características	- Fotómetro monoespectral de absorción, con haz de luz de referencia. - Longitudes de Onda de 220, 230, 260, 320, 562 y 595 nm. - Fuente de Luz: Xenón. - Ancho de Banda Espectral de 3nm en el rango de 230 a 320nm. - Microcubeta para volúmenes de 500µl o menos (Opcional: Bomba de Aspiración)
5. Muestra	- Tubo primario con Código de Barras ó Cubetas de muestra con alícuota. - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo plasma, suero, orina y otros fluidos biológicos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar dos niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



57. MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA DE FASE INVERTIDA	
1. Tipo	- Microscopio Modular de Fluorescencia de Fase Invertida para lectura de placas de Terasaki:
2. Metodología	- Microscopía de Fluorescencia de Fase Invertida.
3. Performance	- Lectura de 1 Placa de terasaki completa por vez.
4. Características	- Platina motorizada con control de dirección externo. - Fotómetro incorporado para realizar fluorometría con salida a lector y computadora.
5. Muestra	- Diluciones de Linfocitos.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS). - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, controles y complementos	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, calibraciones y lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, durante las 24 hr y los 7 días de la semana. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



58. ANALIZADOR DE CALCIO IONICO	
1. Tipo	- Analizador de Flujo Continuo.
2. Metodología	- ISE directo y/o Medición Electroquímica.
3. Performance	- 20 ó más pruebas por hora.
4. Características	- Determinación directa de Calcio Iónico. - Lector de Códigos de Barras para las muestras. - Opcional: Detección de microcoágulos en la muestra.
5. Muestra	- Sangre arterial en jeringa heparinizada y/o en capilares. - Suero en viales.
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo (procesamiento de calibraciones, controles y resultados), con capacidad de Archivo de datos de 30 días ó más. Impresora: adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio. - Externo: Software de interfase al Sistema de Información de Laboratorio. Hardware: Computadora Terminal y punto de red con cableado hasta el Concentrador del Laboratorio.
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios deberán ser entregados en forma periódica (acompañando la entrega de los reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas y las Pruebas de Calibración y Control programadas para el periodo de compra. En cualquier caso en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata. - Calibradores: proporcionar Material de Calibración de un mismo lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica. - Controles Internos: proporcionar Material de Control de matriz humana, de un único lote para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente para procesar tres niveles de control en cada jornada de trabajo y por cada tipo de análisis, como mínimo. - Soluciones y Complementos de Limpieza: En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, las calibraciones y los lavados adicionales, requeridos de acuerdo a la metodología de trabajo.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programa Original del fabricante y el Cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe del Laboratorio respectivo. - Mantenimiento Correctivo: inmediato, ajustado a requerimiento del usuario. - Personal Técnico: certificado por el fabricante, con experiencia no menor de 6 meses en el equipo.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Procesos de Compra menores de 1 año: Equipo con menos de 04 años de fabricación (de acuerdo a póliza de importación original y certificado original del fabricante que consigne fecha de fabricación). - Licitaciones Anuales: De acuerdo a Directiva N° 010.



59. COLOREADOR AUTOMATICO PARA INMUNOHISTOQUIMICA	
1. Tipo	- Proceso de coloracion automático en inmunohistoquímica.
2. Metodología	- Sistema de protocolos múltiples y sistema de detección simultánea de anticuerpos.
3. Performance	- Capacidad de 48 como laminas como mínimo para la determinación de anticuerpos simultáneamente
4. Características	- Versatilidad y flexibilidad para cambiar los múltiples parámetros dentro de un solo funcionamiento (tiempos de la incubación, diluciones del anticuerpo). - Trabaja a temperatura ambiente - Trabaja con todos los anticuerpos primarios - Trabaja con todos los anticuerpos secundarios - Separa los residuos tóxicos y no tóxicos - Componente Interno: Software Windows 95/98 para el manejo de datos del equipo (calibraciones, etc) - Componente externo: Hardware completo - Elimina errores para lectura de láminas
5. Muestra	- Corte de tejido parafinado o frotis celular
6. Procesamiento de Datos	- Interno: Software y Hardware para el manejo de datos del Equipo
7. Accesorios del Equipo	- Fuente de poder de emergencia (UPS) - Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica. - Porta láminas - Porta reactivos - Viales de reactivos - Contenedor de Buffer - Contenedor de agua desionizada - Contenedor de desechos - Guía de uso
8. Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios	- Todos los consumibles y accesorios deberán ser entregados periódicamente (acompañando a la entrega de los anticuerpos en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de uso de cada anticuerpo) de tal modo que las fechas de expiración del reactivo sean como mínimo un año a la fecha de entrega.
9. Soporte Técnico	- Mantenimiento preventivo: Presentar programa y el cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el personal responsable designado por el Departamento - Mantenimiento Correctivo: Inmediato, dentro de las 24 horas, durante la jornada laboral, los 7 días de la semana. - Personal técnico: Con experiencia en estos equipos, garantizado por el proveedor.
10. Modo de Operación	- 220V, 60Hz.
11. Antigüedad	- Menor cuantía, adjudicaciones directas y licitaciones menores de un año. Equipo fabricado dentro de los 3 años anteriores (de acuerdo a póliza de importación)

